

## クイック・リファレンス

RTPA2A

リアル-タイム・スペクトラム・  
アナライザ TekConnect® プローブ  
アダプタのセットアップ

071-1788-00



071178800


## RF セットアップ - 下の図に従って接続します。

このリファレンス・カードには、次の 3 種類の一般的なプローブおよびスペクトラム・アナライザのセットアップを示します。RF、I および Q、RF および I。


---

**注：**スペクトラム・アナライザへの USB、RF、I、および Q 接続については、スペクトラム・アナライザのユーザ・マニュアルを参照してください。TekConnect プローブ・アダプタを使用するためには、スペクトラム・アナライザが Windows XP を実行している必要があります。

---

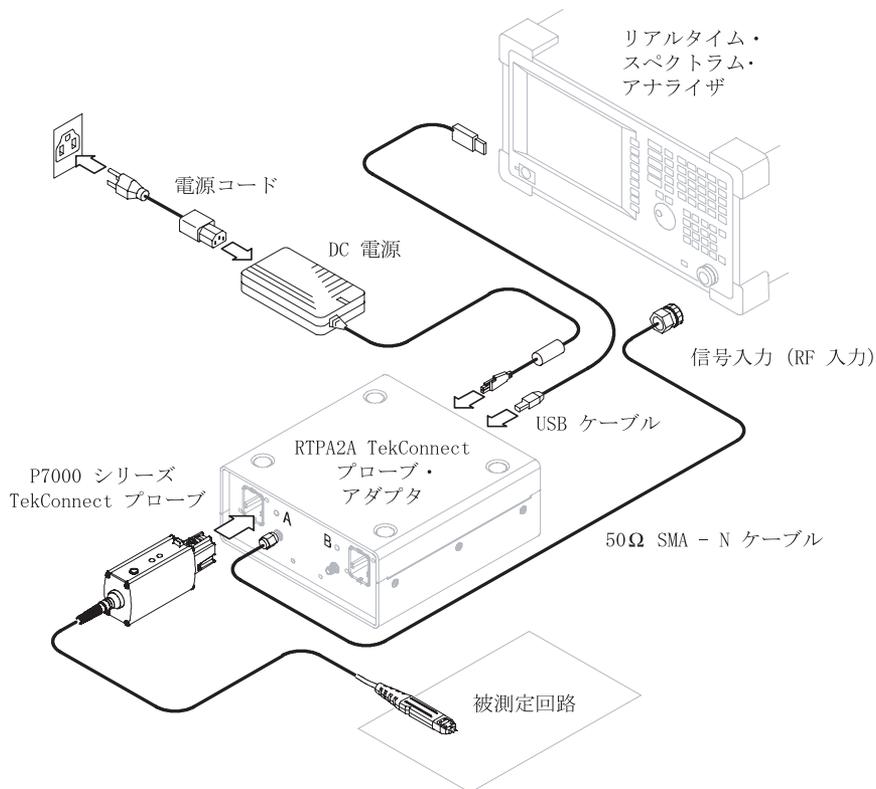

IおよびQ セットアップ - 下の図に従って接続します RF セットアップは  
グレイで示されています。

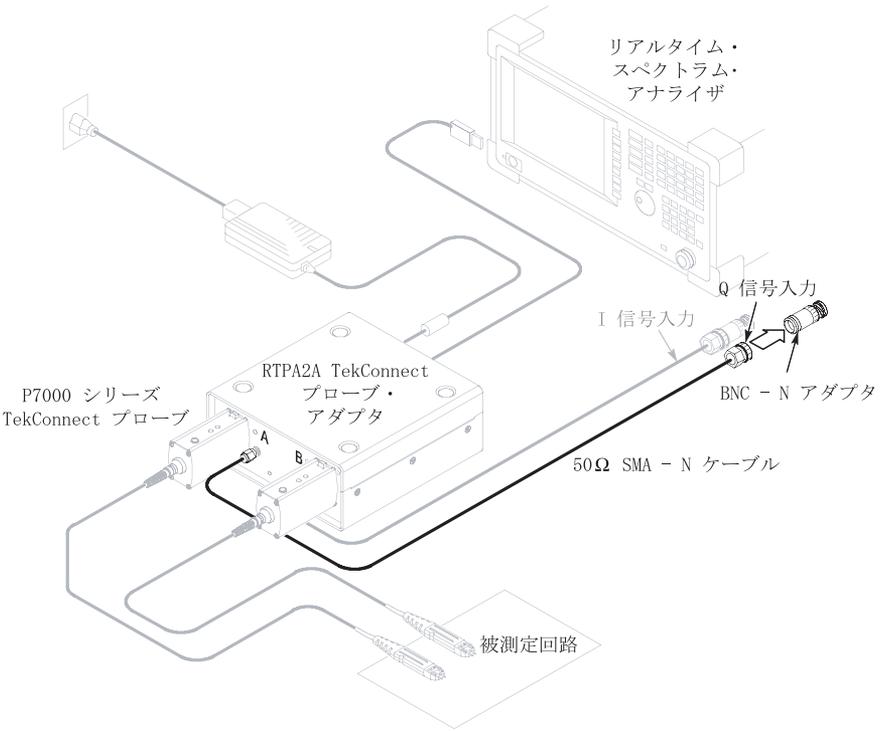

**RF および I セットアップ** - 下の図に従って接続します RF セットアップはグレイで示されています。

