

## 5 シリーズ MSO

ミックスト・シグナル・オシロスコープ・データ・シート

*The largest display. The most channels. The greatest experience.*



## 主な性能仕様

革新的なピンチ-スワイプ-ズーム操作に対応したタッチスクリーンによるユーザ・インタフェース、業界トップクラスの大型 HD ディスプレイ、チャンネルあたり1つのアナログ信号または8つのデジタル信号の測定が可能な FlexChannel®入力を4/6/8チャンネル備えた5シリーズMSOは、今日、および将来予想される困難な課題にも対応できます。性能、解析機能、そしてユーザ・エクスペリエンス全般についても、新しい基準を確立しました。

### 入力チャンネル数

- 4、6、または8 (FlexChannel®入力)
- 1つのFlexChannelで以下の入力をサポートします。
  - 1つのアナログ信号入力 (波形表示、スペクトラム表示、または両方を同時)
  - 8つのデジタル・ロジック入力 (TLP058型ロジック・プローブを使用)

### 周波数帯域 (全アナログ・チャンネル)

- 350MHz、500MHz、1GHz、2GHz (アップグレード可能)

### サンプル・レート (全アナログ/デジタル・チャンネル)

- リアルタイム : 6.25GS/s
- 補間 : 500GS/s

### レコード長 (全アナログ/デジタル・チャンネル)

- 62.5Mポイント (標準)
- 125、250、500Mポイント (オプションおよびアップグレード可能)

### 波形取込みレート

- 500,000 波形/秒以上

### 垂直分解能

- 12ビットADC
- 最高16ビット (ハイレゾ・モード)

### 標準のトリガ・タイプ

- エッジ、パルス幅、ラント、タイムアウト、ウィンドウ、ロジック、セットアップ/ホールド時間、立上り/立下り時間、パラレル・バス、シーケンス、ビジュアル・トリガ、ビデオ (オプション)、RF対時間 (オプション)

### 標準解析機能

- カーソル : 波形、垂直バー、水平バー、垂直/水平バー
- 測定項目 : 36種類

- Spectrum View : 周波数領域解析 (周波数領域と時間領域は独立して設定可能)
- FastFrame™ : セグメント・メモリ・アクイジション・モードにより、毎秒最大5,000,000フレームを超える取込みが可能
- プロット : タイム・トレンド、ヒストグラム、スペクトラム、および位相ノイズ
- 演算機能 : 基本波形演算、FFT、拡張数式エディタ
- サーチ機能 : 任意のトリガ条件で検索が可能
- ジッタ : TIE および位相ノイズ

### オプションの解析 (オプションおよびアップグレード可能)

- 拡張ジッタ/アイ・ダイアグラム解析ソフトウェア
- ユーザ定義フィルタリング
- 高度な Spectrum View
- RF対時間波形、トリガ、スペクトログラム、およびIQキャプチャ
- デジタル電源管理
- マスク/リミット・テスト
- インバータ、モータ、ドライブ
- LVDSのデバッグ/解析
- PAM3解析
- 拡張パワー測定/解析
- 拡張ベクトル信号解析 (SignalVu-PC)

### オプションのプロトコルのトリガ、デコード、解析 (オプションおよびアップグレード可能)

I<sup>2</sup>C、SPI、eSPI、I3C、RS-232/422/485/UART、SPMI、SMBus、CAN、CAN FD、CAN XL、LIN、FlexRay、SENT、PSI5、CXPI、車載用 Ethernet、MIPI C-PHY、MIPI D-PHY、USB 2.0、eUSB2.0、Ethernet、EtherCAT、オーディオ、MIL-STD-1553、ARINC 429、Spacewire、8B/10B、NRZ、マンチェスター、SVID、SDLC、1-Wire、MDIO および NFC

### オプションのシリアル・コンプライアンス・テスト (オプションおよびアップグレード可能)

- Ethernet、USB 2.0、車載用 Ethernet、産業用 Ethernet

### 任意波形/ファンクション・ジェネレータ (オプションおよびアップグレード可能)

- MHz 波形の生成
- 波形タイプ : 任意波形、正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、三角波、DC レベル、ガウシアン、ローレンツ、指数立上り/立下り、Sin(x)/x、ランダム・ノイズ、ハーバーサイン、心電図

**デジタル電圧計(製品登録により無料で提供)**

- 4 桁の AC 実効値電圧、DC 電圧、および DC + AC 実効値電圧測定

**周波数カウンタ(製品登録により無料で提供)**

- 8 桁

**ディスプレイ**

- 15.6 型 (396 mm) TFT カラー
- 解像度 : HD (1,920×1,080)
- 静電容量式 (マルチタッチ) タッチスクリーン

**拡張機能**

- USB ホスト (7 ポート)、USB 3.0 デバイス (1 ポート)、LAN (10/100/1000 Base-T Ethernet; LXI 互換)、Display Port、DVI-D、VGA

**e\*Scope<sup>®</sup>**

- 標準の Web ブラウザを介した、ネットワーク接続経由でのオシロスコープの遠隔表示/制御が可能

**標準プローブ**

- 10MΩ 受動電圧プローブ (容量負荷 : 4pF 未満)、1ch に 1 本

**保証期間**

- 3 年間 (標準)、トータル保証サービス・プラン (オプション)

**寸法**


- 309 mm×454 mm×204 mm (高さ x 幅 x 奥行)
- 質量 : 11.4 kg

**チャンネル数の不足によって、検証やデバッグの作業が遅れる心配はもうありません。**

5 シリーズ MSO は、4、6、8 チャンネルの機種が用意されており、15.6 型 HD (1,920×1,080) ディスプレイを備えているため、複雑なシステムも効率的に解析できます。組込みシステム、三相パワー・エレクトロニクス、カー・エレクトロニクス、電源設計、DC-DC パワー・コンバータなど、多くのアプリケーションでは、デバイス性能の検証や特性評価、複雑なシステムの問題のデバッグを行うために、4 つ以上のアナログ信号を観測する必要があります。

ほとんどのエンジニアは、非常に困難な問題のデバッグ中に、システムをより詳細かつ広範囲に解析する必要があったのに、使用しているオシロスコープのアナログ・チャンネル数が 2 つ、あるいは 4 つに限られていたという体験をしているはずですが、オシロスコープをもう 1 台追加したとしても、トリガ・ポイントを揃えなければならないだけでなく、2 つのディスプレイに渡ってのタイミング相関や、データの文書化において、大きな困難が付きまといま

6 および 8 チャンネルのオシロスコープの価格は、4 チャンネルのモデルより、少なくとも 50% または 100% 高くなるはずだ、と思われがちですが、実際に追加になる価格は、6 チャンネルの機種で 25% 以下、8 チャンネルの機種では 67% 以下に過ぎません。わずかなコストでアナログ・チャンネルを追加するだけで、プロジェクトを常に予定通りに進めることができるようになります。

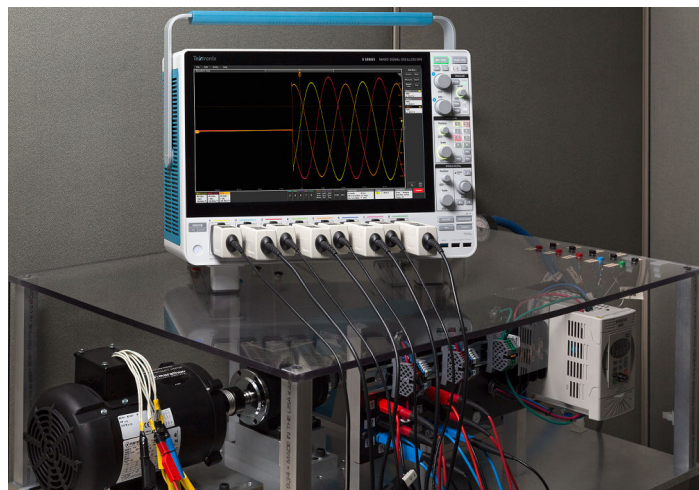

三相モータの電圧測定。起動後の三相入力電圧が表示されている

**優れた柔軟性を持ち、システム全体の広範囲な観測が可能な FlexChannel<sup>®</sup>技術**

5 シリーズ MSO には、従来のミックスド・シグナル・オシロスコープ (MSO) の常識を超える新技術が取り入れられています。FlexChannel 技術により、それぞれのチャンネル入力を 1 つのアナログ・チャンネル、8 つのデジタル・チャンネル (TLP058 型ロジック・プローブを使用)、またはそれぞれの領域を独立に設定し、アナログとスペクトラム

を同時に表示することもできます。従来にない、柔軟なチャンネル構成が可能です。

8つのFlexChannelを備えた機種の場合、8つのチャンネルをすべてアナログ信号に割り当て、デジタル信号は未使用という構成も可能です。さらに、7つのアナログと8つのデジタル、あるいは6つのアナログと16のデジタル、5つのアナログと24のデジタルなど、柔軟な組み合わせが可能です。こうした構成は、TLP058型ロジック・プローブを着脱するだけで、いつでも簡単に変更できます。そのため、常に最適な数のデジタル・チャンネルを確保できます。




優れた柔軟性を実現したFlexChannel技術では、接続するプローブの種類により、1つのアナログ・チャンネルとして使用するか、8つのデジタル・チャンネルとして使用するかを柔軟に選択できる


従来のMSOでは、デジタル・チャンネルはアナログ・チャンネルに比べてサンプル・レートが低く、レコード長も短いなど、さまざまなトレードオフがありました。5シリーズMSOでは、デジタル・チャンネルを新しいレベルで統合できます。デジタル・チャンネルでも、アナログ・チャンネルと同様に、高サンプル・レート（最高6.25 GS/s）と長いレコード長（最大500 Mポイント）を利用できます。



TLP058型：8つの高性能デジタル入力を装備TLP058型プローブは、必要に応じて何本でも接続することができ、最大64チャンネルのデジタル入力を利用可能

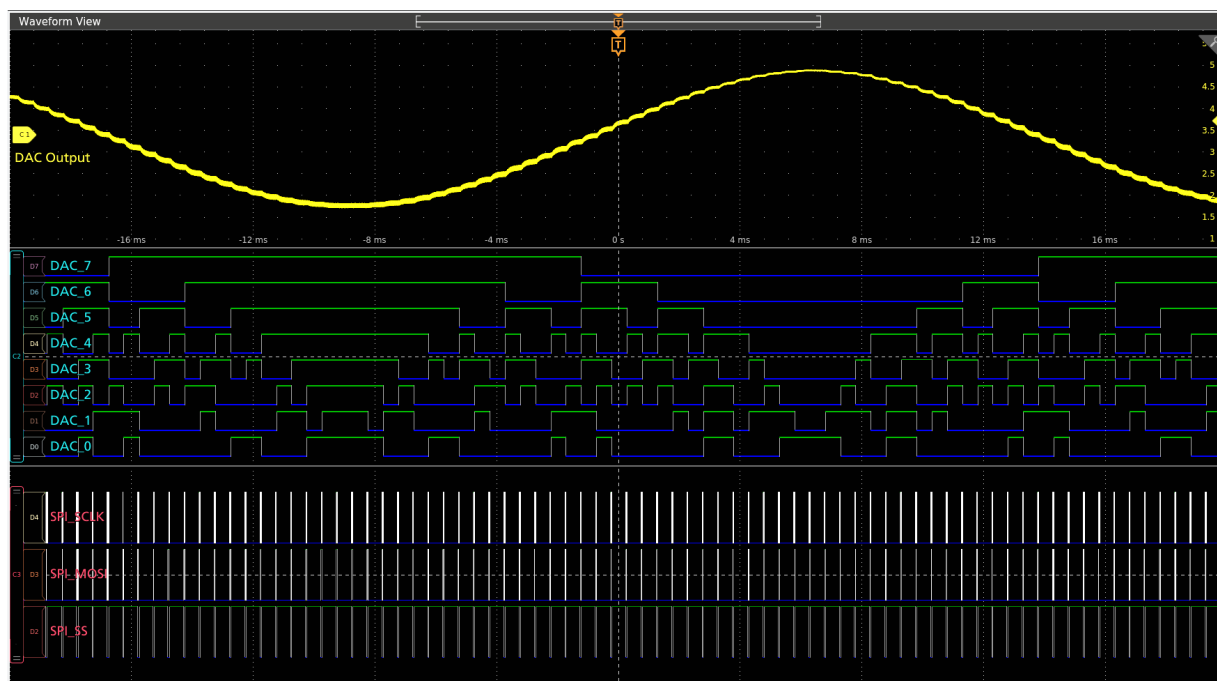

Ch 2 に TLP058 型ロジック・プローブを取り付け、DAC の 8 つの入力を接続している。緑と青に色分けされており、緑が1、青が0を示している。Ch 3 に取り付けたもう1本のTLP058型ロジック・プローブは、DACをドライブするSPIバスにプロービングしている。白いエッジは高周波成分が含まれていることを示しており、拡大表示するか、より高速なサンプル・レートで取込むことでより詳細な情報が得られる

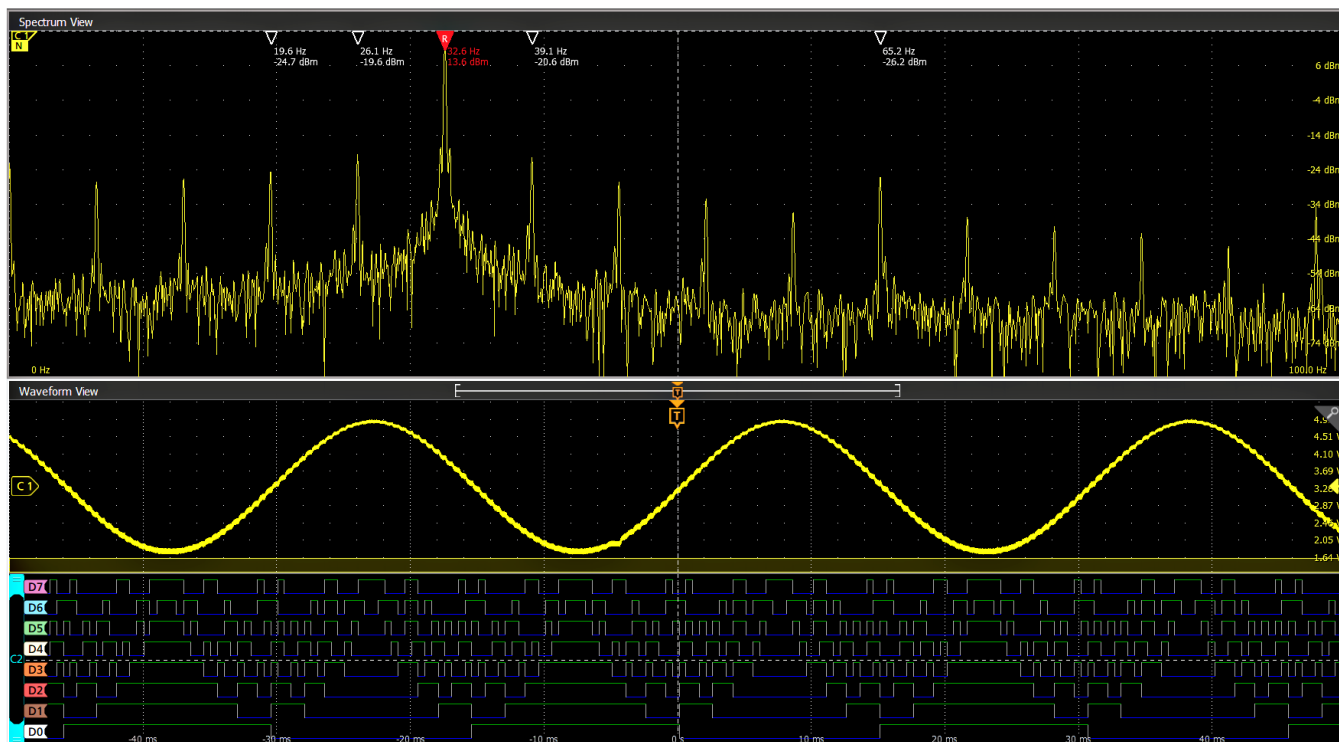


アナログとデジタルだけでなく、FlexChannel 入力は Spectrum View にも対応。この当社の特許技術を使用することで、各領域で独立に設定しながら、すべてのアナログ信号について、アナログ表示とスペクトラム表示を同時に観測可能。スペクトラム・アナライザを使用するときと同じ感覚で、オシロスコープを使用して簡単に周波数領域の解析が可能。周波数領域と時間領域の現象を関連付ける機能も維持されている

## 優れた信号表示機能

15.6 型 (396mm) ディスプレイは、業界トップクラスの大型ディスプレイで、従来の 10.4 型 (264mm) ディスプレイの 2 倍以上の広い表示領域があります。さらに、解像度もトップクラスで、フル HD の解像度 (1,920×1,080) を備えてい

るため、重要なリードアウトや解析のための領域を確保しながら、多くの信号を同時に観測できます。

表示領域は、垂直方向のスペースを波形表示に最大に利用できるように、最適化されています。右側の結果バーを非表示にすると、画面の横幅全体を波形表示に使用できます。

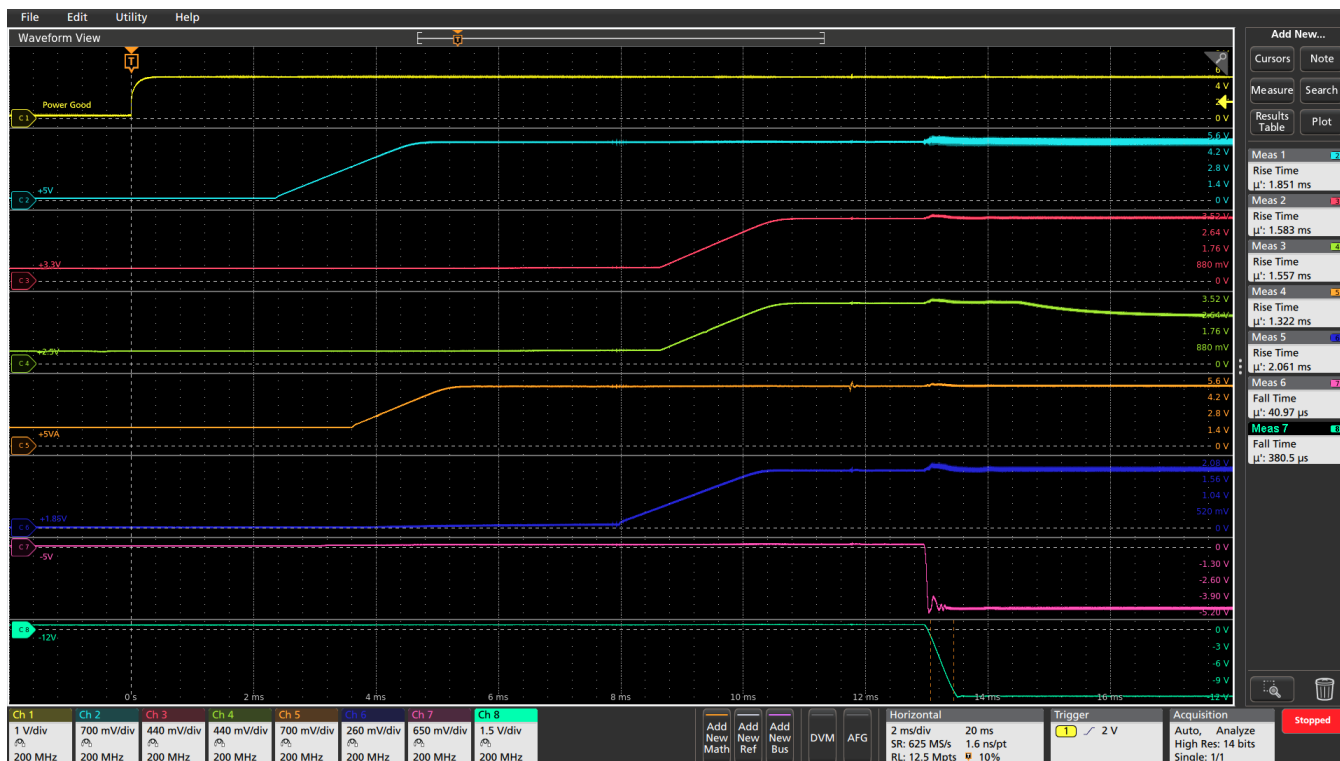

スタック表示モードでは、各入力のADコンバータの分解能を最大に維持しながら、すべての波形を簡単に観測できるため、精度の高い測定が行える


5 シリーズ MSO は、最新技術のスタック表示モードを備えています。従来、オシロスコープでは同じ目盛にすべての波形を重ねて表示していたため、さまざまなトレードオフが生じていました。

- それぞれの波形を表示するには、波形が重なり合わないよう、波形の垂直軸スケールと位置を調整しなければならない。それぞれの波形で利用できるADコンバータのレンジがわずかしかないため、測定精度が低下する
- 測定精度を維持するためには、それぞれの波形の垂直軸スケールと位置を調整して、画面全体に表示する必要がある。波形が互いに重なり合うため、個々の波形では信号の細部まで識別しにくい

新しいスタック表示では、これらのトレードオフが解消されます。波形のオン/オフが行われると、自動的に水平波形の"スライス" (追加の目盛) が追加または削除されます。それぞれのスライスが、その波形のADコンバータの全レ

ンジを使用します。すべての波形は、別々に表示されていますが、ADコンバータの全レンジが使用されているため、表示機能と精度が最大に活かされます。これらの処理は、波形が追加または削除されると、すべて自動的に行われます。スタック表示モードでは、チャンネル/波形バッジをディスプレイ下部の設定バーにドラッグ・アンド・ドロップするだけでチャンネルの順序を簡単に変更できます。スライスの内部にチャンネルのグループをオーバーレイすることもできるため、信号の表示を見ながら簡単に比較できます。

ディスプレイを備えており、広い表示領域を確保できるため、信号だけでなく、プロット、測定結果テーブル、バス・デコード・テーブルなど、豊富な情報を表示できます。アプリケーションに合わせて、サイズや位置も簡単に変更できます。

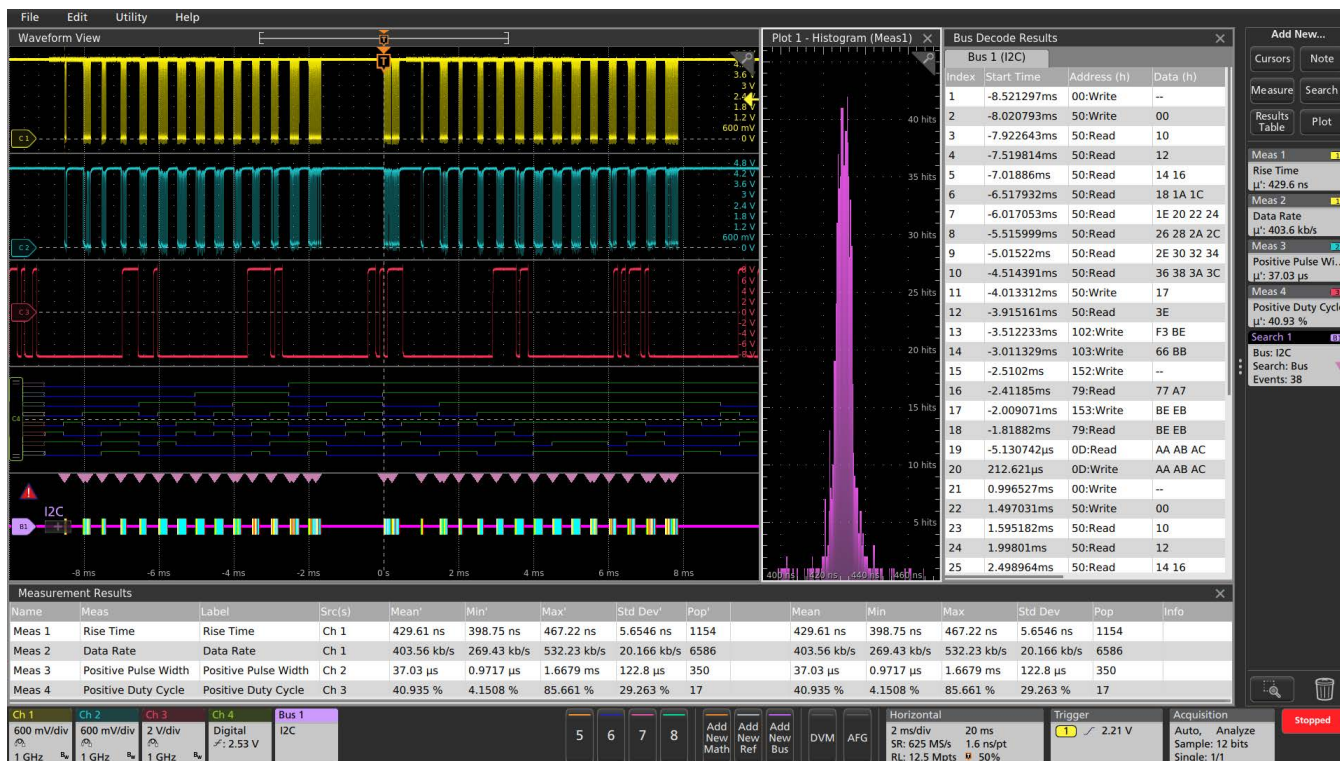

3つのアナログ・チャンネル、8つのデジタル・チャンネル、デコードしたシリアル・バス波形、デコードしたシリアル・パケット結果テーブル、4つの測定項目、測定ヒストグラム、測定結果テーブルを統計情報とシリアル・バス・イベント検索結果とともに表示して、と同時に表示できます。

## タスクに集中できる使いやすいユーザ・インターフェース

### 設定バー: 主要パラメータと波形の管理


ディスプレイ下部の設定バーには、波形、オシロスコープの動作に関連する各種のパラメータが、"バッジ"として一列に表示されます。設定バーを使用すると、使用頻度の高い波形管理タスクにすばやくアクセスできます。以下のような操作は、シングル・タップで実行できます。

- チャンネルをオンにする
- 演算波形の追加
- リファレンス波形の追加
- バス波形の追加
- オプションの任意波形／ファンクション・ジェネレータ (AFG) を有効にする
- オプションの内蔵デジタル・ボルトメータ (DVM) を有効にする

### 結果バー: 解析と測定

ディスプレイ右側の結果バーは、タップするだけで、カーソル、測定、サーチ、測定／バス・デコード結果テーブル、プロット、メモなど、使用頻度の高い解析ツールにすばやくアクセスできます。

DVM／測定／サーチ結果バッジは、すべて結果バーに表示されるため、波形表示エリアを圧迫することはありません。波形表示エリアをさらに広くしたい場合には、結果バーを消すこともできます。もちろん、いつでも再表示できます。

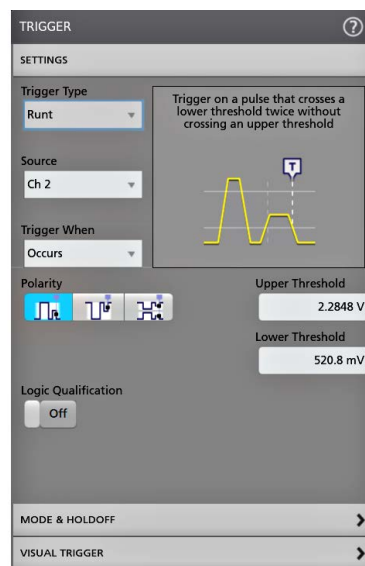

ディスプレイ上の目的のアイテムをダブルタップするだけで構成メニューが表示される。この例では、トリガ・バッジがダブルタップされたので、トリガ構成メニューが表示されている

## オシロスコープに最適化されたタッチ操作

タッチ・インタフェースを備えたオシロスコープは、今では決して珍しいものではありません。しかし、それらはすべて、後から付け足した機能に過ぎませんでした。5 シリーズ MSO は、静電容量方式のタッチスクリーンを備えた 15.6 型ディスプレイと、タッチ操作に最適化されたユーザ・インタフェースを備えた業界初のオシロスコープです。

スマホやタブレット、その他のタッチスクリーン対応デバイスでお馴染みのタッチ操作がサポートされています。

- 波形を左右上下にドラッグすることで、水平／垂直位置の調整やパン／ズーム表示が可能
- ピンチ操作により、水平または垂直方向のスケールの変更やズーム・イン／アウトが可能
- 画面の端からアイテムをドラッグして削除
- 右側からスワイプ（結果バーを表示）または上側からスワイプ（ディスプレイの左上にメニューを表示）

操作性に優れた前面パネル操作部を使用して、馴染みのあるノブやボタンによる調整を行えるだけでなく、マウスやキーボードを使用することもできます。



スマホやタブレットと同じ静電容量方式のタッチスクリーンを使用して操作が可能です。

## 可変フォント・サイズ

従来、オシロスコープのユーザ・インタフェースでは、波形やリードアウトの表示を最適化するために、フォント・サイズを固定して設計されてきました。すべてのユーザが同じ表示設定であれば問題になりませんが、そうではない場合もあります。ユーザは画面を長時間凝視しなければならないため、これは大きな問題であると認識しています。5 シリーズ MSO は、可変フォント・サイズを実現しており、好みに合わせて、12 ポイント～20 ポイントまで自由に設定できます。フォント・サイズを調整すると、ユーザ・インタフェースは連動して拡大縮小するため、アプリケーションに合わせて最適なサイズに設定することができます。





フォント・サイズに応じてユーザ・インターフェースも連動する



作業効率に優れ、直観的な前面パネル。必要な操作部をすべて備えながら、15.6 型 HD ディスプレイの広い表示領域を十分に確保

## 前面パネルによる操作

従来、オシロスコープ前面は、表面の約 50%がディスプレイ、残りの 50%が操作部という構成が一般的でした。5 シリーズ MSO は、本機前面の約～85%がディスプレイで占められています。広い表示領域を確保するために、前面パネルの構造を見直し、重要性の高い操作については、従来からの簡単で直観的な操作を維持する一方で、ディスプレイ上のオブジェクトから各種の機能に直接アクセスできるようにしたことで、メニュー・ボタンの数を減らすことに成功しています。

操作部の周囲が LED で色分けされるため、トリガ・ソースや垂直軸スケール／ポジション・ノブがどのチャンネルに

割り当てられているのか一目でわかります。実行／停止やシングル・シーケンスといった機能については、大きな専用ボタンが右上の目立つ場所に配置されています。強制トリガ、トリガ・スロープ、トリガ・モード、デフォルト・セットアップ、オートセット、クイックセーブといった機能についても、すべて専用の前面パネル・ボタンを使用できます。

## Windows 環境の導入を選択可能

5 シリーズ MSO は、Microsoft Windows™ オペレーティング・システムを使用するかどうかを、ユーザ自身が選択できるようにした、最初のおシロスコープです。機器底部のアクセス・パネルを開くと、ソリッド・ステート・ドライブ (SSD) を接続するコネクタがあります。SSD が装着されていないときはオシロスコープ専用機として起動するため、他のプログラムをインストールして実行することはできません。

SSD が装着されている場合は、オープンな Windows10 上にシステムが構成されるため、オシロスコープ・アプリケーションを最小化することで Windows デスクトップにアクセスできます。もちろん、他のアプリケーションをインストールしたり、モニタを追加することで、デスクトップを拡張することができます。

Windows を使用する、しないにかかわらず、オシロスコープの動作はまったく同じで、操作性、UI の操作方法にも違いはありません。

## 高チャンネル密度にも対応可能

5 シリーズ MSO では、ロー・プロファイル・タイプの MSO58LP 型も用意されています。高さ 2U のコンパクトなサイズに 8 つの入力チャンネル (1GHz) と補助トリガ入力、12 ビットの A/D コンバータを装備した 5 シリーズ MSO ロー・プロファイルは、高いチャンネル密度が求められるアプリケーションに対しても余裕を持って対応できます。




## 優れた性能


最高 2GHz のアナログ周波数帯域、6.25GS/s のサンプル・レート、62.5M ポイントのレコード長（標準装備）、12 ビットの ADC を備えた 5 シリーズ MSO は、優れた信号忠実度、分解能で波形の細部まで取込むことができます。

### デジタル・フォスファ技術と FastAcq™ 高速波形取込み

設計上の問題をデバッグするためには、まず問題の存在を知る必要があります。FastAcq とデジタル・フォスファ技術により、デバイスの実際の動作を確認することができます。毎秒 500,000 波形以上という高速の波形取込レートにより、デジタル・システムでよく見られるラント・パルス、グリッチ、タイミング問題など、間欠的に発生する問題も非常に高い確率で観測することができます。まれにしか発生しないイベントをはっきりと表示させるため、輝度階調表示を使用することで、通常の信号特性に対する、まれなランジェントの発生頻度を表示します。

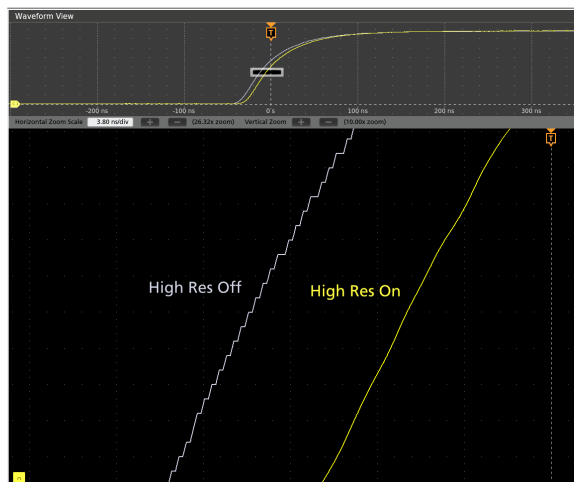

12 ビットの ADC と新しいハイレゾ・モードにより、業界トップクラスの垂直分解能を実現しています。

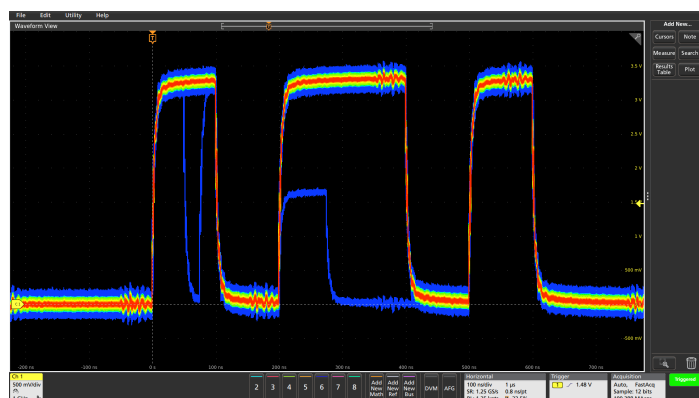

FastAcq の高速取込みにより、デジタル設計によく見られる捕捉困難な問題も検出できます。

### 業界トップクラスの垂直分解能

大きな振幅の信号を取込みながら、信号の細部まで観察しなければならない場合でも、5 シリーズ MSO は、不要なノイズの影響を最小限に抑えながら、目的の信号を確実に取込める性能を備えています。本機を中心となる技術は、12 ビットの AD コンバータ（ADC）であり、従来の 8 ビット ADC の 16 倍という優れた垂直軸分解能を実現しています。

新しいハイレゾ・モードでは、選択されたサンプル・レートに基づいて、ハードウェア・ベースの独自の有限インパルス応答（FIR）フィルタが適用されます。FIR フィルタは、そのサンプル・レートで利用可能な最高帯域幅を維持しながら、エイリアシングを抑制し、選択したサンプル・レートに対する使用可能帯域幅を上回る雑音をオシロスコープの増幅器や ADC から除去します。ハイレゾ・モードでは、常に最低でも 12 ビットの垂直分解能が確保され、125MS/s 以下のサンプル・レートでは垂直分解能は 16 ビットにまで拡張されます。


新しい低ノイズのフロント・エンド増幅器により、信号解像能力がさらに向上しています。

## トリガ

デバイスの障害を検出するのは、デバッグの第 1 段階です。次に、原因を特定するために、想定されるイベントを取込まなければなりません。5 シリーズ MSO は、さまざまなタイプに対応した、高度なトリガ機能を提供しています。

- ラント
- ロジック
- パルス幅
- ウィンドウ
- タイムアウト
- 立上り／立下り時間
- セットアップ／ホールド時間違反
- シリアル・パケット
- パラレル・データ
- シーケンス
- ビデオ
- ビジュアル・トリガ
- RF 周波数対時間
- RF 振幅対時間

最大 500M ポイントのレコード長により、数多くのイベントを取込むことができます。数千というシリアル・パケットでも 1 回で取込むことができ、高い分解能のままズーム表示して詳細に信号を観測し、信頼性の高い測定結果を記録できます。

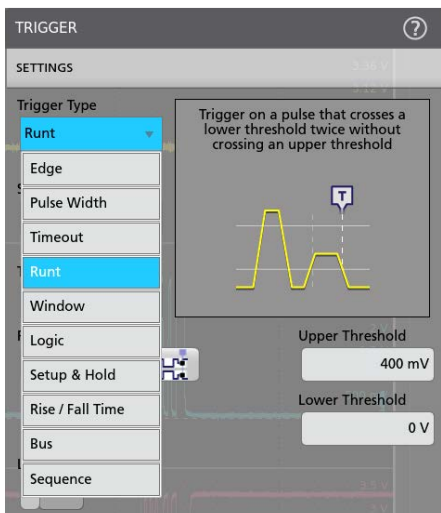


さまざまなトリガ・タイプに対応し、状況対応型のトリガ・メニューも備えているため、目的のイベントを簡単に特定できる

### ビジュアル・トリガ – 特定の信号をすばやく検出


複雑なバスから特定のサイクルを検出するには、何時間もデータを取込み、何千というアキュイジションを調べる必要があります。そのイベントが発生したときのみ表示するようにトリガ設定できれば、この時間を短縮することができます。

ビジュアル・トリガは、オシロスコープのトリガ機能を拡張し、取込んだすべての波形取込をスキャンし、ディスプレイに表示されるエリア（図形形状）と比較します。マウスまたはタッチスクリーンにより、無制限数のエリアを作成できます。さまざまな形状（三角形、長方形、六角形、台形）を使用して、さまざまなトリガ動作に対応するエリアが設定できます。形状が作成できれば、必要に応じてカスタム形状を作成し、理想的なトリガ条件になるように編集することもできます。複数のエリアを定義すれば、オンスクリーンの編集機能を使用して、ブール論理式を使用した複雑なトリガ条件を設定できます。

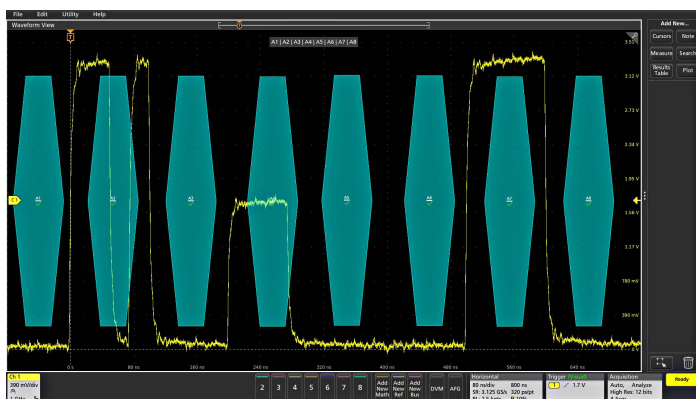

ビジュアル・トリガのエリアが目的のイベントを分離し、観測したいイベントのみを取り込めるため、大幅な時間短縮が可能

重要な信号イベントにのみトリガすることで、手作業での取込み、アキュイジションから検索するのに要する時間を大幅に短縮できます。秒、分の単位で重要なイベントが検出でき、短時間のうちにデバッグ／解析作業を終わらせることができます。ビジュアル・トリガは複数のチャンネルに対しても使用できるため、複雑なシステムのトラブルシューティングやデバッグにも最適です。

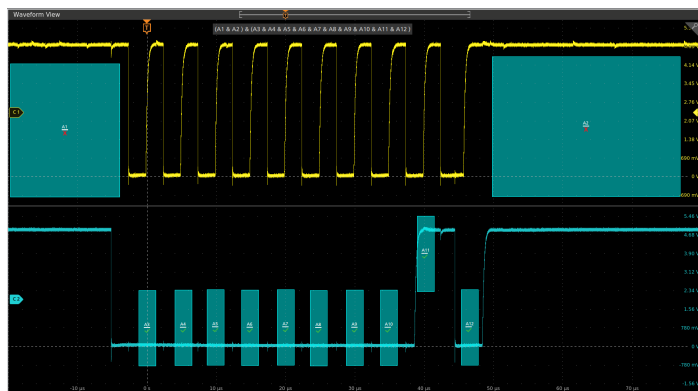

複数チャンネルでの観測例。ビジュアル・トリガのエリアは複数のチャンネルのイベントにも設定できる（チャンネル1で特定のバースト幅にトリガし、チャンネル2で特定のビット・パターンにトリガするなど）

### 正確で高速プローブ

TPP シリーズは、広いダイナミック・レンジ、豊富なプロービング・オプション、堅牢な機械設計などの汎用プローブの特長と、アクティブ・プローブの優れた性能を併せ持っています。1GHzのアナログ周波数帯域により、信号の高周波成分も観測できます。また、容量負荷がわずか 3.9pF と優れており、回路に及ぼす影響が最小に抑えられるため、長いグランド・リードも使用できます。

減衰比が 2 : 1 の TPP プローブ（オプション）も用意されているため、低電圧の測定にも対応できます。一般的な低い減衰比の受動プローブと違い、TPP0502 型の周波数帯域は 500MHz でありながら、容量負荷も 12.7pF と抑えられています。



本機には1チャンネルにTPP0500B (350 MHz、500 MHz の機種) または TPP1000 (1 GHz、2 GHz の機種) プローブが1つ標準で付属します

### TekVPI プローブ・インタフェース

TekVPI®プローブ・インタフェースは、プローブの使い勝手が格段に向上しています。安全性と信頼性に優れた接続が可能だけでなく、TekVPI プローブの補正ボックス上には、多くのステータス・インジケータ、操作ボタンおよびプローブ・メニュー・ボタンが装備されています。このプローブ・メニュー・ボタンを押すと、すべてのプローブ設定や操作メニューがオシロスコープ上にプローブ・メニューとして表示されます。TekVPI インタフェースは、外部電源の必要なしに電流プローブを直接接続することができます。さらに TekVPI プローブは、USB または LAN 経由でリモート制御できますので、自動試験装置においても汎用性の高いソリューションが可能になります。5 シリーズ MSO の前面パネル・コネクタには、最高 80W の電力給電が可能で、接続されたすべての TekVPI プローブに十分な電力を供給できるため、プローブ専用の電源を追加する必要がありません。

### IsoVu™光アイソレーション型測定システム

インバータの設計、電源の最適化、通信リンクのテスト、シャント抵抗による電流の検出、EMI/ESD 問題のデバッグを行う場合、あるいはテスト・セットアップからグラウンド・ループを取り除きたい場合、コモンモード干渉があると正確な測定が困難になり、設計/デバッグ/評価/最適化といった作業に支障が生じていました。

当社の画期的な新技術 IsoVu では、光給電型光ファイバを使用することにより、完全なガルバニック絶縁を可能にしています。TekVPI インタフェースを搭載した 5 シリーズ MSO で使用すると、大きなコモンモード電圧がある場合でも、高い周波数の差動信号を正確に測定できる機能を備えた、業界初の測定システムが実現します。

- 完全なガルバニック絶縁
- 最高 1GHz の周波数帯域に対応
- 同相除去比 (CMRR) : DC~100MHz で 120dB (100 万 : 1) 以上

- 同相除去比 (CMRR) : 全帯域で 80dB (10,000 : 1)
- 差動電圧のダイナミック・レンジ : 最高 2,500V
- コモンモード電圧レンジ : 60kV




テクトロニクスの TIVP シリーズ IsoVu™ 測定システムは、全帯域でクラス最高の同相除去性能を実現したガルバニック絶縁測定ソリューションであり、大きなコモン・モード電圧が存在する条件でも、最大 2,500 Vpk の広帯域差動信号が正確に分離可能

### IsoVu を使用したハイサイド・ゲート電圧測定

次の図は、標準差動プローブを使用したときのハイサイド・ゲート電圧と、光絶縁型プローブを使用したときのハイサイド・ゲート電圧との比較を示しています。オフおよびオンのときはどちらのプローブでも、デバイスのゲートがスレッシュホールド値の領域を通過した後に、ゲートにおいて高周波数リングングが見られます。ゲートと電源ループのカップリングにより、ある程度のリングングが予想されます。ただし、差動プローブの場合、リングングの振幅は光絶縁型プローブで測定される振幅よりも著しく高くなります。これは、プローブ内でコモン・モード電流を誘起する基準電圧の変化、および標準差動プローブのアーチファクトが原因と考えられます。差動プローブによって測定された波形は、デバイスの最大ゲート電圧を通過しているように見えます。一方、光絶縁型プローブでは、測定精度が高いほどデバイスが仕様範囲内にあることが明らかになっています。ゲート電圧測定に標準差動プローブを使用するアプリケーション設計者は、ここに示したプローブおよび測定システムのアーチファクトと、デバイス定格の実際の違反を区別できない可能性があるため、注意が必要です。この測定時のアーチファクトが発生したときに、設計者はゲート抵抗を高くして、スイッチング過渡現象を遅くしようとしたり、リングングを減らそうとするかもしれません。しかし、そのようにすると、SiC デバイスでの損失を不必要に増加させることとなります。このため、適切なシステム

を設計して性能を最適化するためには、デバイスの実際の変動を正確に反映する測定システムが不可欠となります。

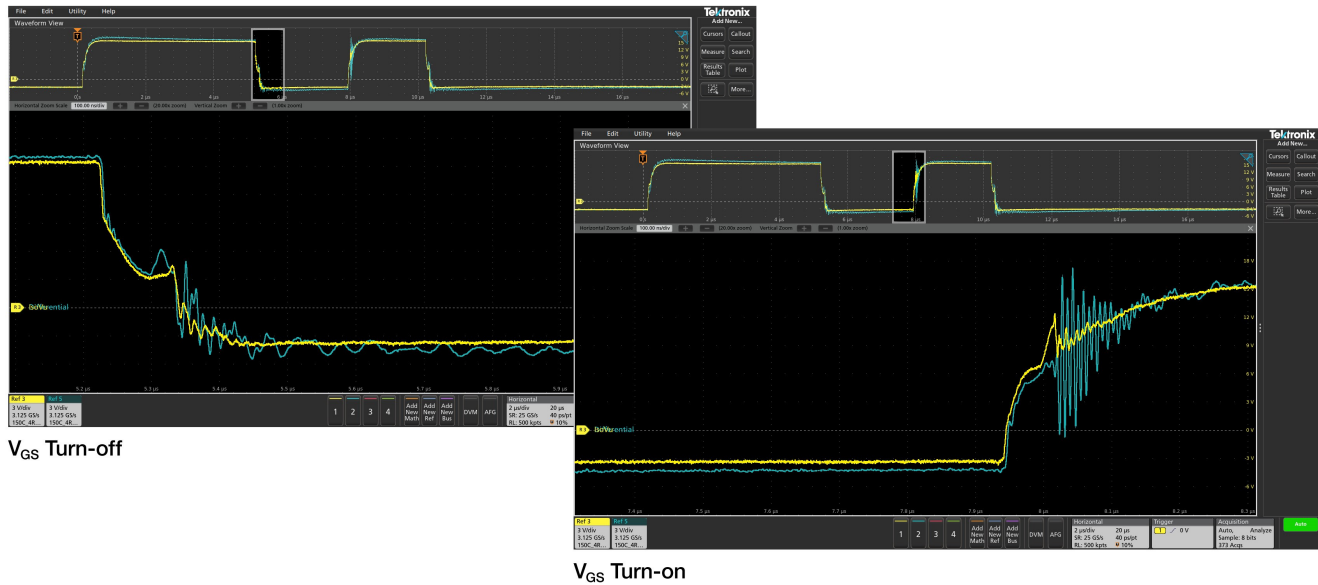

差動プローブ(青色のトレース)とIsoVu 光絶縁型プローブ(黄色のトレース)

## 豊富な解析機能

### 基本波形解析機能

プロトタイプのパフォーマンスがシミュレーション結果と一致していることを検証するためには、注意深く解析を行う必要があります。そこには、立ち上がり時間やパルス幅のチェックといった単純なものから、電力損失の解析、システム・クロックの特性評価、ノイズ発生源の調査といった高度なものまで、さまざまな作業が伴います。

5 シリーズ MSO は、以下の豊富な解析ツールなどを標準で備えています。

- 波形 / スクリーン・ベースのカーソル
- 36 種類の自動測定結果にはレコードのすべてのインスタンスが含まれており、あるイベントから次のイベントへとナビゲートできるだけでなく、レコードの最小値または最大値をすばやく表示することも可能

- 基本波形演算
- 基本 FFT 解析
- フィルタや変数を使用した任意波形の数式編集などの高度な波形演算
- Spectrum View 周波数領域解析（時間領域と周波数領域は独立して設定可能）
- FastFrame™ セグメント・メモリにより、オシロスコープのアクイジション・メモリを効率的に活用できるため、1つの波形レコードに数多くのトリガ・イベントを効率的に取込むことができ、イベント間の時間ギャップを無視できます。各セグメントは個別に、または重ねて表示できます。

標準の振幅測定と時間測定では、波形表示にバーやマーカーを付けて、関連情報を示します。測定結果テーブルには、測定結果についての総合的な統計表示のほか、現在のアクイジションと、すべてのアクイジションの両方を対象とした統計値も表示されます。




自動測定により、電源を評価。

## コールアウト

1. **注**：書込んだテキスト・ボックスを画面上に配置します。
2. **矢印**：書込んだテキスト・ボックスを配置し、画面上の特定の位置に矢印を追加します。
3. **ボックス**：テキストを書込み、画面上にサイズ変更可能なボックスとして示される領域を作成します。
4. **ブックマーク**：トリガ・ポイントに関連する特定の時間に動的リードアウトを作成します。このリードアウトには、テキスト、信号の振幅、信号単位に加えて、ブ

クマークの基準ポイントを示す線とターゲットが含まれます。

テストの結果や手順を文書化することは、チーム間でデータを共有したり、後日の再測定、顧客レポートを作成する際に非常に重要です。画面上で数回タップするだけで、必要な数だけカスタム・コールアウトを作成できるため、テスト結果の具体的な詳細を文書化することができます。それぞれのコールアウトは、テキスト、位置、色、フォント・サイズ、フォントをカスタマイズできます。

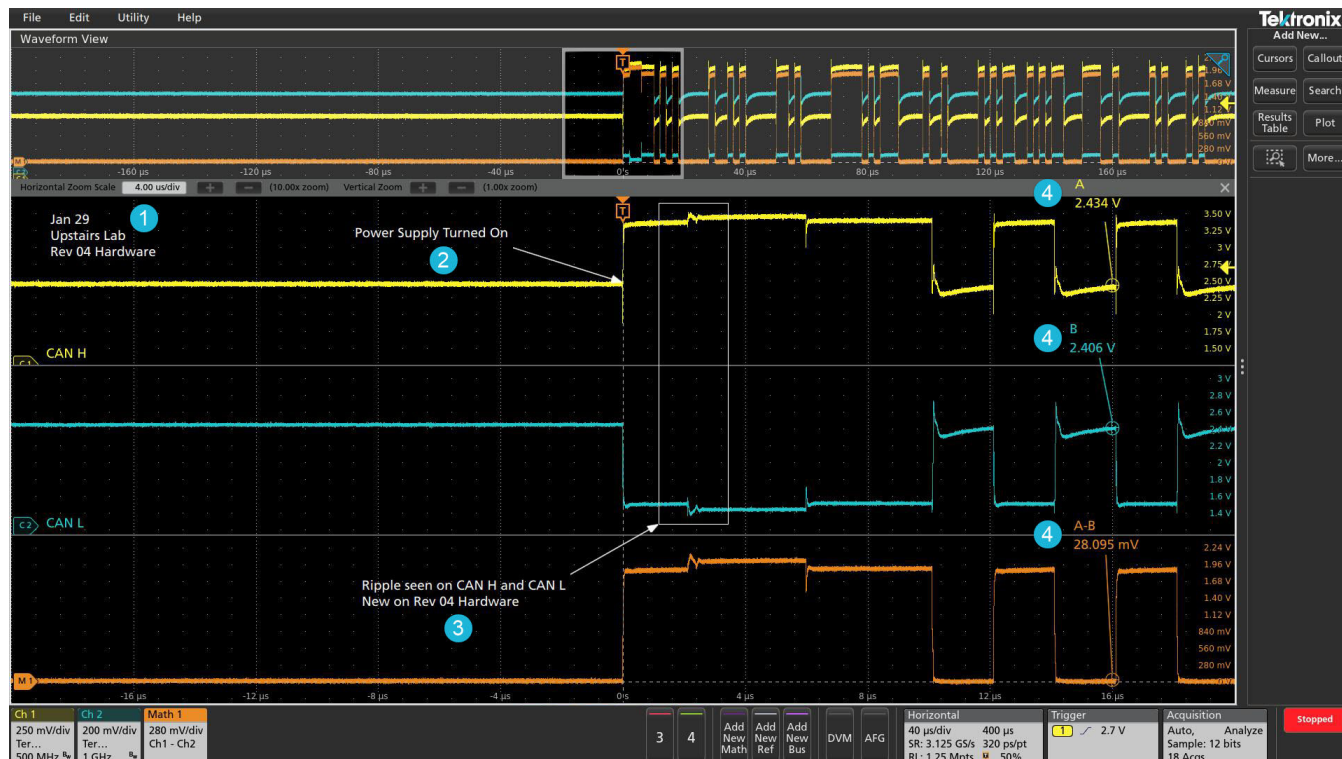

テスト・セットアップの詳細とそれに対応する結果を詳細に記述したコールアウト（注釈、矢印、ボックス、ブックマーク）を簡単に使用可能。




## ナビゲーションとサーチ

長い記録長の波形から目的のイベントを探す場合、適切なサーチ・ツールがないと時間のかかる作業になります。今では記録長は数百万ポイントにもなり、目的のイベントを特定するためには数千画面をスクロールしなければなりません。

5 シリーズ MSO には、革新的な Wave Inspector<sup>®</sup> という波形検索、操作ツールがあり、波形記録内をすばやくパン、ズーム表示することができます。独自のフォースフィードバック・システムにより、波形記録の最初から最後までをわずか数秒で移動できます。ディスプレイ上でドラッグやピンチ／拡大といったジェスチャを使用すれば、長い記録でも目的の領域を効率的に調査できます。

サーチ機能では、独自に定義した条件でロング・メモリ上のイベントを検索できます。条件に該当するすべてのイベントには検索マークが付き、前面パネルまたはディスプレイのサーチ・バッジの戻る (←)、次へ (→) ボタンを押すことで、イベント箇所に簡単に移動することができます。サーチの種類には、エッジ、パルス幅、タイムアウト、ラント、ウィンドウ、ロジック、セットアップ／ホールド、立上り／立下り時間、パラレル／シリアル・バス・パケットのデータなどがあります。独自のサーチを定義することもできます。

サーチ・バッジの Min/Max ボタンを使用すると、検索結果の最小値および最大値にすばやくジャンプできます。

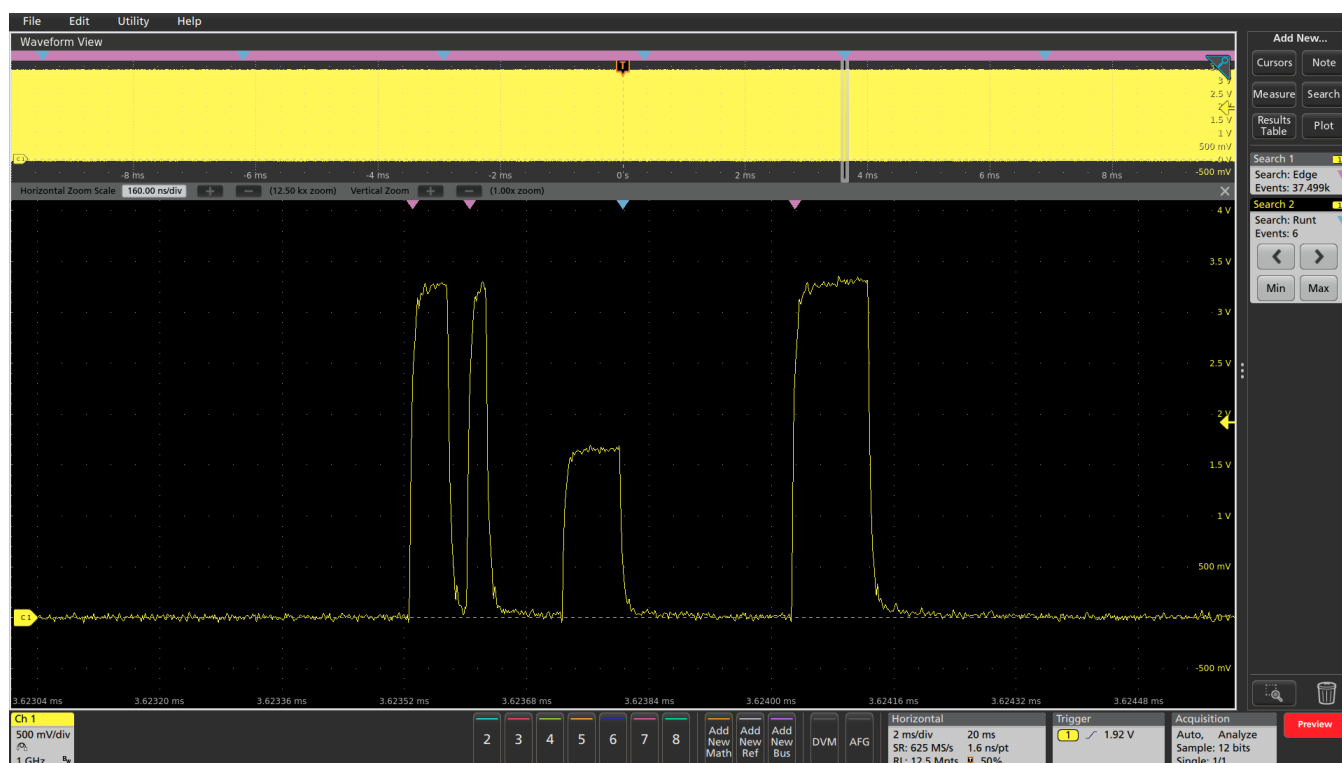

FastAcq によって、デジタル・データ・ストリームにラント・パルスが存在することが明らかになったため、さらに調査を進めた例。この 20ms という長時間のアクイジションでは、Search 1 の結果から、アクイジションに約 37,500 回の立上りエッジがあることが明らかになった。Search 2 (同時に実行) では、アクイジションでラント・パルスが 6 回発生していることが示されている

## マスク/リミット・テスト(オプション)


シグナル・インテグリティにフォーカスしたい場合、または製造試験の合否条件を設定する場合にも、マスク・テストは、システム内の特定の信号の動作の特性評価をするための効率的なツールです。画面上にマスク・セグメントを描くことで、カスタム・マスクをすばやく作成できます。特定の要件に合わせてテストを調整し、マスク・ヒットが検出されたとき、またはテスト結果がパスまたはフェイルになったときに取るべきアクションを設定します。

リミット・テストは、信号の長期的な挙動を監視するために有効な手法であり、生産ラインのテストで新しい設計を特性評価したり、ハードウェアの性能を検証するのに役立

ちます。リミット・テストは、ユーザが設定する垂直方向、水平方向のマージンを持った基準波形と測定信号を比較します。

マスク・テストやリミット・テストは、以下のように特定の要件に合わせて簡単にカスタマイズできます。

- 波形の数でテスト期間を定義
- 違反判定のためのスレッシュド値を設定
- 違反/不合格の数をカウントし、統計情報レポートを作成
- 違反時、テスト不合格時、およびテスト完了時のアクションを設定

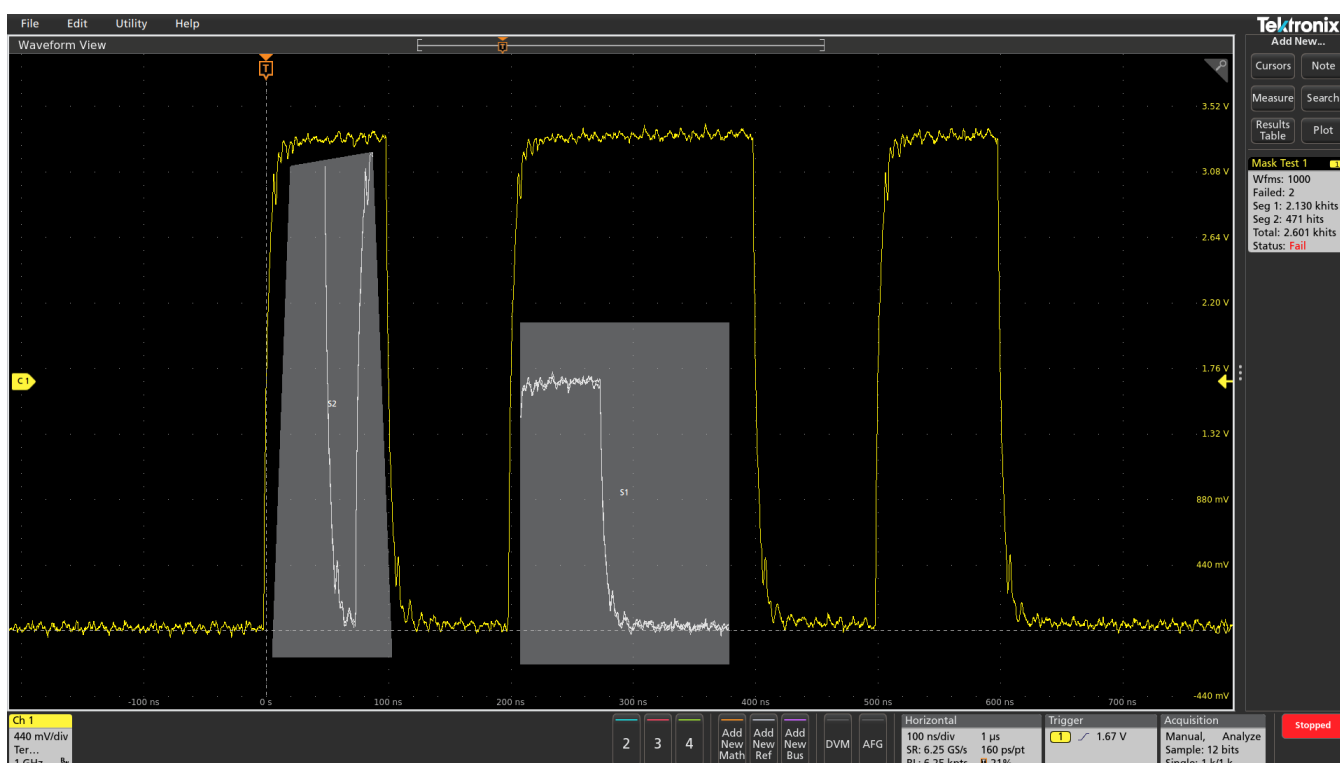

複数のカスタム・セグメント・マスクにより波形に存在する信号グリッチやラント・パルスを捕捉

## ユーザ定義フィルタリング(オプション)

広い意味では、信号を処理するシステムはすべてフィルタと考えることができます。たとえば、オシロスコープのチャンネルは、3 dB ダウンのポイントがその帯域幅と呼ばれるローパス・フィルタとして動作します。任意の形状の波形の場合、いくつかの基本規則、前提条件、および制限の中で、定義された形状に変換できるフィルタを設計できます。

デジタル・フィルタには、アナログ・フィルタに勝るいくつかの大きな利点があります。たとえば、アナログ・フィルタ回路コンポーネントの許容値は高すぎるため、高次フィルタの実装が困難であり、不可能な場合すらあります。

高次フィルタは、デジタル・フィルタとして簡単に実装できます。デジタル・フィルタは、無限インパルス応答 (IIR) または有限インパルス応答 (FIR) として実装できます。IIR または FIR フィルタの選択は、設計要件や用途に基づきます。

5 シリーズ MSO は、MATH 任意関数により、指定されたフィルタを演算波形に適用することができます。Opt. 5-UDFLT は、この機能を深いレベルに掘り下げ、MATH 任意基本関数以上のものを提供します。また、標準フィルタに対応し、用途中心のフィルタ設計に利用することができます。



フィルタは、[MATH (演算)] ダイアログから作成できます。フィルタを編集すると、後で使用または変更するために簡単に適用、保存、および呼び出しができるようになります。


5 シリーズ MSO でサポートされているフィルタ・タイプは次のとおりです。

- ローパス
- ハイ・パス
- バンド・パス
- バンド・ストップ
- オール・パス
- ヒルベルト
- 微分器
- カスタム

5 シリーズ MSO でサポートされているフィルター応答タイプには以下があります。

- バターワース
- チェビシェフ I
- チェビシェフ II
- 楕円
- ガウシアン
- ベッセル-トムソン

フィルタ応答制御は、オール・パス、ヒルベルト、または微分器を除くすべてのフィルタ・タイプで使用できます。

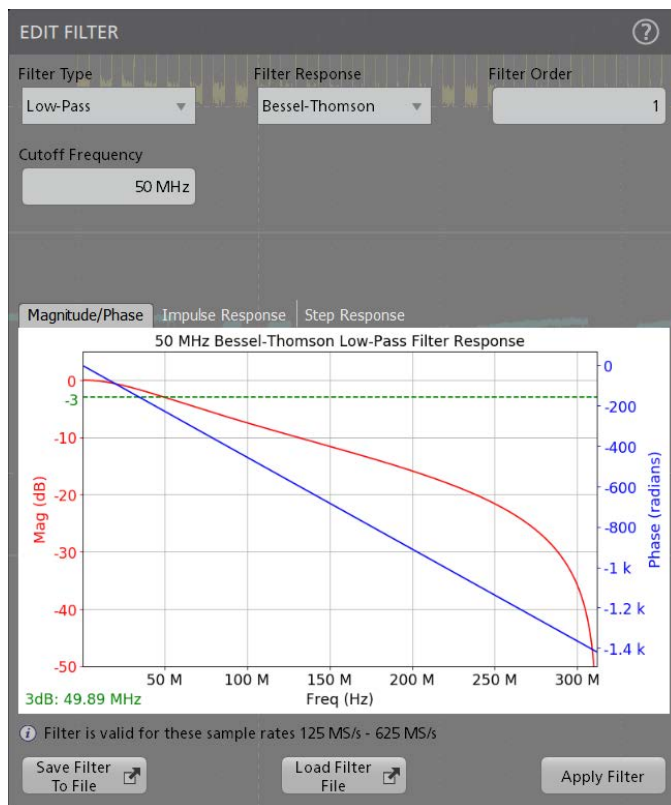


フィルタ・タイプ、フィルタ応答、カットオフ周波数、フィルタ次数、および振幅位相のグラフ表示、インパルス応答、ステップ応答の選択を表示するフィルタ作成ダイアログ

フィルタ設計は、編集が完了すると保存、呼び出し、適用が可能になります。

## プロトコルのデコード／解析(オプション)

デバッグでは、1つまたは複数のシリアル・バスを観察することによって、システムのアクティビティの流れを追跡できると大変有効です。たった1つのシリアル・パケットであっても、手動でデコードしようとする、かなり手間がかかります。長いメモリ長の場合だと、パケット数は数千にも達します。

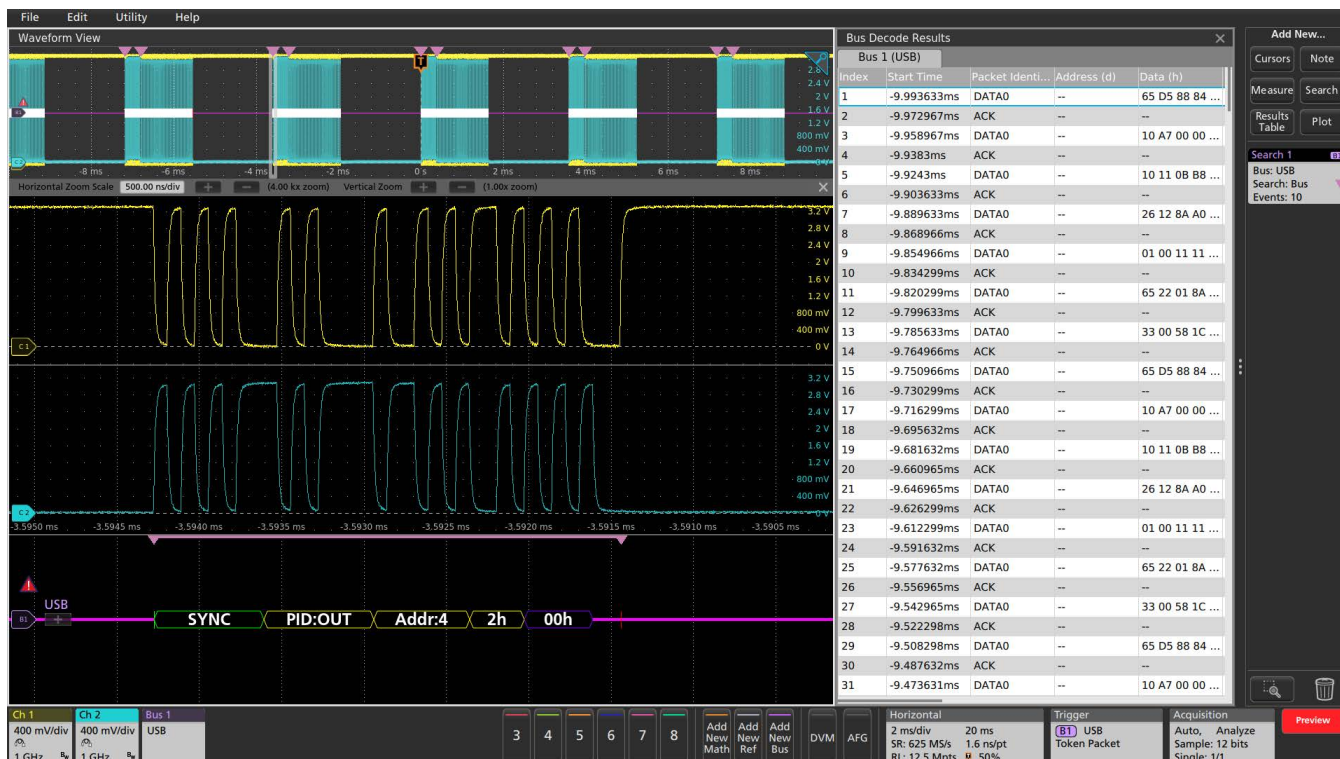

フルスピードUSBシリアル・バスにトリガした例。バス波形は、スタート、シンク、PID、アドレス、エンド・ポイント、CRC、データの値、ストップなど、時間相関のとれた、デコードされたパケットの内容を表示。バス・デコード・テーブルでは、アキュイジション全体のすべてのパケット内容を表示

5 シリーズ MSO は、 $I^2C$ 、SPI、eSPI、I3C、RS-232/422/485/UART、SPMI、SMBus、CAN、CAN FD、CAN XL、LIN、FlexRay、SENT、PSI5、CXPI、Automotive Ethernet、MIPI C-PHY、MIPI D-PHY、USB 1.0 (1.5 Mbps)、USB 1.1 (12 Mbps)、USB 2.0 (480 Mbps)、eUSB2.0、Ethernet 10/100、EtherCAT、Audio (I2S/LJ/RJ/TDM)、MIL-STD-1553、ARINC 429、Spacewire、8B/10B、NRZ、Manchester、SVID、SDLC、1-Wire、MDIO、NFC など、組み込み設計によく使用される、ほとんどのシリアル・バスに対応できます。

プロトコル・サーチを使用すると、長いメモリ長でも効率的にシリアル・パケットを検索できるため、指定した特定のパケット内容を確実に検出できます。検出されたイベントには検索マークが付きます。前面パネルまたは結果バーに表示されるサーチ・バッジの戻る(←)ボタンや次へ(→)ボタンを押すだけで、マーク間をすばやく移動することができます。

ツールはシリアル・バスのために用意されたものですが、パラレル・バスでも機能します。本機では、パラレル・バ

取り込もうと試みているイベントが明確であり、シリアル・バスに特定のコマンドが送出されたときにそのイベントが発生するというのであれば、そのイベントでトリガできれば、効率よく解析できるはずです。残念ながら、エッジまたはパルス幅トリガを指定するだけで、こうしたトリガが可能になるわけではありません。

スも標準でサポートされています。パラレル・バスは、最大 64 ビット幅で、アナログ・チャンネルとデジタル・チャンネルを混在させることができます。

- シリアル・プロトコル・トリガを使用することで、パケットの開始、特定のアドレス、特定のデータ内容、固有の識別子、エラーなど、特定のパケット内容でトリガできます。
- バス波形により、バスを構成する個々の信号 (Clock、Data、Chip Enable など) に沿ってわかりやすく表示でき、パケットの開始と終了、アドレス、データ、識別子、CRC などのサブパケット・コンポーネントを簡単に識別できる
- バス波形は、表示された他の信号と時間相関が取れているため、被測定システムの異なる部分のタイミング関係も簡単に測定できます。
- バス・デコード・テーブルには、アキュイジションのすべてのデコードされたパケットが (一般的なソフトウェアのリスト表示と同様の) 表形式で表示されます。パケッ

トにはタイムスタンプが付き、コンポーネント（アドレス、データなど）ごとにカラムとして連続にリスト表示されます。

## NFC デコード／解析(オプション)


多くの場合において、プロトコル・レベルの結果をパラメータの信号レベルまでトレースできないことから、NFC デザインの性能マージンを評価することは困難です。これはつまり、特に設計がトレードオフや周辺の電子機器によって干渉やシグナル・インテグリティの問題を受けやすくなっており、プロトコル・アナライザや RF シグナル・アナライザなどの複数の機器で時間のかかるデバッグを必要とする場合に、マージナル・パスがテスト・フローの後半で失敗する可能性があるということです。

5 シリーズ MSONFC プロトコル・デコード／検索オプションを使用することで、NFC リンクのトランザクションを表示し、プロトコル・レベルから基本的な信号レベルまで、標準での信号操作のすべてのステップで結果をトレースできるようになり、NFC チップ、タグ、リーダ、またはモバイル・デバイスがどのように動作しているかを正確に把握するためのインサイトが得られます。

NFC トランザクションは長くなることがあります。このソフトウェア・オプションは、他とは異なり、Spectrum View に使用されるハードウェア DDC からのデータを利用します。これにより、サンプル・レート圧縮が可能になり、転送時間とメモリが節約され、100 ミリ秒、または数秒の信号データをもキャプチャして分析できます。

さらに、I/O 信号は、テスト対象デバイスからのプローブとトリガに常に使用できるわけではないため、NFC の小さな変調指数を考慮すると、RF エンベロープ自体でトリガすることも難題となります。Spectrum View では、RF 対時間の波形とトリガを使用して 13.56 MHz エンベロープでトリガできます。これも他の機器にはない独自のものです。

この機能により設計の初期検証が簡素化されます。また、障害が発生した場合の強力なデバッグ・ツールも、単一の機器で提供されます。

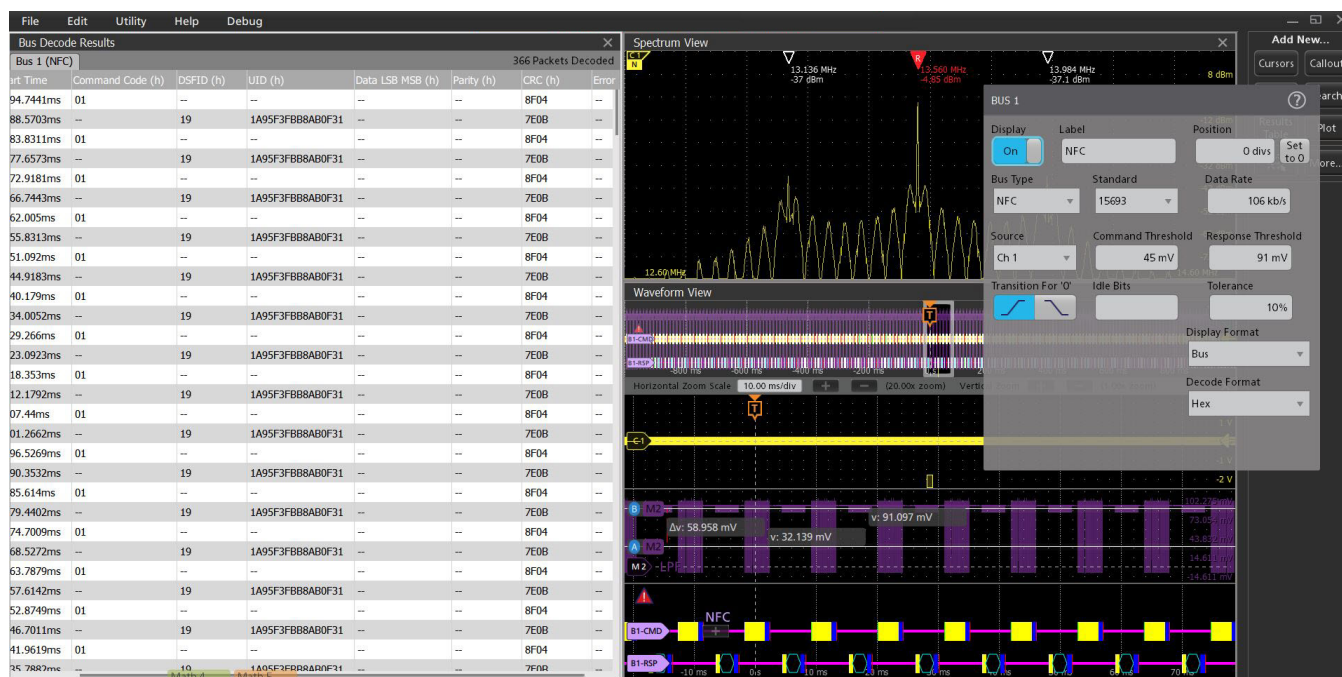

NFC ソフトウェア・オプションを使用すると、デジタル NFC ビット・ストリームをデコードおよび検索して、NFC アナログ/RF およびデジタルの事前適合、デバッグ、トラブルシューティングを 1 つの機器で実行できます。


## コンプライアンス・アプリケーション(オプション)

組込み機器の設計者が最も重視するのが、さまざまな組込み／インタフェース技術についてのコンプライアンス・テストです。これを確実に実施することで、デバイスはプラグフェストでロゴ認証を取得し、他の対応機器との互換性を保証できるようになります。

USB、Ethernet、メモリ、ディスプレイ、MIPI などの高速シリアル規格のための仕様は、それぞれの規格のコンソーシアムや運営団体によって策定されます。こうしたコンソーシアムとも緊密に連携しながら、テクトロニクスはオシロスコープベースのコンプライアンス・アプリケーションを開発してきました。単にパス／フェイルの結果を示すだけでなく、不合格になった設計を効率的にデバッグできるように、ジッタ／タイミング解析といった関連する測定ツールを提供するなど、原因を詳細に解析するための機能を備えています。

これらの自動コンプライアンス・アプリケーションをフレームワークに組み込むことでさまざまなメリットが生まれます。

- 認証試験項目を完全にカバーした包括的なテストの実施
- カスタマイズ可能な設定に基づき最適化されたアキュジションとテスト・シーケンスによるテスト時間の短縮
- 取込み済みの信号に基づいて解析できるため、必要な取込みが完了すれば、被測定デバイス (DUT) をセットアップから取り外すことも可能。異なるオシロスコープや別の場所に取り込まれた波形も解析できるため、高度なコラボレーションを生かしたテスト環境の構築が可能
- アキュジション中に取り込まれた信号を確認できる信号検証オプション
- 設計のデバッグに最適なパラメトリック測定機能の追加
- カスタム・アイ・ダイアグラム／マスク・テストによる設計マージンの解析
- セットアップ情報、結果、マージン、波形のスクリーンショット、プロット画像などを記載した複数フォーマットに対応した詳細なレポートの生成

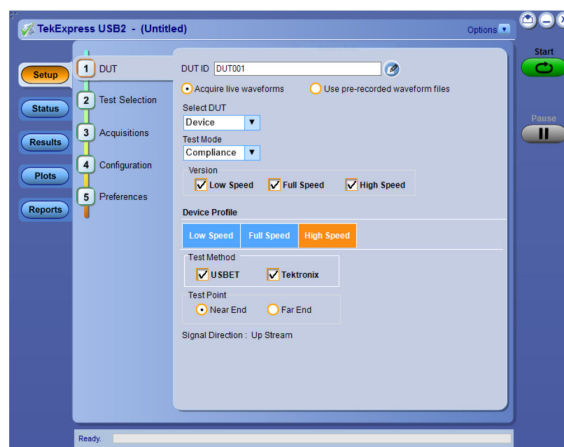

TekExpress USB 2.0 自動コンプライアンス・テストの設定メニュー

## Spectrum View

多くの場合、周波数領域で1つまたは複数の信号を表示することで、問題のデバッグが容易になります。こうしたニーズに対応するために、従来からオシロスコープには演算ベースのFFT機能が内蔵されていました。しかし、FFTの使用には以下の2つの点で難点があることが知られていました。

第一に、周波数ドメイン解析を行う場合、スペクトラム・アナライザに通常搭載されている中心周波数、スパン、分解能帯域幅 (RBW) といった項目が当然設定できると考えるはずですが、ところがFFTを使用すると、サンプル・レート、レコード長、時間軸といった従来からのオシロスコープの設定を使用しなければなりません。周波数ドメインに目的の信号を表示するには、ある程度の経験と技術が必要です。

次に、FFTはアナログの時間ドメイン表示と同じアキュイジション・システムによって駆動されていることが挙げられます。アナログ表示に合わせて取込み設定を最適化すると、目的の周波数ドメイン表示が得られません。期待通りの周波数領域表示が得られると、今度はアナログ表示に問題が生じます。演算ベースのFFTでは、両方の領域の表示を最適化することは事実上不可能です。


Spectrum Viewはこうした問題をすべて解決します。当社独自の特許技術により、それぞれのFlexChannelにデシメータ (時間領域) とデジタル・ダウンコンバータ (DDC) を配しています。2つの異なる取込み経路を使用することで、入

力信号を時間領域表示と周波数領域表示の両方で同時に観測できます。それぞれの領域は、独立した取込み設定が可能です。それぞれのドメインには独立した取込み設定を使用できます。他社製品ではさまざまな種類の「スペクトラム解析」パッケージが提供されており使いやすさを謳っていますが、そうした製品にはすべて前述した通りの制限が見られます。本当に使いやすく、両方の領域で同時に最適な表示が得られる優れた機能を備えているのは、当社のSpectrum Viewだけです。


従来、RFチャンネル・パワー (CHP)、隣接チャンネル・パワー比 (ACPR)、占有帯域幅 (OBW) などのRF測定を実行するには、専用のスペクトラム・アナライザ、信号アナライザ、またはスペクトラム・アナライザ・ソフトウェアが必要でした。このようにハードウェアやソフトウェアを追加することで、複雑さが増し、コストが高くなります。Spectrum Viewを標準装備し、各チャンネルにRF測定機能を統合したことで、RFトランスミッタのCHP、ACPR、OBWをオシロスコープで直接検証できるようになったため、時間、作業スペース、コストを節約できます。

さらに、DDCは中心周波数ではなくスパンの関数になるため、従来のFFTと比較して信号を解像するために必要なサンプル・レートを大幅に削減できます。これにより、ファイルサイズの縮小、周波数分解能の向上、スペクトラムの更新レート的高速化が可能になり、10数秒間のスペクトラム・データをキャプチャできる、応答性と正確性の高いソリューションが実現します。



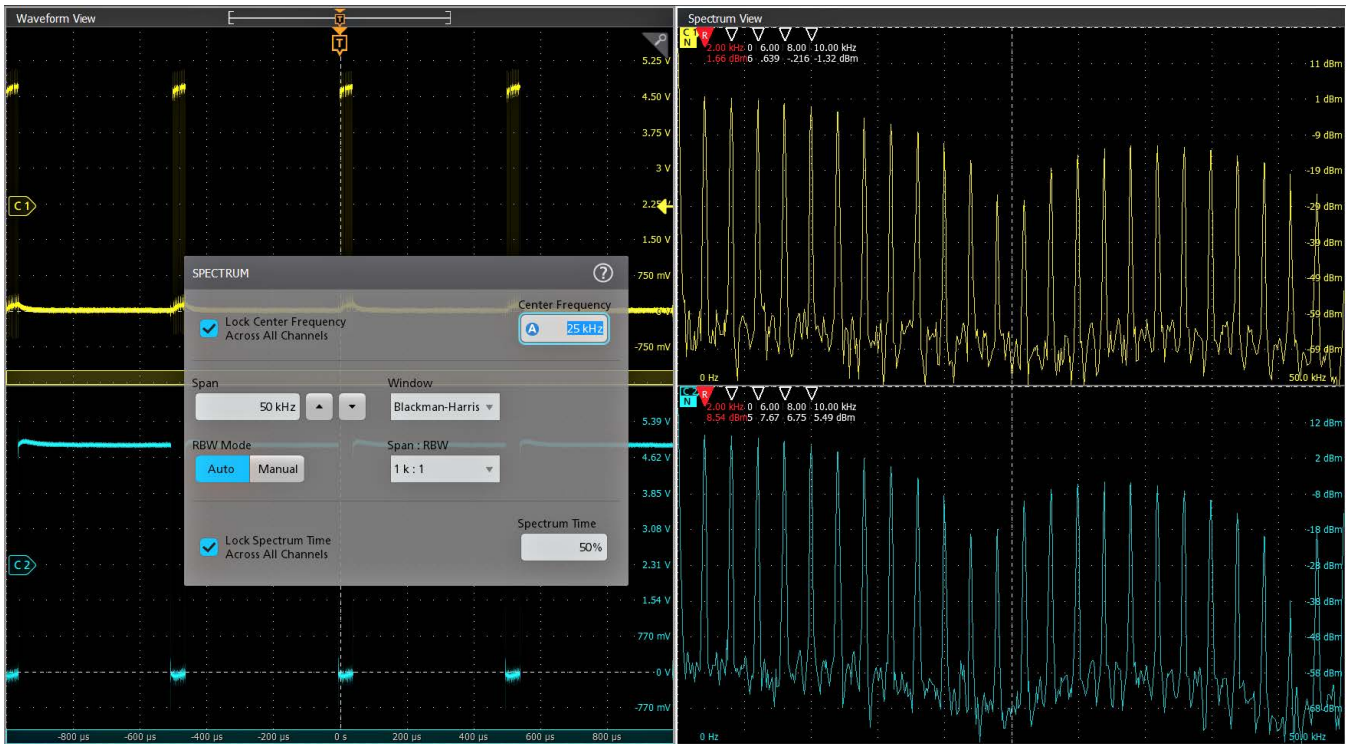

中心周波数、スパン、分解能帯域幅 (RBW) などを制御できる直感的なスペクトラム・アナライザ設定。時間領域の設定から独立しており、周波数領域解析を簡単にセットアップできる。スペクトラム表示はそれぞれの FlexChannel アナログ入力で利用できるため、複数チャンネルのミックスド・ドメイン解析が可能

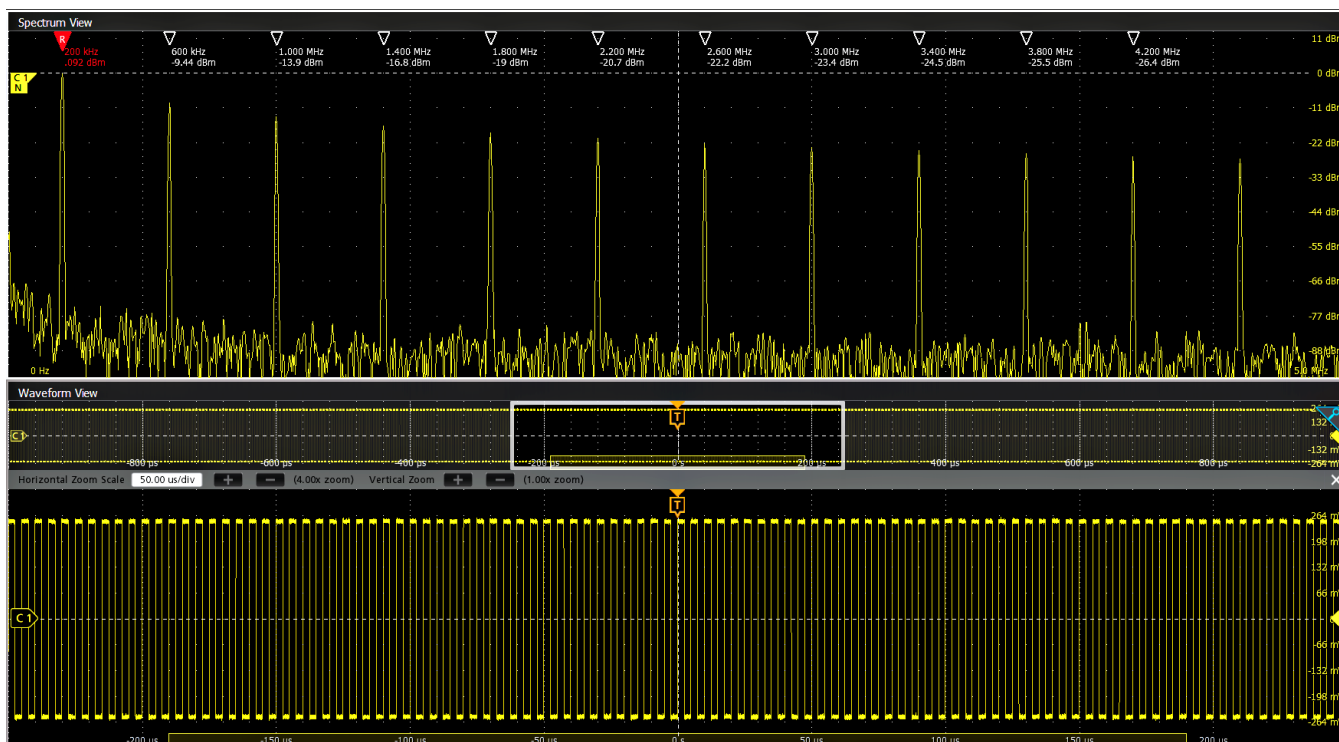

Spectrum Time で設定されたゲート区間（時間範囲）でFFTが計算される。時間ドメイン表示に小さな長方形の領域が表示されており、これを配置することで、時間ドメイン波形との時間相関をとることができるため、ミックスド・ドメイン解析に最適である。最大11個のピーク・マーカを使用して、それぞれのピークの周波数と振幅の値を観測できる。基準マーカは常に最も高いピークを示し、赤で表示されている

## RF 信号変化の観測(オプション)

RF 時間ドメイン波形は、時間とともに変化する RF 信号の理解に役立ちます。Spectrum View の基盤である I/Q データから得られた、以下の3つの RF 時間領域波形があります。

- 振幅 - スペクトルの瞬時振幅対時間
- 周波数 - 中心周波数に対するスペクトラムの瞬時周波数対時間
- 位相 - 中心周波数に対するスペクトラムの瞬時位相対時間

これらの波形は個別にオン/オフすることも、3つ同時に表示することもできます。

データは同相および直交 (I&Q) サンプルとして保存され、時間領域データと I&Q データの間で正確な同期が維持されます。



RF 対時間の波形が有効な場合、I/Q データがファイルに取り込まれて、エクスポートされ、サードパーティ製アプリケーション内でさらに拡張解析が実施されます。

X 軸が周波数、Y 軸が時間、色の変化が電力レベルを示すスペクトログラム表示（オプション RFVT に付属）により、時間の経過に伴う信号振幅と周波数成分の変化をより詳細

に把握し、スペクトラム活動の変化がいつどこで発生するかを確認できます。これは、複雑なスプリアス信号や周波数ホッピング信号、マルチチャンネル信号、動的に変化する信号などのスペクトラム・データの傾向を表示するのに最適です。

スペクトログラムの利点は次のとおりです。

- FFT オーバーラップやスペクトラム時間を指定することなく、所定のスパンおよびアキュイジションにおけるすべてのスペクトラム活動を即座に表示
- 時間相関カーソルと最大3つのオーバーレイされたスペクトラム・レースを使用して、時間内のさまざまな瞬間のスペクトラムをすばやく比較
- ディスプレイ解像度と FFT オーバーラップが自動的に最適化され、関心のあるスペクトラム活動をピンチしてズームイン
- 必要に応じて、中心周波数、スパン、RBW、振幅のカラースケールを調整して、目的の信号をすべて表示
- 使用可能な各オシロスコープのチャンネルでスペクトログラムをアクティブにし、中心周波数と振幅スケールを個別に設定することで、マルチチャンネルや非連続スペクトラムのトレンドを同時に表示

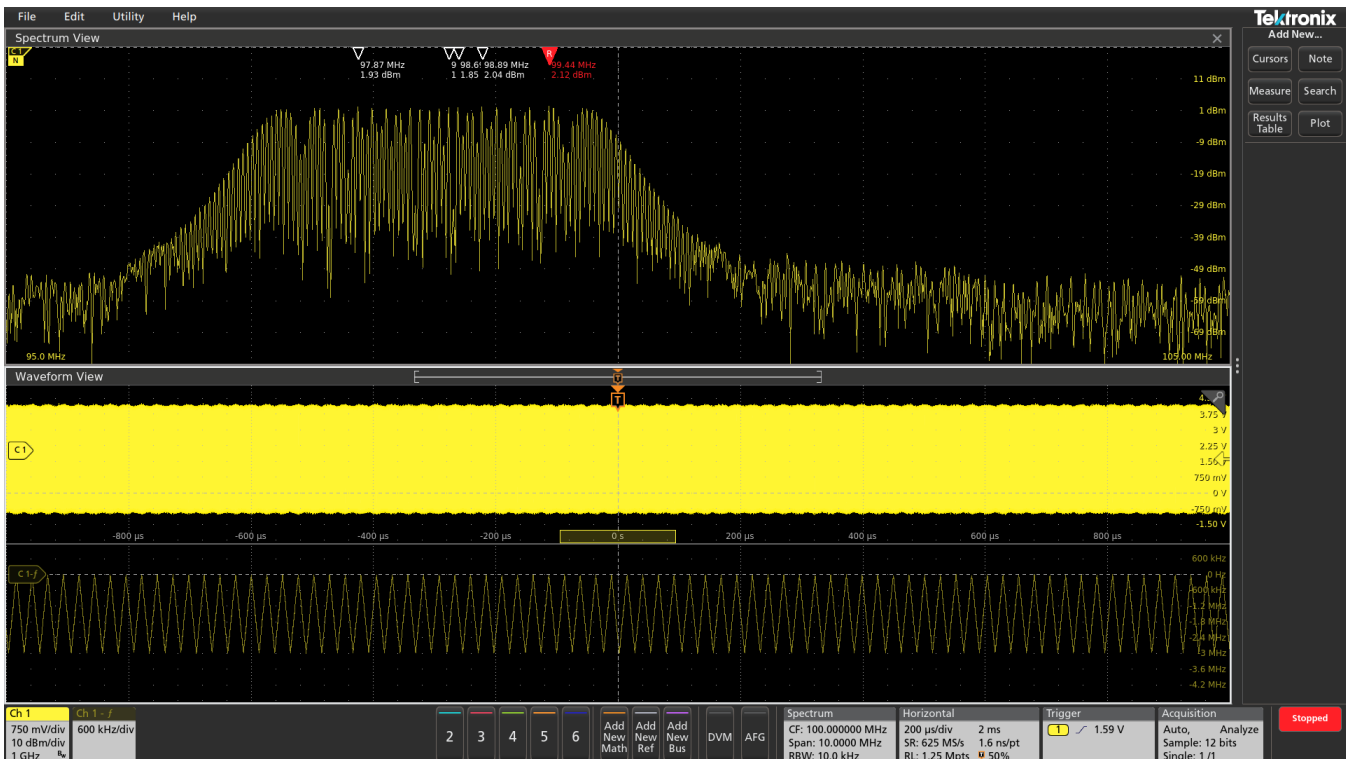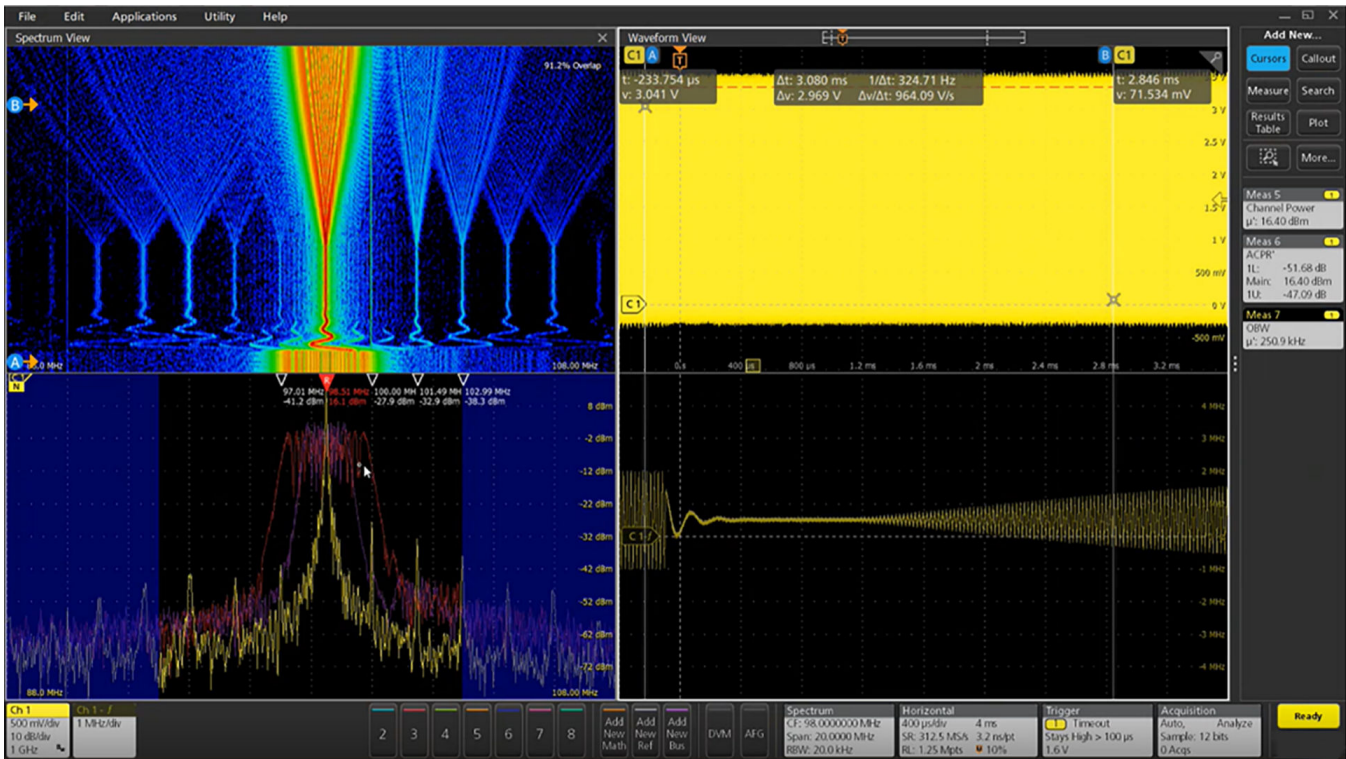

下の波形は、入力信号から導かれた周波数対時間の波形を示している。スペクトラム・タイムは、最低周波数から中間周波数へのトランジットにあたるため、エネルギーはいくつかの周波数に拡散されている。周波数対時間波形から、さまざまな周波数へのホッピングが容易にわかり、デバイスが周波数を変更するときの特性評価が簡素化できる

## RF 信号の変化でトリガ(オプション)

電磁干渉の発生源を見つける必要がある場合や、VCO の動作を理解する必要がある場合に、RF 対時間のハードウェア・トリガを使用することで、RF 信号の挙動を簡単に分離、捕捉し、検査できます。RF 振幅対時間や RF 周波数対時間のエッジ、パルス幅、およびタイムアウトでもトリガできます

## SignalVu-PC(オプション)による包括的なベクトル信号解析

基本的なスペクトラム、振幅、周波数、位相対時間だけでなく、より高度な解析が必要な場合は、SignalVu-PC ベクトル信号解析アプリケーションを利用できます。これにより、詳細なトランジェント RF 信号解析や RF パルス特性解析、包括的なアナログ/デジタル RF 変調解析が可能になります。

5 シリーズ・オシロスコープで SignalVu-PC を動作させるには、以下の 3 項目が必要です。

1. 機器でアプリケーションを実行する場合、Windows SSD (5-WIN) をオシロスコープにインストールする必要があります。
2. I/Q データを転送するには、Spectrum View RF 対時間トレース (Opt. 5-SV-RFVT) をオシロスコープにインストールする必要があります。
3. アプリケーションの基本機能 (16 種類以上の RF 測定/表示機能を含む) を有効にするには、Connect (Opt. CONxx-SVPC) ライセンスを SignalVu-PC にインストールする必要があります。

各チャンネルに装備された RF デジタル・ダウンコンバータと統合された測定エンジンは、複雑なミックスド・シグナル/ミックスド・ドメイン解析のニーズを 1 つの装置でカバーしています。




SignalVu-PC によるパルス解析 (5 シリーズ MSO)

## 拡張パルス解析機能(オプション)

5 シリーズ MSO で利用可能なチャンネルごとの DDC により、個別タイミング、トリガリングおよび計測の設定を含む、すべてのチャンネルの RF 信号の個別分析が可能になります。この機能を拡張すれば、SignalVu-PC VSA ソフトウェアを使用するときに、時間、周波数、変調領域を同時に評価できます。

拡張パルス解析オプション (SVPNL-SVPC) により、独立の、または協調的な制御および測定を使用して、共通のタイムベースで測定チャンネル全体の複数のレーダ信号を分析できるようになります。

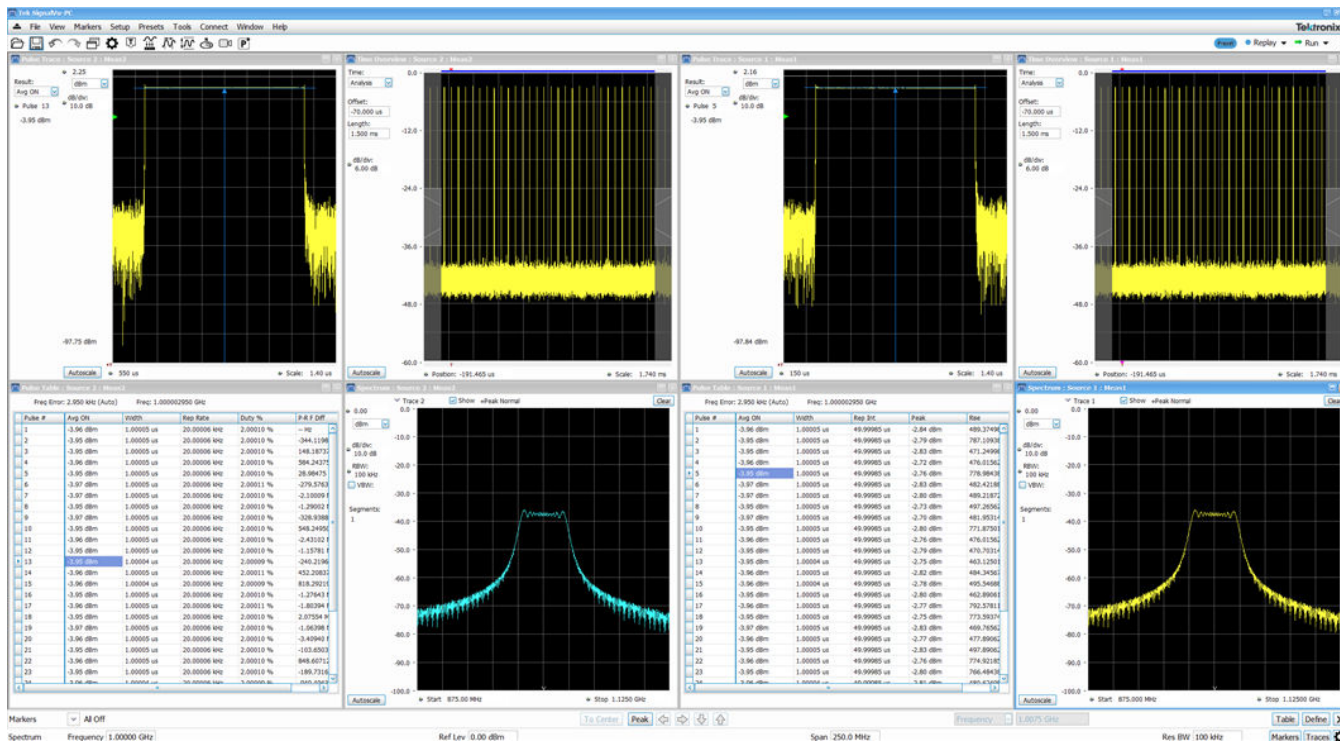

SignalVu-PC の拡張パルス解析アプリケーションでは、最大31 のパルス・パラメータを自動で測定、統計処理、表示して最大8 つの信号ソースを同時に解析できるため、ワークフローの合理化と効率性の向上が実現します。


## ジッタ解析

5 シリーズ MSO には、標準で DPOJET Essentials ジッタ／タイミング解析ソフトウェアが内蔵されており、連続クロックとデータ・サイクルをシングルショットのリアルタイム取込みで測定できるようにオシロスコープの能力を拡張しています。これにより、タイム・インターバル・エラーや位相ノイズなどの重要なジッタ／タイミング解析パラメータが測定でき、システム・タイミング問題を検証することができます。

時間トレンドやヒストグラム・プロットなどの解析ツールで時間とともに変化するタイミング・パラメータのすばや

い表示、あるいはスペクトラム解析でジッタや変調ソースの周波数や振幅の正確な表示が可能になります。

Opt. 5-DJA を使用すると、ジッタ解析機能を追加して、より高度なデバイス性能の特性評価が可能になります。31 種類の測定機能により、広範囲なジッタ／アイ・ダイアグラム解析と分離アルゴリズムが追加され、今日の高速シリアル、デジタル／通信システム設計におけるシグナル・インテグリティ問題の検出が可能になります。Opt. 5-DJA を使用することで、アイ・ダイアグラム・マスク・テストによる自動パス／フェイル・テストも行えます。

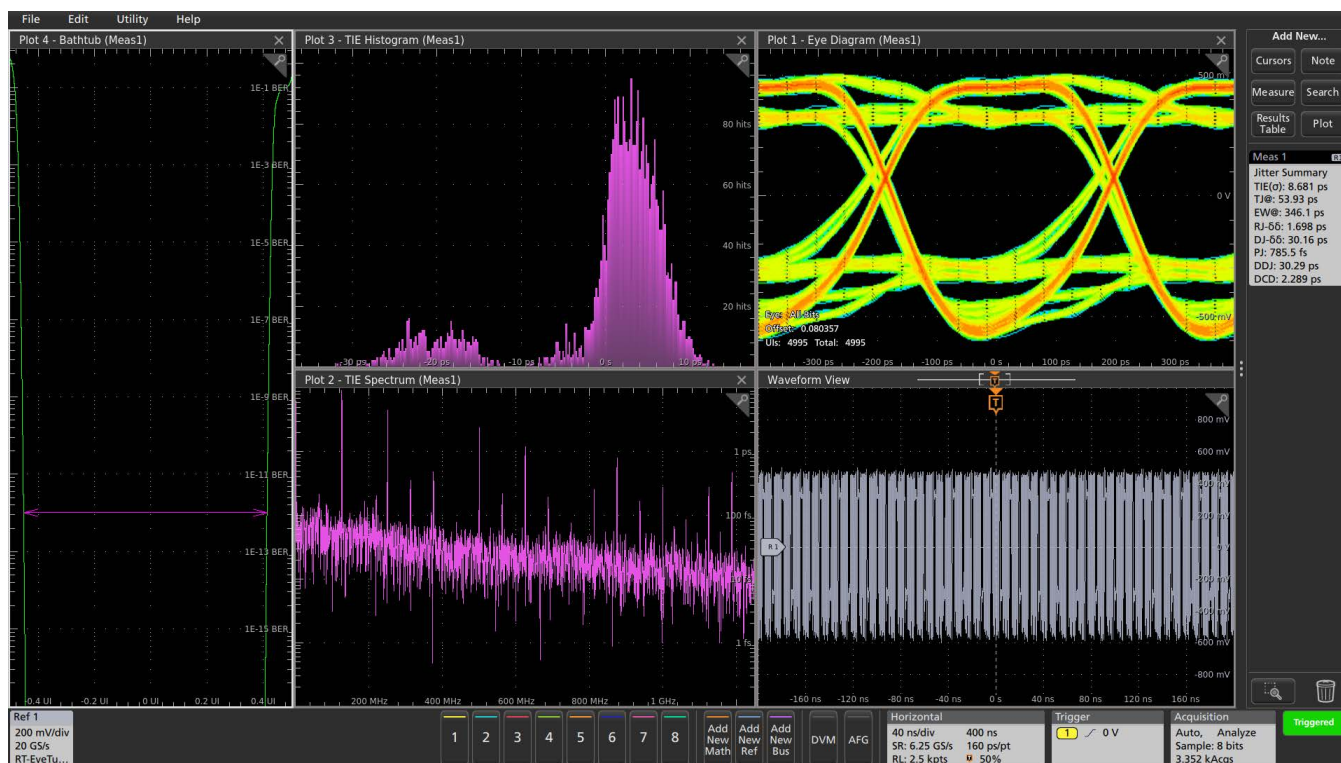


独自のジッタ・サマリ表示により、デバイスの性能をわずか数秒で総合的に把握できる。

## パワー解析(オプション)

5 シリーズ MSO は、オプションでパワー解析パッケージが統合でき、電力品質、入力容量、突入電流、高調波、スイッチング・ロス、安全動作領域 (SOA)、変調、リップル、磁気測定、効率、変調、タイミング、(dv/dt および di/dt)、

制御ループ応答 (ボード線図)、電源電圧変動除去比 (PSRR) などを優れた再現性で効率的に測定できます。

自動測定機能では、ボタンにタッチするだけで測定品質や再現性を最適化できるため、外部 PC やソフトウェアの複雑なセットアップも一切不要です。

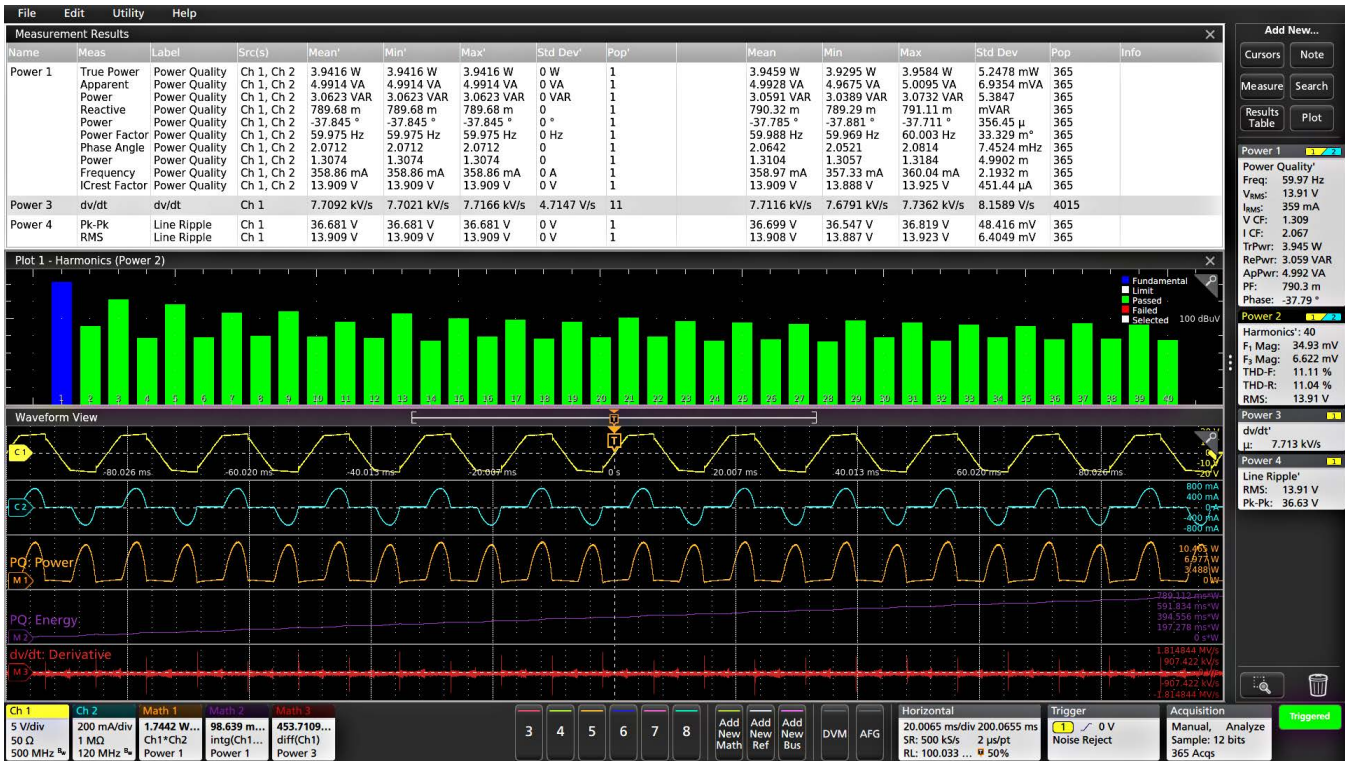


パワー解析測定ではさまざまな波形やプロットを表示できる

## デジタル電源管理(オプション)

デジタル電源管理／解析 (DPM) ソフトウェア・オプションは、5 シリーズ MSO オシロスコープでのパワー・インテグリティ解析に、パワーレールの自動測定機能を提供します。このソリューションにより、パワー・レール・プローブを使用した複数のパワー・レールの同時解析と、受動プローブを使用した測定のシーケンシングの両方が可能になります。このソリューションは、ユーザのワーク・フローを考慮し、設計エンジニアの時間的なニーズに対応できるように設計されています。また、測定値、試験結果、プロット画像を含む自動レポートを生成できます。


主な測定値には、リップル、リップル・オン・リップル、パワー・シーケンシング、ジッタ解析、トランジェント解析、パワー・インテグリティ、シグナル・インテグリティ解析などがあります。

電源誘発ジッタ (PSIJ) 測定により、シグナル・インテグリティに関わるエンジニアがハードウェア変更の影響をモデル化し、実際に変更を行う前にその有効性をテストすることができます。これは、インサイトと確信をもたらすツールとして機能します。この測定では、フィルタリングの前後で、アイ高さ、アイ幅、PJ、TIE などの重要な結果が得られます。

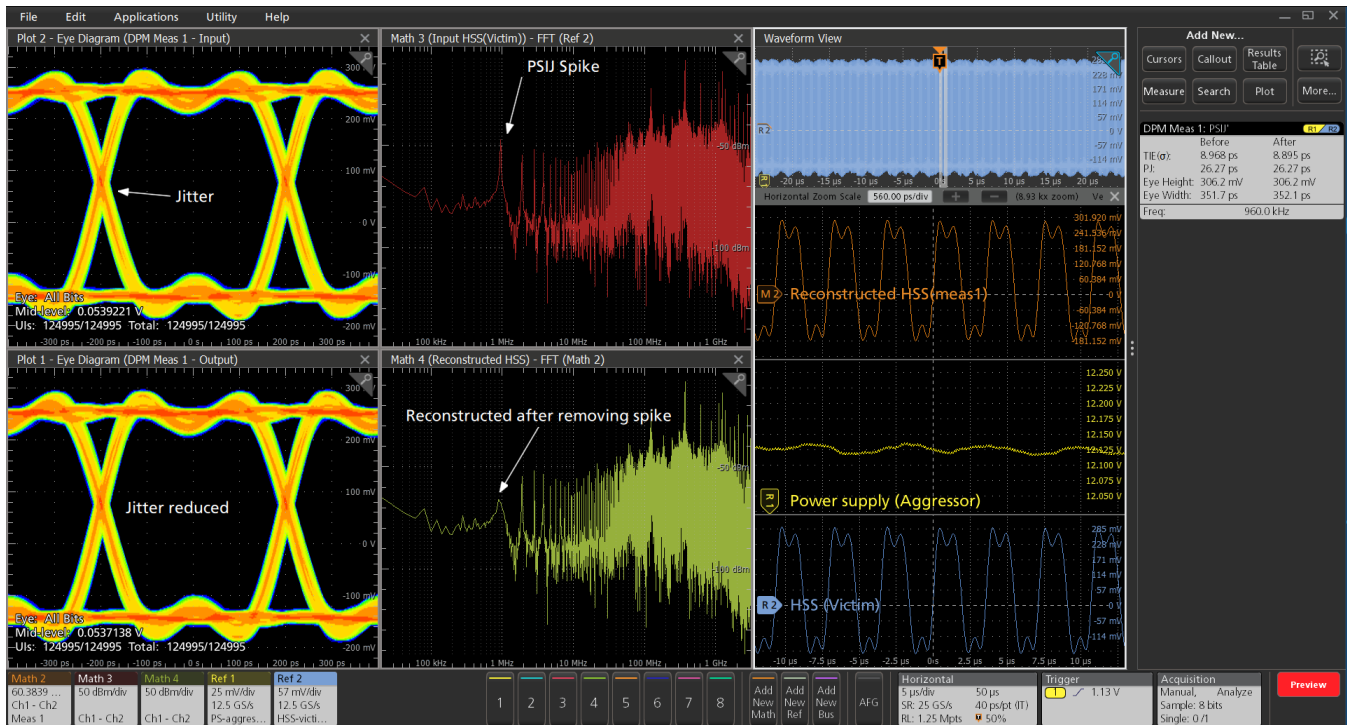



## インバータ／モータ・ドライブ解析(オプション)

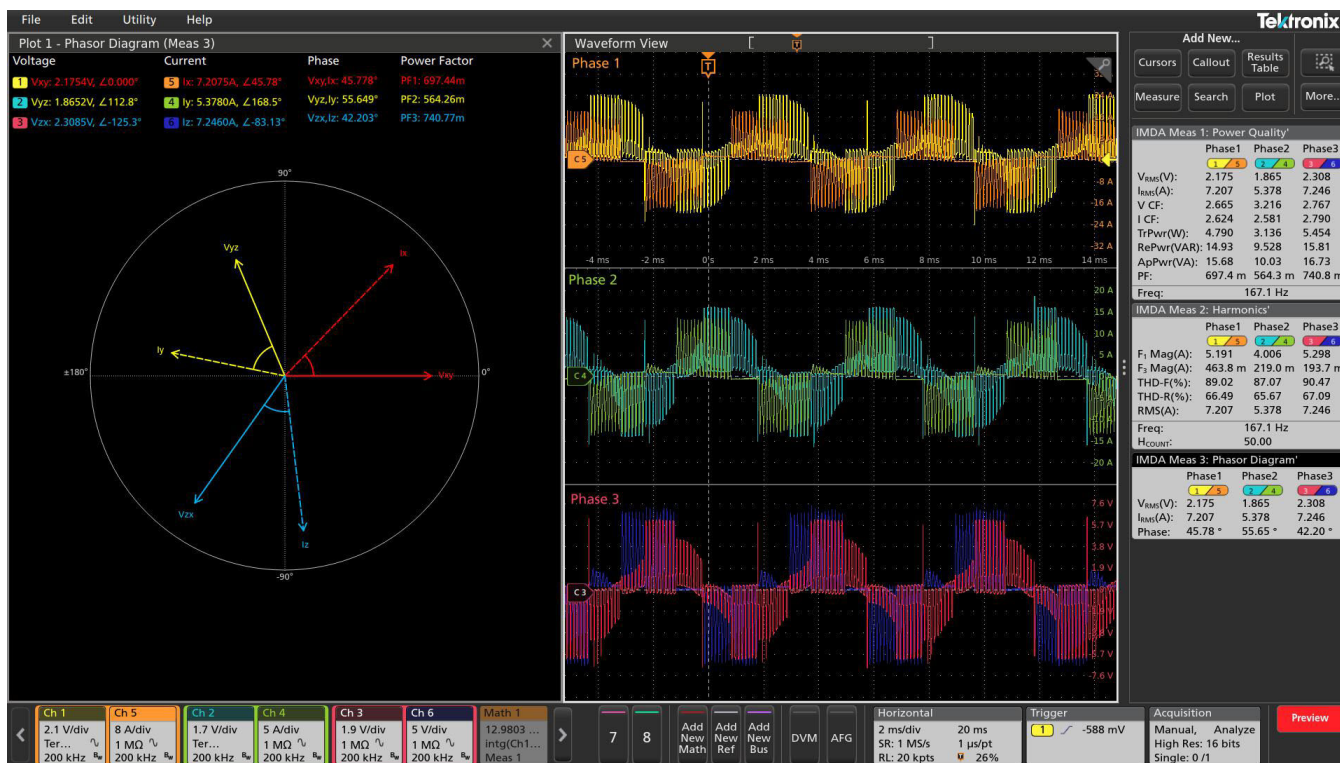

左側には、電力の三相すべての電流／電圧の測定値の位相および振幅を示した位相図がある。右側の結果バッジは、電力品質、電源高調波、位相図の自動測定の結果を示している

三相電力を利用するシステムの設計や検証では、制御システムとパワー・エレクトロニクスをシステム全体の性能と関連させることが困難な場合があります。IMDAは、5シリーズMSO (MSO56型およびMSO58型)の6チャンネルおよび8チャンネルの機種で、デジタル制御やパワー・エレクトロニクスのサブシステムを解析するのに使用できます。

この機能を使用すると、より詳細な解析が可能になるため、以下のようなシステムの設計／効率／信頼性を効果的に検証できます。

- 三相電カインバータ、コンバータ、電源装置、およびDC-ACトポロジの車載用三相設計
- モータ（ブラシレスAC、ブラシレスDC、誘導、永久磁石、ユニバーサル、ステッパ、ロータ）
- ドライブ（AC、DC、可変周波数、サーボ）

5-IMDAには、以下の自動測定機能が含まれます。

- 入力解析
  - 位相図による電力品質
  - 高調波
  - 入力電圧
  - 入力電流
  - 入力電力

- リップル解析
  - ライン・リップル
  - スイッチング・リップル
- 出力解析
  - 位相図
  - 効率
  - 機械電力
  - システム効率
- 結線の構成
  - 電圧1／電流1-1P2W
  - 電圧2／電流2-1P3W
  - 電圧2／電流2-3P3W
  - 電圧3／電流3-3P3W
  - 電圧3／電流3-3P4W

Opt. 5-IMDA-DQ0を使用することで、三相ACの時間領域の波形をDC信号に変換して、位相プロット上に回転座標としてグラフィカルに表示する機能を利用できます。


## ワイド・バンドギャップ・ダブル・パルス・テスト(オプション)

ワイド・バンドギャップ・ダブル・パルス・テスト・アプリケーションにより、デバイスとシステムの検証を容易にする正確なワイド・バンドギャップ測定が可能になります。SiC または GaN デバイスに加え、Si MOSFET および IGBT もテストできます。このアプリケーションは、当社のすべての VPI プローブと互換性があり、当社の IsoVu™ プローブと併用することで、SiC または GaN デバイスの隠れたすべてのアーチファクトを回路レベルで発見するのに役立ちます。このアプリケーションは、JEDEC および IEC 規格に従

って測定を自動化します。注釈付きのサイクルごとの解析、カスタム基準レベル設定での柔軟性、構成可能な統合ポイント、DUT 設計に基づいて設定可能な電源プリセットなど、独自の機能を提供します。

以下の測定が実行されます。

- ロー・サイド・スイッチング・パラメータおよびハイ・サイド・ダイオード逆回復測定
- ロー・サイドおよびハイ・サイド・スイッチングパラメータ

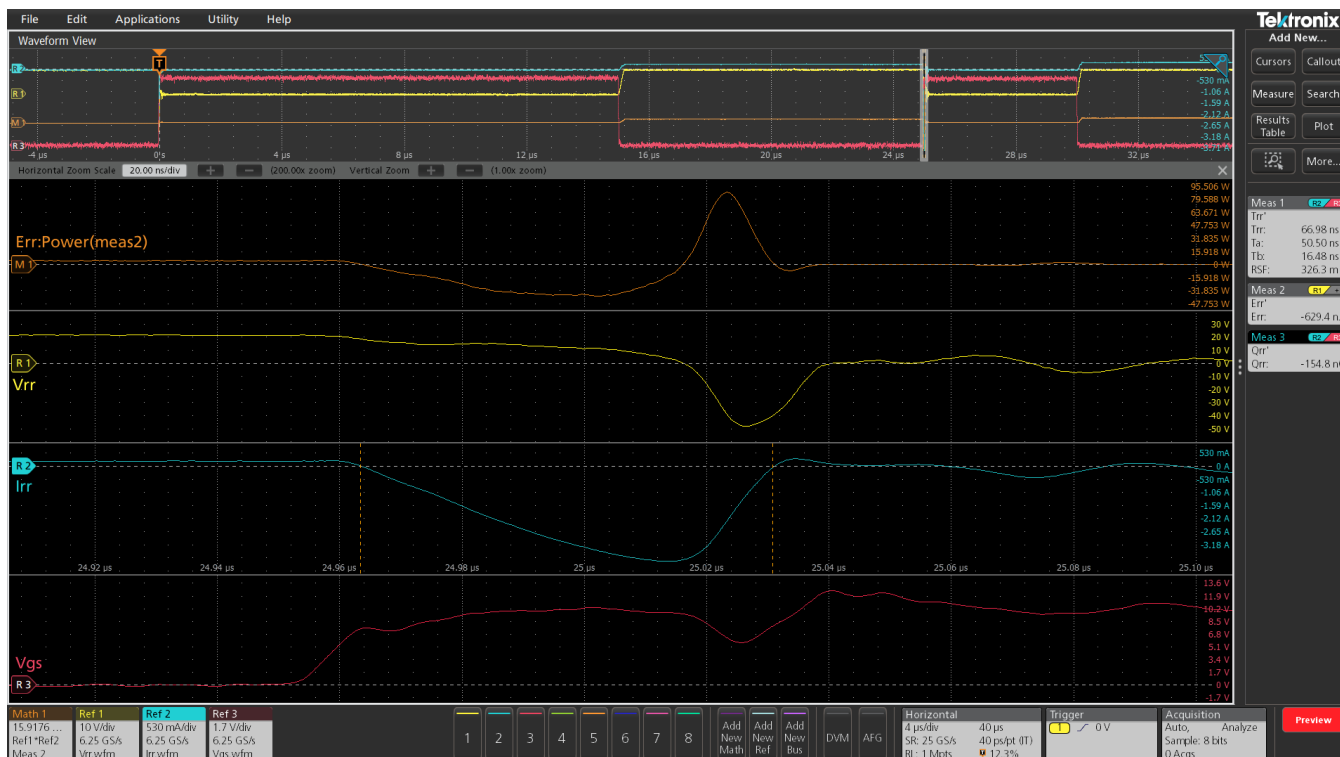

この図は、ハイサイドで逆回復電流と電圧をキャプチャしたダイオード逆回復測定を示しています。

## 豊富な機能であらゆるニーズに対応 接続機能

5 シリーズ MSO は、複数の外部接続ポートを経由して、ネットワーク接続、PC への直接接続、または他のテスト機器に接続することができます。

- 前面パネルには 2 個の USB 2.0 ポートと 1 個の USB 3.0 ホスト・ポートがあり、後部パネルには 4 個の USB ホスト・ポート (2.0x2、3.0x2) があり、スクリーン・ショット、機器の設定、波形データなどを USB 大容量デバイスに簡単に転送できます。USB ホスト・ポートには、USB マウスやキーボードも接続でき、機器のコントローラやデータ入力に利用できます。

- 後部パネルには USB デバイス・ポートが装備されており、PC でオシロスコープをリモート制御することができます。
- 後部パネルには 10/100/1000BASE-T Ethernet ポートがあり、ネットワークに簡単に接続して、制御でき、LXI Core 2011 にも対応します。
- DVI-D、Display Port、および VGA ポートから、画面を外部モニターまたはプロジェクタ。



あらゆる設計環境に対応できる5シリーズMSOの豊富な入出力

## 自動試験装置(ATE)システムを迅速かつスムーズにアップグレード

自動化されたテスト・システムと密接に関わる仕事に従事している方なら、新しいモデルやプラットフォームへの移行に伴う苦労をよくご存じのはずです。新しい製品に対応するために、既存のコードベースを修正するのは、法外なコストがかかる場合があり、移行作業も複雑になります。そんな方に最適なソリューションをお届けします。

すべての5シリーズMSOには、プログラム・インタフェース (PI) トランスレータが搭載されています。有効にすると、PI トランスレータは、テスト・アプリケーションとオシロスコープの間の中間層として機能します。これは、一般的な DPO/MSO5000B シリーズおよび DPO7000C シリーズ・プラットフォームのレガシ・コマンドのサブセットを認識し、即座に5シリーズMSOのサポートされているコマンドに変換します。トランスレータのインタフェースは、きわめて可読性に優れているため、どなたでも簡単に拡張することができます。動作をカスタマイズすることで、新しいオシロスコープに移行する際に必要な労力を最小限に抑えられます。

## リモート操作による共同作業の効率化

離れた場所にいる設計チームと一緒に作業ができます。

内蔵の e\*Scope®機能を使用すると、ネットワーク経由で遠隔 OS で実行するオシロスコープを制御することもできます。標準の Web ブラウザを通じて、どの PC やデバイスからでも表示できます。

オシロスコープの IP アドレスまたはネットワーク名を入力するだけで、ブラウザに Web ページが表示されます。離れた場所からでも、その場にいるのとまったく同じように、内蔵タッチスクリーンを使ってオシロスコープを制御できます。Microsoft Windows 10 オペレーティング・システム対応のオシロスコープのほか、Windows Remote Desktop™ を使って、本機に直接接続し、リモートから制御できます。

業界標準の TekVISA™ プロトコル・インタフェースが含まれており、データ解析やドキュメンテーションなどの Windows アプリケーションの利用や拡張も可能です。IVI-COM 機器ドライバが含まれており、オシロスコープまたは外部 PC 上のプログラムから、LAN または USBTMC 接続を使用して、オシロスコープと容易に通信することができます。



e\*Scope を使用すれば、一般的な Web ブラウザを使用して、手軽にリモート表示と制御が行える

## PC ベースの解析とオシロスコープへのリモート接続

数々の受賞に輝くオシロスコープの解析機能を PC で利用できます。いつでもどこでも波形を解析できます。ベーシック・ライセンスでは、オシロスコープにリモート・アクセスしながら、波形の表示/解析、各種測定、および最も一般的なシリアル・バスのデコードを行うことができます。アドバンスド・ライセンス・オプションでは、マルチスコプ解析、より多くのシリアル・バス・デコード・オプション、および電力測定などの機能が追加されます。



TekScope PC 解析ソフトウェアは Windows PC 上で動作し、4/5/6 シリーズ MSO と同じ優れたユーザ・エクスペリエンスを提供


TekScope PC 解析ソフトウェアは、以下のような機能を備えています。

- 機器をリモートで接続し、高速 TekHSI データ転送を用いる低遅延波形アップデートを有効にします。
- チームでデータをリモートで共有できるので、誰もが実際にオシロスコープを使用するのと変わらない操作感で測定や解析を実行可能

- 複数のオシロスコープの波形をリアルタイムに同期させることが可能
- オシロスコープに TekScope PC 解析ソフトウェアが搭載されていない場合でも、高度な解析を行うことが可能
- テクトロニクスや他社の機器から、当社のオシロスコープ・セッション・ファイル／波形ファイルの呼び出しが可能
- サポートされている波形ファイル・フォーマット : .wfm、.isf、.csv、.h5、.tr0、.trc、.bin

## TekDrive コラボレーション・テストおよび測定ワークスペース

TekDrive を使用すると、接続されているデバイスのあらゆる種類のファイルをアップロード、保存、整理、検索、ダウンロード、および共有できます。TekDrive は、シームレスなファイルの共有や呼び出しを実現するために、計測器にネイティブに統合されています。USB メモリは必要ありません。スムーズなインタラクティブ波形ビューアを使用して、ブラウザで直接、.wfm、.isf、.tss、.csv などの標準ファイルの分析や確認を行います。TekDrive は、統合、自動化、セキュリティ強化を目的として設計されています。

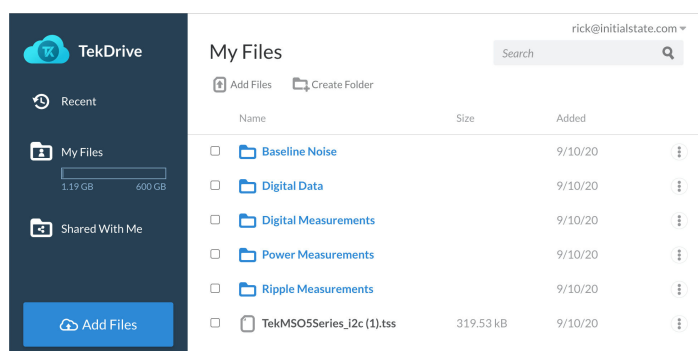

TekDrive コラボレーション・ワークスペース - お使いの計測器からファイルを直接保存し、チーム全体で共有

## 任意波形／ファンクション・ジェネレータ (AFG)

オプションの任意波形／ファンクション・ジェネレータを追加すると、センサ信号のシミュレーション信号を出力できるほか、信号にノイズを付加してマージン・テストを実行することもできます。統合されたファンクション・ジェネレータは、最高 MHz の標準波形（サイン、方形、パルス、ランプ/三角、DC、ノイズ、 $\sin(x)/x$  (Sinc)、ガウシアン、ローレンツ、指数立上り/立下り、ハーバサイン、Cardiac）を出力します。AFG は最大 128k ポイントの波形を内蔵ストレージまたは USB デバイスから読み込むことができます。

AFG の機能は当社の ArbExpress (PC ベースの波形作成／編集ソフトウェア) と互換性があり、複雑な波形を迅速かつ容易に作成できます。

## デジタル・ボルトメータ (DVM) とトリガ周波数カウンタ


本機は 4 桁のデジタル・ボルトメータ (DVM) と 8 桁のトリガ周波数カウンタを内蔵しています。オシロスコープ付属のプローブを使用して、任意のアナログ入力を電圧計の測定対象にすることができます。トリガ周波数カウンタは、きわめて精度の高いリードアウトを備えており、トリガとして設定したイベントの周波数を確実に読み取れます。

DVM およびトリガ周波数カウンタは、どちらも製品登録いただくが無償でアクティベートされて利用可能になります。

## セキュリティ強化

5 シリーズ MSO で、Security Menu (セキュリティメニュー) を通じて企業データを保護するオプションを利用できます。これには、リモート・ネットワーク・アクセス、I/O ポート、ファームウェアの更新をパスワード保護することで機器へのアクセスを制限し、データのセキュリティを保証するオプションが含まれます。デフォルトでは、オシロスコープは初期使用でのリモート・アクセスを無効にし、パスワードを使用、または使用しないでリモート・アクセスを有効にするオプションを提示します。

ユーザ・データをクリアするには、メニューから TekSecureTM を実行します。機器の底部から SSD を取り外し、オシロスコープを消毒します。

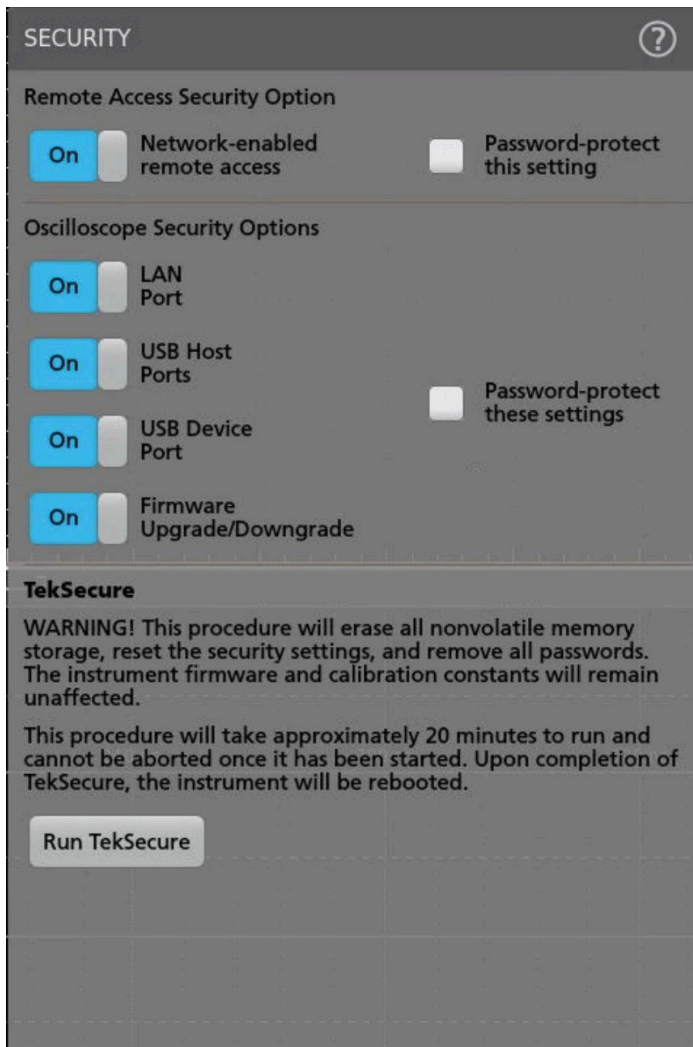

## 必要にときに、必要な状況におけるヘルプ表示

すばやく質問に回答できるように、複数の役立つリソースが用意されているため、マニュアルや Web サイトを参照する必要はありません。

- 多くのメニューには、グラフィカルなイメージと説明テキストが使用されており、機能の概要をすばやく把握できます。

- すべてのメニューの右上には、クエスチョン・マークが表示されており、内蔵ヘルプ・システムのそのメニュー項目に関連する部分を直接参照できます。
- ヘルプ・メニューには、ユーザ・インターフェースに関する簡単なチュートリアルが内蔵されているため、初心者でも短時間で操作方法を習得できます。

The screenshot shows the TekScope software interface with a help window open. The help window is titled "Add Measurements configuration menu overview" and contains the following text:

Use this configuration menu to select measurements you want to take on waveforms and add the measurements to the Results bar.

To open the **Add Measurements** configuration menu, tap the **Add New... Measure** button in the **Analysis** controls area.

The **Add Measurements** configuration menu always opens on the **Standard** measurement tab. The listed tabs and measurements depend on the installed measurement options and the selected signal source.

To add a measurement, select the source, select the measurement, and either tap the **Add** button or double-tap the measurement. The measurement is added to the Results bar.

To change individual measurement settings, double-tap the Measurement badge to open a Measurement configuration menu. See [Measurement configuration menu overview](#).

Add Measurements configuration menu fields and controls

Field or control	Description
<b>Measurement tabs</b>	The tabs along the top organize measurements by their type. The Standard tab is the default set of measurements that are built in to the instrument. Other tabs are shown when you install measurement options.
<b>Measurement description</b>	Shows a graphic and short description of a selected measurement. Use this information to verify that the selected measurement is correct for what you want to measure.

The diagram in the help window shows a waveform with a rising edge. The rise time is defined as the time required for an edge to rise from the Base reference level ( $R_b$ ) to the Top reference level ( $R_t$ ). This measurement is made on each cycle in the record.

The interface also shows the "ADD MEASUREMENTS" menu with tabs for "Standard" and "Jitter". The "Standard" tab is selected, and the "Rise Time" measurement is highlighted. The "TIMING MEASUREMENTS" section includes options for Period, Frequency, Unit Interval, Data Rate, Positive Pulse Width, Negative Pulse Width, Skew, Delay, Rise Time, Falling Slew Rate, Phase, Rising Slew Rate, Burst Width, Positive Duty Cycle, Negative Duty Cycle, and Time Outside Level.

マニュアルやインターネットを参照しなくても、内蔵ヘルプ・システムで疑問に対する回答がすばやく得られます。

## 仕様

すべての仕様は、特に断りのないかぎり保証値であり、すべての機種に適用されます。

### モデル概要

#### オシロスコープ

	MSO54	MSO56	MSO58
FlexChannel 入力数	4	6	8
最大アナログ・チャンネル数	4	6	8
最大デジタル・チャンネル数 (オプションのロジック・プローブを使用)	32	48	64
周波数帯域 (立上り時間の計算値)	350MHz (1.15ns)、500MHz (800ps)、1GHz (400ps)、2GHz (225ps)		
DC ゲイン確度	<b>2GHz 未満の機種 :</b>	50Ω : ±1.0% (1mV/div 以下では±2.0%) フル・スケールの±0.5% (1mV/div および 500μV/div 設定ではフル・スケールの±1.0%) 1MΩ : ±1.0% (1mV/div 以下では±2.0%) フル・スケールの±0.5% (1mV/div および 500μV/div 設定ではフル・スケールの±1.0%)	
	<b>2GHz の機種 :</b>	50Ω : ±1.2% (1mV/div 以下では±2.0%) フル・スケールの±0.6% (1mV/div および 500μV/div 設定ではフル・スケールの±1.0%) 1MΩ : ±1.0% (1mV/div 以下では±2.0%) フル・スケールの±0.5% (1mV/div および 500μV/div 設定ではフル・スケールの±1.0%)	
ADC 分解能	12 ビット		
垂直分解能	8 ビット@6.25GS/s 12 ビット@3.125GS/s 13 ビット@1.25GS/s (ハイレゾ) 14 ビット@625MS/s (ハイレゾ) 15 ビット@312.5MS/s (ハイレゾ) 16 ビット@125MS/s 以下 (ハイレゾ)		
サンプル・レート	6.25GS/s (全アナログ/デジタル・チャンネル、分解能 : 160ps)		
レコード長 (標準)	62.5M ポイント (全アナログ/デジタル・チャンネル)		
レコード長 (オプション)	125M、250M、500M ポイント (全アナログ/デジタル・チャンネル)		
波形取込みレート	500,000 波形/秒以上		
任意波形/ファンクション・ジェネレータ (オプション)	13 種類の定義済み波形タイプ、最高 50 MHz 出力		
DVM	4 桁の DVM (Web からの製品登録で無償)		
トリガ周波数カウンタ	8 桁の周波数カウンタ (Web からの製品登録で無償)		

## 垂直軸システム—アナログ部

帯域の選択 50Ω : 20MHz、250MHz、その機種の全帯域  
1MΩ : 20MHz、250MHz、500MHz

入力カップリング DC、AC

入力インピーダンス 50Ω±1%  
1MΩ±1% (13.0pF±1.5pF) (2GHz 未満の機種)  
1MΩ±1% (14.5pF±1.5pF) (2GHz の機種)

### 入力感度

1MΩ 500μV/div~10V/div (1-2-5 シーケンス)

50Ω 500μV/div ~1V/div (1-2-5 シーケンス)

機器の周波数帯域設定により異なりますが、500 μV/div は 1 mV/div をデジタル・ズームで 2 倍に拡大したもののか、

最大入力電圧 50Ω : 5V<sub>RMS</sub>、ピーク電圧 ≤ ±20V (DF ≤ 6.25%)  
1MΩ : 300V<sub>RMS</sub>、CAT II  
4.5 MHz~45 MHz では 20 dB/decade の割合で低下、45 MHz~450 MHz では 14 dB/decade の割合で低下。450MHz 超では 5.5VRMS

### 有効ビット数 (ENOB)、代表値

2GHz 未満の機種、ハイレゾ・モード、50Ω、10MHz 入力、90%フル・スケール

周波数帯域	ENOB
1GHz	7.6
500MHz	7.9
350MHz	8.2
250MHz	8.1
20MHz	8.9

2GHz の機種、ハイレゾ・モード、50Ω、10MHz 入力、90%フル・スケール

周波数帯域	ENOB
1GHz	7.0
250MHz	7.8
20MHz	8.7

### ランダム・ノイズ (RMS、代表値)



## 2GHz の機種、ハイレゾ・モード (RMS)

V/div	50Ω			1MΩ		
	1GHz	250MHz	20MHz	500MHz	250MHz	20MHz
1mV/div 以下 <sup>1</sup>	66.8μV	66.8μV	27.2μV	208μV	117μV	64.6μV
2mV/div <sup>2</sup>	96.9μV	77.5μV	28.5μV	224μV	117μV	66.7μV
5mV/div <sup>3</sup>	202μV	108μV	37.4μV	238μV	133μV	68.7μV
10mV/div	275μV	147μV	56.1μV	277μV	173μV	83.6μV
20mV/div	469μV	251μV	106μV	416μV	278μV	125μV
50mV/div	1.10mV	589μV	253μV	916μV	620μV	271μV
100mV/div	2.75mV	1.47mV	602μV	1.90mV	1.36mV	603μV
1V/div	18.4mV	10.8mV	4.68mV	20.3mV	14.6mV	6.54mV

## 1GHz、500MHz、350MHz の機種、ハイレゾ・モード (RMS)、代表値

V/div	50Ω					1MΩ			
	1GHz	500MHz	350MHz	250MHz	20MHz	500MHz	350MHz	250MHz	20MHz
1mV/div 以下 <sup>4</sup>	254μV	198μV	141μV	118μV	70.0μV	189μV	143μV	118μV	64.8μV
2mV/div	255μV	198μV	143μV	121μV	70.4μV	194μV	145μV	121μV	66.0μV
5mV/div	262μV	202μV	150μV	133μV	72.8μV	196μV	152μV	130μV	69.6μV
10mV/div	283μV	218μV	169μV	158μV	79.8μV	212μV	167μV	154μV	78.2μV
20mV/div	357μV	273μV	222μV	223μV	102μV	269μV	214μV	223μV	104μV
50mV/div	677μV	516μV	436μV	460μV	196μV	490μV	410μV	480μV	207μV
100mV/div	1.61mV	1.23mV	1.02mV	1.04mV	464μV	1.16mV	964μV	1.05mV	475μV
1V/div	13.0mV	9.88mV	8.41mV	8.94mV	3.77mV	13.6mV	10.6mV	11.1mV	5.47mV

## ポジション・レンジ

±5div

## オフセット・レンジ (最大)

- <sup>1</sup> 1mV/div では、周波数帯域が 175MHz (50Ω) に制限されます。  
<sup>2</sup> 2mV/div では、周波数帯域が 350MHz (50Ω) に制限されます。  
<sup>3</sup> 5mV/div では、周波数帯域が 1.5GHz (50Ω) に制限されます。  
<sup>4</sup> 500μV/div では、周波数帯域が 250MHz (50Ω) に制限されます。

入力信号は、50Ω 入力パスの最大入力電圧を超えることはできません。

V/div 設定	最大オフセット・レンジ、50Ω 入力
500μV/div - 99mV/div	±1V
100mV/div - 1V/div	±10V

## 2 GHz の機種

V/div 設定	最大オフセット・レンジ、50Ω 入力
500μV/div～50mV/div	±1V
51mV/div～99mV/div	± ( -10 × (V/div 設定) + 1.5V )
100mV/div～500mV/div	±10V
501mV/div～1V/div	± ( -10 × (V/div 設定) + 15V )

V/div 設定	最大オフセット・レンジ、1Ω 入力
500μV/div～63mV/div	±1V
64mV/div～999mV/div	±10V
1V/div～10V/div	±100V

## 1GHz 以下のモデル

V/div 設定	最大オフセット・レンジ	
	50Ω 入力	1MΩ 入力
500μV/div～63mV/div	±1V	±1V
64mV/div～999mV/div	±10V	±10V
1V/div～10V/div	±10V	±100V

オフセット精度 ± (0.005 × |オフセット・ポジション| + DC バランス)

チャンネル間クロストーク (代表値) 200 : 1 以上 (定格周波数まで。V/div 設定が等しい任意の 2 つのチャンネル)

DC バランス  
 0.1div、オシロスコープの入カインピーダンス : DC～50Ω (BNC、50Ω 終端)  
 0.2 div (1 mV/div)、オシロスコープの入カインピーダンス: DC～50 Ω (BNC、50 Ω 終端)  
 0.4div (500μV/div)、オシロスコープの入カインピーダンス : DC～50Ω (BNC、50Ω 終端)  
 0.2div、オシロスコープの入カインピーダンス : DC～1MΩ (BNC、50Ω 終端)  
 0.4div (500μV/div)、オシロスコープの入カインピーダンス : DC～1MΩ (BNC、50Ω 終端)

## 垂直軸システム – デジタル部

チャンネル数 接続された TLP058 型 1 本あたり 8 つのデジタル入力 (D7-D0) (アナログ・チャンネルは使用不可)

垂直分解能 1 ビット

最大入力ゲイン・レート 500 MHz

最小検出パルス幅 (代表値) 300ps

スレッシュホールド デジタル・チャンネルごとに 1 つのスレッシュホールド

スレッシュホールド・レンジ  $\pm 40V$

スレッシュホールド分解能 10mV

スレッシュホールド確度  $\pm (100mV + \text{校正後のスレッシュホールド値設定の } 3\%)$

入力ヒステリシス (代表値) 100mV (プローブ・チップ)

入力ダイナミック・レンジ (代表値)  $30V_{pp}$  ( $F_{in} \leq 200MHz$ )、 $10V_{pp}$  ( $F_{in} > 200MHz$ )

絶対最大入力電圧 (代表値)  $\pm 42V_{peak}$

最小電圧スイング (代表値) 400mVp-p

入力インピーダンス (代表値) 100k $\Omega$

プローブ負荷 (代表値) 2pF

## 水平軸システム

時間軸レンジ 200ps/div ~ 1,000s/div

サンプル・レート・レンジ 1.5625S/s ~ 6.25GS/s (リアルタイム)  
12.5GS/s ~ 500GS/s (補間)

レコード長の範囲

標準 1K ポイント ~ 62.5M ポイント (サンプル・インクリメント : 1)

Opt. 5-RL-125M	125M ポイント
Opt. 5-RL-250M	250M ポイント
Opt. 5-RL-500M	500M ポイント

**アパーチャ・タイム**  $\leq 0.450 \text{ ps} + (1 \times 10^{-11} \times \text{測定期間})_{\text{RMS}}$ 、測定期間が 100ms 以下の測定

**時間軸確度** 1ms 以上の任意の時間間隔で  $\pm 2.5 \times 10^{-6}$

概要	仕様
ファクトリ・トレランス	$\pm 5.0 \times 10^{-7}$ 、校正時、周囲温度 23°C、1ms 以上のタイム・インターバルにおいて
温度安定度	$\pm 5.0 \times 10^{-7}$ 、動作温度でテスト
エージング	$\pm 1.5 \times 10^{-6}$ 、1年を超えると、25°Cにおける周波数許容偏差が変化

**デルタ時間測定確度（公称値）**

$$DTA_{pp}(\text{typical}) = 10 \times \sqrt{\left(\frac{N}{SR_1}\right)^2 + \left(\frac{N}{SR_2}\right)^2 + \left(0.450 \text{ ps} + \left(1 \times 10^{-11} \times t_p\right)\right)^2} + TBA \times t_p$$

$$DTA_{\text{RMS}} = \sqrt{\left(\frac{N}{SR_1}\right)^2 + \left(\frac{N}{SR_2}\right)^2 + \left(0.450 \text{ ps} + \left(1 \times 10^{-11} \times t_p\right)\right)^2} + TBA \times t_p$$

*（ガウス・フィルタ応答から生じるエッジ形状を仮定）*

特定の機器の設定および入力信号に対するデルタ時間測定確度（DTA）を計算するための公式は、次のとおりです（ナイキスト周波数を超える信号成分は無視できるものとします）。

SR<sub>1</sub> = 測定の第 1 ポイント近辺のスルー・レート（最初のエッジ）

SR<sub>2</sub> = 測定の第 2 ポイント近辺のスルー・レート（2 番目のエッジ）

N = 入力換算ノイズ・リミット（保証値、(V<sub>RMS</sub>)

TBA = タイムベース確度または基準周波数誤差

t<sub>p</sub> = デルタ時間測定期間（秒）

**最高サンプル・レートでの最長記録時間** 標準のレコード長で 10 ms、最大レコード長（オプション）で 80 ms

**遅延時間範囲** -10 div ~ 5000 s

**デスクュー・レンジ** -125ns ~ +125ns（分解能：40ps）

**アナログ・チャンネル間の遅延時間、全帯域、代表値** 100ps 以下（2つのチャンネルの入カインピーダンスが 50Ω に設定されており、同一の V/div または 10mV/div 以上で DC カップリングされている場合）

**遅延、FlexChannel 間 (アナログとデジタル、代表値)** 1ns 未満 ns (TLP058 型およびオシロスコープの周波数帯域に合った受動プローブを使用する場合。帯域制限が適用されていない状態)

**遅延、2つのデジタル FlexChannel 間、代表値** 320ps

**遅延、デジタル FlexChannel の2つのビット間、代表値** 200ps

## トリガ・システム

**トリガ・モード** オート、ノーマル、シングル

**トリガ・カップリング** DC、HF 除去（50kHz 以上で減衰）、LF 除去（50kHz 未満で減衰）、ノイズ除去（感度が低下）

**トリガ・ホールドオフ範囲** 0ns～10s

**エッジタイプ・トリガ感度 (DC カップリング、代表値)**

経路	範囲	仕様
1MΩ 経路 (全機種)	0.5mV/div～0.99mV/div	5mV (DC～機器の周波数帯域)
	1mV/div 以上	5mV または 0.7div の大きい方 (DC～500MHz または機器の最高周波数帯域)、6mV または 0.8div の大きい方 (500MHz～機器の最高周波数帯域)
50Ω 経路、1GHz、500MHz、350MHz の機種		5.6mV または 0.7div の大きい方 (DC～500MHz または機器の最高周波数帯域)、7mV または 0.8div の大きい方 (500MHz～機器の最高周波数帯域)
50Ω 経路、2GHz の機種	0.5mV/div～0.99mV/div	3.0div (DC～機器の周波数帯域)
	1mV/div～9.98mV/div	1.5div (DC～機器の周波数帯域)
	10mV/div 以上	1.0div 未満 (DC～機器の周波数帯域)
電源ライン		固定

**トリガ・ジッタ (代表値)** 5pSRMS 以下 (サンプル・モード、エッジ・タイプ・トリガ)  
7pSRMS 以下 (エッジタイプ・トリガ、FastAcq モード)  
40pSRMS 以下 (エッジタイプ以外のトリガ・モード)

**トリガ・レベル・レンジ** この仕様はロジックおよびパルスのスレッシュホールドに適用されます。

ソース	レンジ
任意のチャンネル	スクリーン中心から $\pm 5\text{div}$
ライン	ライン電圧の約 50%に固定

## トリガ・タイプ

エッジ :	任意のチャンネルの立上り、立下り、またはその両方。カップリング : DC、AC、ノイズ除去、HF 除去、LF 除去
パルス幅 :	正のパルスまたは負のパルスでトリガ。イベントは、時間または他チャンネルの論理状態で設定可能
タイムアウト :	指定した時間にわたって、イベントがハイ、ロー、いずれかのままである場合にトリガ。イベントは、他チャンネルの論理状態で設定可能
ラント :	2つのスレッシュホールド・レベルのうち、1つ目のスレッシュホールドを横切り、2つ目のスレッシュホールドを横切ることなく、再び1つ目のスレッシュホールド・レベルを横切る場合にトリガ。イベントは、時間または他チャンネルの論理状態で設定可能
ウィンドウ :	ユーザが調整可能な2つのスレッシュホールドと時間軸によって定義されたウィンドウに、信号が出入りするか、または範囲内／範囲外にとどまるイベントにトリガ。イベントは、時間または他チャンネルの論理状態で設定可能
ロジック :	ロジック・パターンが真または偽になるか、クロック・エッジが発生するタイミングでトリガ。すべてのアナログ、デジタルの入力チャンネルのパターン (AND、OR、NAND、NOR) は、High、Low または Don't Care として定義。真になるロジック・パターンは時間クオリファイされる
セットアップ&ホールド :	任意のチャンネルで、クロックとデータの間セットアップ時間とホールド時間の違反がある場合にトリガ
立上り／立下り時間 :	指定したパルス・エッジ・レートよりも速いまたは遅い場合にトリガ。スロープは正、負またはいずれかが選択可能。イベントは、他チャンネルの論理状態で設定可能
ビデオ (Opt. 5-VID) :	NTSC、PAL、および SECAM ビデオ信号の全ライン、奇数ライン、偶数ライン、または全フィールドでトリガ
シーケンス :	A トリガが C イベントでリセットされた後の B イベントの回数、またはイベント数でトリガ。一般に、A および B トリガ・イベントには、任意のトリガ・タイプを設定できるが、A イベントまたは B イベントのどちらかがセットアップ／ホールドに設定されていて、もう片方のイベントをエッジに設定する必要がある場合には、ロジック・クオリフィケーションはサポートされない。Ethernet およびハイスピード USB (480Mbps) もサポートされない
ビジュアル・トリガ	標準トリガの機能を拡張し、すべての波形取込をスキャンし、ディスプレイに表示されるエリア (図形形状) と比較する。無制限の数のエリアを定義することができ、それぞれのエリアにクオリファイア (In、Out、Don't Care) を使用できる。ビジュアル・トリガの任意のエリアの組み合わせを使用して論理式を定義できるため、アキュイジション・メモリに格納されるイベントを詳細にクオリファイできる。長方形、三角形、台形、六角形、ユーザ定義などの形状で定義可能
パラレル・バス :	パラレル・バスのデータ値でトリガ。パラレル・バスは 1~64 ビット (デジタル・チャンネルおよびアナログ・チャンネルから)。バイナリまたは Hex をサポート
I <sup>2</sup> C バス (Opt. 5-SREMBD) :	10Mbps までの I <sup>2</sup> C バスのスタート、リピーテッド・スタート、ストップ、アドレス (7 または 10 ビット)、データ、またはアドレスとデータでトリガ
I <sup>3</sup> C バス (Opt. 5-SRI3C)	10 Mb/s までの I <sup>3</sup> C バスのスタート、リピーテッド・スタート、ストップ、アドレス、データ、I <sup>3</sup> C SDR ダイレクト、I <sup>3</sup> C SDR ブロードキャスト、ACK なし、T ビット・エラー、ブロードキャスト・アドレス・エラー、ホットジョイン、HDR 再開、HDR 終了でトリガ

<b>SPI バス (Opt. 5-SREMBD) :</b>	20 Mbps 以下の SPI バスの SS (Slave Select)、アイドル時間、またはデータ (1~16 ワード) でトリガ
<b>RS-232/422/485/UART バス (Opt. 5-SRCOMP) :</b>	スタート・ビット、パケットの末尾、データ、およびパリティ・エラーでトリガ (15Mbps まで)
<b>CAN バス (Opt. 5-SRAUTO) :</b>	1Mbps までの CAN バスのフレームの開始、フレーム・タイプ (データ、リモート、エラー、オーバーロード)、識別子、データ、識別子とデータ、フレームの最後、ミッシング・アクノレッジ、ビット・スタッフィング・エラーにトリガ
<b>CAN FD バス (Opt. 5-SRAUTO) :</b>	16 Mbps までの CAN FD バスのフレームの開始、フレームの種類 (データ、リモート、エラー、またはオーバーロード)、識別子 (標準または拡張)、データ (1~8 バイト)、識別子とデータ、フレームの終了、エラー (Ack なし、ビット・スタッフ・エラー、FD フォーム・エラー、任意のエラー)
<b>LIN バス (Opt. 5-SRAUTO) :</b>	1 Mbps までの LIN バスの同期、識別子、データ、ID とデータ、ウェイクアップ・フレーム、スリープ・フレーム、エラーでトリガ
<b>FlexRay バス (Opt. 5-SRAUTO) :</b>	10 Mbps までの FlexRay バスのフレームの開始、インジケータ・ビット (ノーマル、ペイロード、ヌル、同期、スタートアップ)、フレーム ID、サイクル・カウント、ヘッダ・フィールド (インジケータ・ビット、識別子、ペイロード長、ヘッダ CRC、サイクル・カウント)、識別子、データ、識別子とデータ、フレームの終了、エラーでトリガ
<b>SENT バス (Opt. 5-SRAUTOSEN) :</b>	パケットの開始、高速チャンネルのステータスとデータ、低速チャンネルのメッセージ ID とデータ、CRC エラーにトリガ
<b>SPMI バス (Opt. 5-SRPM) :</b>	シーケンスの開始、リセット、スリープ、シャットダウン、ウェイクアップ、マスタ・リード、マスタ・ライト、レジスタ・リード、レジスタ・ライト、拡張レジスタ・リード、拡張レジスタ・ライト、拡張レジスタ・リード・ロング、拡張レジスタ・ライト・ロング、デバイス・ディスクリプタ・ブロック・マスタ・リード、デバイス・ディスクリプタ・ブロック・スレーブ・リード、レジスタ 0 ライト、バス所有権の転送、パリティ・エラーにトリガ
<b>USB 2.0 LS/FS/HS バス (Opt. 5-SRUSB2) :</b>	480Mbps までの USB バスのシンク、リセット、サスペンド、レジューム、パケットの終了、トークン (アドレス) パケット、データ・パケット、ハンドシェイク・パケット、スペシャル・パケット、エラーにトリガ
<b>Ethernet バス (Opt. 5-SRENET) :</b>	10BASE-T および 100BASE-TX バスのスタート・フレーム、MAC アドレス、MAC Q タグ、MAC 長 / タイプ、MAC データ、IP ヘッダ、TCP ヘッダ、TCP/IPV4 データ、パケットの終了、FCS (CRC) エラーでトリガ
<b>オーディオ (I<sup>2</sup>S、LJ、RJ、TDM) バス (Opt. 5-SRAUDIO) :</b>	ワード・セレクト、フレーム・シンク、またはデータにトリガ。I <sup>2</sup> S/LJ/RJ の最高データ・レートは 12.5Mbps。TDM の最大データ・レートは 25Mbps
<b>MIL-STD-1553 バス (Opt. 5-SRAERO) :</b>	MIL-STD-1553 バス上のシンク、コマンド (送受信ビット、パリティ、サブアドレス/モード、ワード/モード・カウント、RT アドレス)、ステータス (パリティ、メッセージ・エラー、インストゥルメンテーション、サービス・リクエスト、ブロードキャスト・コマンド・レシーブ、ビジー、サブシステム・フラグ、ダイナミック・バス・コントロール・アクセプタンス (DBCA)、ターミナル・フラグ)、データ、時間 (RT/IMG)、およびエラー (パリティ・エラー、シンク・エラー、マンチェスター・エラー、非連続データ) にトリガ
<b>ARINC 429 バス (Opt. 5-SRAERO) :</b>	1 Mbps までの ARINC 429 バスのワードの開始、ラベル、データ、ラベルとデータ、ワードの終了、およびエラー (任意のエラー、パリティ・エラー、ワード・エラー、ギャップ・エラー) でトリガ
<b>RF 振幅対時間および RF 周波数対時間 (Opt. 5-SV-RFVT)</b>	エッジ、パルス幅、タイムアウト・イベントでトリガ

## アキュイジション・システム

サンプル	サンプル値の取込み
ピーク検出	すべての掃引速度において、640ps までのグリッチを取込み可能
アベレージング	2~10,240 波形 最大平均速度 = 180 波形/秒
高速なハードウェア平均化	短時間で多数の平均値を取得するための取得モードです。高速なハードウェア平均化では収集パスを最適化して、ストレージの切り捨てエラーを減らしたり、オプションのオフセット・ディザリング手法を使用して非線形の不全部の微調整を行ったりします。この機能は、プログラム可能なインタフェース・コマンドを通じて使用できます。 2~1,000,000 波形 最大平均速度 = 32,000 波形/秒
エンベロープ	複数回の波形取込みから、最小値と最大値の包絡線を表示することでピーク値を検出
ハイレゾ	それぞれのサンプル・レートに、固有の有限インパルス応答 (FIR) フィルタを適用することで、そのサンプル・レートで利用可能な最高帯域幅を維持しながら、エリアシングを防止し、オシロスコープの増幅器や ADC から、選択したサンプル・レートに対する使用可能帯域幅を上回る雑音を除去します。  ハイレゾ・モードでは、常に最低でも 12 ビットの垂直分解能が確保され、125MS/s 以下のサンプル・レートでは垂直分解能は 16 ビットにまで拡張されます。
FastAcq®	FastAcq は、500,000 波形/秒以上の取込みが可能で、動的に変化する信号の解析や間欠的なイベントの取込に最適 (アクティブなチャンネルが 1 つの場合。すべてのチャンネルがアクティブな場合は 100K 波形/秒以上)。
ロール・モード	オート・トリガ・モードでは、40ms/div より遅いタイムベース速度において、画面の右から左に波形をスクロール表示。
履歴モード	最大記録長を使用して、多くのトリガ・アキュイジションを取得したり、目的のものが表示されたときに停止したり、保存されているすべてのトリガ・アキュイジションを迅速に確認したりできます。履歴に保存できるアキュイジションの数は、(最大記録長) / (現在の記録長設定) です。
FastFrame™ アキュイジション	アキュイジション・メモリをセグメントに分割 最大トリガ・レートは 5,000,000 波形/秒以上 最小フレーム・サイズは 50 ポイント 最大フレーム数 : 1,000 ポイント以上のフレーム・サイズでは、最大フレーム数は記録長 / フレーム・サイズ。 50 ポイントのフレームでは、最大フレーム数は 1,000,000



## 波形測定

カーソル・タイプ

波形、垂直バー、水平バー、垂直／水平バー、ポーラ（XY/XYZ プロットのみ）

DC 電圧測定確度、アベレージ・アキュジション・モード

測定の種類	DC 確度 (V)
16 以上の波形の平均	$\pm((\text{DC ゲイン確度}) \times  \text{読み値} - (\text{オフセット} - \text{ポジション})  + \text{オフセット確度} + 0.1 \times \text{V/div 設定})$
16 回以上のアベレージ 2 回のデルタ電圧（同じオシロスコープ設定と環境条件で測定）	$\pm (\text{DC ゲイン確度} \times  \text{読み値}  + 0.05\text{div})$

自動測定

36 種類の自動測定項目。表示可能な測定項目の数に制限はなく、測定バッジとして個別に表示することも、または測定結果テーブルにまとめて表示することも可能

振幅測定

振幅、最大値、最小値、p-p、正のオーバシュート、負のオーバシュート、平均値、実効値、AC 実効値、トップ、ベース、領域

タイミング測定

周期、周波数、UI、データ・レート、正のパルス幅、負のパルス幅、スキュー、遅延、立上り時間、立下り時間、位相、立上りスルー・レート、立下りスルー・レート、バースト幅、正のデューティ比、負のデューティ比、レベル外の時間、セットアップ時間、ホールド時間、N 周期、ハイ時間、ロー時間、最小になる時間、最大になる時間

ジッタ測定（標準）

TIE および位相ノイズ

測定結果の統計値

平均、標準偏差、最大値、最小値、母集団統計値は、現在のアキュジション、およびすべてのアキュジションのどちらでも利用可能

リファレンス・レベル

自動測定で使用されるリファレンス・レベルは、%または単位でユーザ定義が可能リファレンス・レベルは、すべての測定にグローバルに設定することも、ソース・チャンネルまたは信号ごと、または測定ごとに個別に設定することも可能

ゲーティング

スクリーン、カーソル、ロジック、サーチ、または時間。測定を行うアキュジションの領域を指定する。ゲーティングはグローバル（グローバルに設定されたすべての測定に影響）にもローカル（測定にはすべて固有の時間ゲートを設定可能。スクリーン、カーソル、ロジック、サーチにはただ 1 つのローカル・ゲートのみを利用可能）にも設定可能

測定プロット

ヒストグラム、タイム・トレンド、スペクトラム、アイ・ダイアグラム（TIE 測定のみ）、位相ノイズ（位相ノイズ測定のみ）

測定リミット

測定値に対するユーザ定義可能なリミット値によるパス／フェイル・テスト。スクリーン・イメージの保存、波形の保存、システム・リクエスト（SRQ）、アキュジションの停止など、測定値がフェイルになった際のアクションの定義

ジッタ解析（Opt. 5-DJA）で追加される機能

測定項目	ジッタ・サマリ、TJ@BER、RJ- $\delta\delta$ 、DJ- $\delta\delta$ 、PJ、RJ、DJ、DDJ、DCD、SRJ、J2、J9、NPJ、F/2、F/4、F/8、アイの高さ、アイの高さ@BER、アイの幅、アイの幅@BER、アイ・ハイ、アイ・ロー、Qファクタ、ビット・ハイ、ビット・ロー、ビット振幅、DC コモンモード、AC コモンモード (p-p)、差動クロスオーバ、T/nT 比、SSC 周波数偏差、SSC 変調レート
測定プロット	アイ・ダイアグラム、ジッタ・バスタブ 高速なアイ・レンダリング：アイの境界を定義するユニット・インターバル (UI) を表示。周囲の UI の数もユーザ指定できるため視覚的なコンテキストが向上 完全なアイ・レンダリング：すべての有効なユニット・インターバル (UI) を表示
測定リミット	測定値に対するユーザ定義可能なリミット値によるパス/フェイル・テスト。スクリーン・イメージの保存、波形の保存、システム・リクエスト (SRQ)、アキュイジションの停止など、測定値がフェイルになった際のアクションの定義
アイ・ダイアグラム・マスク・テスト	マスクのオートフィットを使用したマスクによる自動パス/フェイル・テスト

### パワー解析 (Opt. 5-PWR) で追加される機能

測定項目	入力解析 (周波数、 $V_{RMS}$ 、 $I_{RMS}$ 、電圧/電流クレスト・ファクタ、有効電力、皮相電力、無効電力、力率、位相角、高調波、突入電流、入力容量) 振幅解析 (サイクル振幅、サイクル・トップ、サイクル・ベース、サイクル最大値、サイクル最小値、サイクル・ピーク) タイミング解析 (周期、周波数、負のデューティ・サイクル、正のデューティ・サイクル、負のパルス幅、正のパルス幅) スイッチング解析 (スイッチング・ロス、dv/dt、di/dt、安全動作領域、 $R_{DSon}$ ) 磁気解析 (インダクタンス、 $I$ 対 $\text{Intg}$ (V)、磁気損失、磁気プロパティ) 出力解析 (電源リップル、スイッチング・リップル、効率、ターンオン時間、ターンオフ時間) 周波数応答解析 (制御ループ応答ボード線図、電源電圧変動除去比、インピーダンス)
測定プロット	高調波バー・グラフ、スイッチング・ロス軌跡プロット、安全動作領域 (SOA)
測定リミット	測定値に対するユーザ定義可能なリミット値によるパス/フェイル・テスト。スクリーン・イメージの保存、波形の保存、システム・リクエスト (SRQ)、アキュイジションの停止など、測定値がフェイルになった際のアクションの定義

### インバータ/モータ・ドライブ解析 (Opt. 5-IMDA) で追加される機能

測定項目	入力解析 (電力品質、高調波、入力電圧、入力電流、および入力電力) リップル解析 (ライン・リップルおよびスイッチング・リップル) 出力解析 (位相図および効率) DQ0 解析 (DQ0) には Opt. 5-IMDA-DQ0 が必要
測定プロット	高調波バー・グラフ、位相図

### インバータ・モーター・ドライブ解析の機械測定 (Opt. 5-IMDA-MECH には Opt. 5-IMDA が必要) で追加される機能

サポートされているセンサー	ホール・センサー、QEI (直交エンコーダ・インターフェース)
測定項目	電気解析 (電力品質、高調波、リップル、DQ0、および効率) メカニカル解析 (速度、アクセラレーション、角度 (QEI 方式)、方向、およびトルク)
測定プロット	時間トレンド、アクイジション・トレンド、位相図、高調波棒グラフ、DQ0、およびヒストグラム (速度分布)

#### デジタル電源管理 (Opt. 5-DPM) で追加される機能

測定項目	リップル解析 (リップル) トランジェント解析 (オーバシュート、アンダシュート、ターンオンのオーバシュート、DC レール電圧) 電源シーケンス解析 (ターンオン、ターンオフ) ジッタ解析 (TIE、PJ、RJ、DJ、アイの高さ、アイの幅、アイ・ハイ、アイ・ロー) PI/SI 解析 (PSIJ)
------	--

#### デジタル電源管理ベーシック (Opt. 5-DPMBAS) で追加される機能

測定項目	リップル解析 (リップル) トランジェント解析 (オーバシュート、アンダシュート) 電源シーケンス解析 (ターンオン、ターンオフ)
------	---

#### LVDS デバッグ/解析オプション (Opt. 5-DBLVDS) で追加される機能

データ・レーン測定	汎用テスト (UI、立上り時間、立下り時間、データ幅、データ間スキュー (PN)、データ間スキュー (レーン間)、データ・ピーク・ツー・ピーク) ジッタ・テスト (AC タイミング、クロック・データ・セットアップ時間、クロック・データ・ホールド時間、アイ・ダイアグラム (TIE)、TJ@BER、DJ デルタ、RJ デルタ、DDJ、ディエンファシス・レベル)
クロック・レーン測定	汎用テスト (周波数、周期、デューティ・サイクル、立上り時間、立下り時間、クロック間スキュー (PN)、クロック・ピーク・ツー・ピーク) ジッタ・テスト (TIE、DJ、RJ) SSC On (変調レート、平均周波数偏差)

#### 波形演算

演算波形数 無制限

演算 波形および定数の加算、減算、乗算、除算

代数式 波形、スカラ、任意の変数、波形測定結果などを含めた広範な代数式を定義可能。複雑な数式を使用して、演算を重ねて実行できる。例：(Integral (CH1-Mean (CH1))) × 1.414 × VAR1)

演算関数	反転、積分、微分、平方根、指数、Log 10、Log e、Abs、Ceiling、Floor、Min、Max、Degree、Radian、Sin、Cos、Tan、ASin、ACos、ATan
関係式	>、<、≥、≤、=、≠のブール値の結果
ロジック	AND、OR、NAND、NOR、XOR、EQV
フィルタ関数 (標準)	ユーザ定義フィルタのロード。フィルタ係数を含むファイルを指定。
フィルタ関数 (Opt. 5-UDFLT)	
フィルタ・タイプ	ロー・パス、ハイ・パス、バンド・パス、バンド・ストップ、オール・パス、ヒルベルト、微分器、およびカスタム
フィルタ応答タイプ	バターワース、チェビシェフI、チェビシェフII、楕円、ガウシアン、およびベッセル-トムソン
FFT 関数	スペクトラム (振幅、位相、実数および虚数)
FFT 垂直軸単位	振幅 : リニアおよびログ (dBm) 位相 : Degree、Radian、グループ遅延
FFT の窓関数	ハニング、方形、ハミング、ブラックマンハリス、フラットトップ2、ガウシアン、カイザー-ベッセル、Tek 指数関数
<b>スペクトラム表示</b>	
中心周波数	アナログ帯域による制限あり
スパン	18.6Hz~312.5MHz 18.6Hz~500MHz (Opt. 5-SV-BW-1) 粗調整 (1-2-5 シーケンス)
RF 測定	Spectrum View のトレース・データおよび表示でのチャンネル・パワー (CHP)、隣接チャンネル・パワー比 (ACPR)、占有帯域幅 (OBW) の測定値
RF 対時間の波形	振幅対時間、周波数対時間、位相対時間 (Opt. 5-SV-RFVT を使用)
RF 対時間トリガ	RF 振幅対時間/RF 周波数対時間のエッジ、パルス幅、およびタイムアウト (Opt. 5-SV-RFVT を使用)

**スペクトログラム** X 軸に RF 周波数対時間対振幅が周波数で表示され、Y 軸には時間、パワー・レベルが異なる色で表示されます (Opt. 5-SV-RFVT)

**分解能帯域幅 (RBW)** 93 $\mu$ Hz~62.5MHz  
93  $\mu$ Hz~100 MHz (Opt. 5-SV-BW-1)

**IQ キャプチャ** データは同相および直交 (I&Q) サンプルとして保存され、時間領域データと I&Q データの間で正確な同期が維持されます。  
RF 対時間の波形が有効な場合 (Opt. 5-SV-RFVT)、IQ データがファイルに取り込まれて、エクスポートされ、サードパーティ製アプリケーション内でさらに解析が実施されます。  
最大取込時間は、スパンおよびサンプル・レートによって異なります。6.25 GS/s および 500 MHz スパンでは、最大取込時間は 0.086 秒です。312.5 MHz スパンでは、最大取込時間は 0.172 秒です。40 MHz スパンでは、最大取込時間は 0.687 秒です。1 MHz スパンでは、最大取込時間は 43.980 秒です。

#### ウィンドウ・タイプと係数

ウィンドウ・タイプ	帯域幅係数
ブラックマン-ハリス	1.90
フラットトップ : 2	3.77
ハミング	1.30
ハニング	1.44
カイザー - ベッセル	2.23
方形	0.89

**スペクトラム・タイム** FFT ウィンドウ係数/RBW

**基準レベル** 基準レベルは、アナログ・チャンネルの Volts/Div 設定によって自動的に設定  
設定範囲 : -42dBm~+44dBm

**垂直軸位置(Vertical Position)** -100div~+100div

**垂直軸単位** dBm、dB $\mu$ W、dBmV、dB $\mu$ V、dBmA、dB $\mu$ A

**垂直軸スケーリング** リニア、対数

**水平スケーリング** リニア、対数

**マルチチャンネル・スペクトラム解析** 各 FlexChannel 入力は、Spectrum View、RF 対時間の波形 (オプション RFVT を使用)、スペクトログラム (オプション RFVT を使用) で構成できます。  
チャンネル間で同時に複数の RF 測定を実行できます。

Spectrum 時間と中心周波数の設定は、ロックを解除してチャンネル間で個別に移動できません。Spectrum View チャンネルはすべて、同じスパン、分解能帯域幅、ウィンドウ・タイプを共有する必要があります。

## サーチ

サーチの数	無制限
サーチ・タイプ	エッジ、パルス幅、タイムアウト、ラント・パルス、ウィンドウ違反、ロジック・パターン、セットアップ／ホールド違反、立上り／立下り時間、バス・プロトコル・イベントなど、ユーザ指定の条件に基づいて、ロング・メモリ全体から該当するすべてのイベントの検索が可能。サーチ結果は波形ビューまたは結果テーブルに表示可能

## 保存

保存	オシロスコープまたは USB メディア、リモート・ネットワーク・ドライブ、または TekDrive コラボレーション・ワークスペースにファイルを直接保存します。
----	--

波形形式	テクトロニクス波形データ (.wfm)、カンマ区切り値 (.csv)、MATLAB (.mat)
------	--

波形ゲーティング	カーソル、スクリーン、再サンプリング (n 番目のサンプルごとに保存)
----------	-------------------------------------

スクリーン・キャプチャ形式	ポータブル・ネットワーク・グラフィック (*.png)、24 ビット・ビットマップ (*.bmp)、JPEG (*.jpg)
---------------	--

セットアップ・タイプ	テクトロニクス・セットアップ (.set)
------------	-----------------------

レポート形式	Adobe ポータブル・ドキュメント (.pdf)、シングル・ファイルの Web ページ (.mht)
--------	---

セッション形式	テクトロニクス・セッション・セットアップ (.tss)
---------	-----------------------------

## ディスプレイ

ディスプレイ・タイプ	395mm 液晶 TFT カラー・ディスプレイ
------------	-------------------------

ディスプレイ解像度	1,920×1,080 (水平ピクセル×垂直ピクセル、HD)
-----------	--------------------------------

表示モード	<p>オーバーレイ: トレースが互いに重なり合って表示される従来からのオシロスコープの表示モード</p> <p>スタック: 各波形が固有のスライスに表示される表示モード。それぞれの波形は別々に表示されていても、フル・レンジの ADC を活用できるスライスの内部にチャンネルのグループをオーバーレイすることもできるため、信号の表示を見ながら簡単に比較できます。</p>
-------	---

ズーム	すべての波形およびプロット表示で水平および垂直ズームをサポート
-----	---------------------------------

補間方式	Sin(x)/x、直線
波形スタイル	ベクタ、ドット、可変パーシスタンス、無限パーシスタンス
波形目盛	移動可能／固定目盛、グリッド／時間／フル／なしから選択可能
カラー・パレット	ノーマル、反転（スクリーンショット） 個々の波形の色をユーザが選択可能
フォーマット	YT、XY、XYZ
多言語ユーザ・インターフェース	英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語
多言語ヘルプ	英語版、日本語版、簡体字中国語版

## 任意波形／ファンクション・ジェネレータ(オプション)

動作モード	オフ、連続、バースト
ファンクションのタイプ	任意波形、正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、三角波、DC レベル、ガウシアン、ローレンツ、指数立上り/立下り、Sin(x)/x、不規則ノイズ、ハーバーサイン、Cardiac

### 正弦波

周波数レンジ	0.1 Hz～MHz
周波数の設定分解能	0.1Hz
周波数確度	130ppm（周波数 $\leq$ 10kHz）、50ppm（周波数 $>$ 10kHz） これは正弦波、ランプ、方形波、パルス波形専用です。
振幅レンジ	20mV <sub>pp</sub> ～5V <sub>pp</sub> （オープン回路）、10mV <sub>pp</sub> ～2.5V <sub>pp</sub> （50 $\Omega$ ）
振幅フラットネス（代表値）	$\pm$ 0.5dB（1kHz） $\pm$ 1.5dB（1kHz、20mV <sub>pp</sub> 未満の振幅）
全高調波歪み（代表値）	1%（振幅：200mV <sub>pp</sub> 以上、50 $\Omega$ 負荷） 2.5%（振幅：50mV 以上、200mV <sub>pp</sub> 未満、50 $\Omega$ 負荷） 正弦波のみに適用されます。
スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ（代表値）	40 dB（V <sub>pp</sub> $\geq$ 0.1V）、30dB（V <sub>pp</sub> $\geq$ 0.02V）、50 $\Omega$ 負荷

### 方形波／パルス波

周波数レンジ	0.1 Hz～MHz
周波数の設定分解能	0.1Hz

周波数精度	130ppm (周波数 $\leq$ 10kHz)、50ppm (周波数 $>$ 10kHz)
振幅レンジ	20mV <sub>pp</sub> ~5V <sub>pp</sub> (オープン回路)、10mV <sub>pp</sub> ~2.5V <sub>pp</sub> (50 $\Omega$ )
デューティ・サイクル・レンジ	10%~90%または最小パルス (10ns)、どちらか長い方 最小パルス時間は、オン・タイムとオフ・タイムの両方に適用されるため、周波数が高くなると、10ns のオフ・タイムを維持するために、最大デューティが低下
デューティ・サイクル分解能	0.1%
最小パルス幅 (代表値)	10ns。オンまたはオフのいずれかの継続時間の最小値
立上り/立下り時間 (代表値)	5ns、10%~90%
パルス幅分解能	100ps
オーバershoot (代表値)	6%未満、100mV <sub>pp</sub> を超える信号ステップ これは正方向のトランジション (正のオーバershoot) および負方向のトランジション (負のオーバershoot) に適用される
非対称性 (代表値)	$\pm$ 1% $\pm$ 5ns、デューティ・サイクル 50%のとき
ジッタ (代表値)	60ps TIE <sub>RMS</sub> 未満、100mV <sub>pp</sub> 以上の振幅、40%~60%のデューティ・サイクル

---

**ランプ/三角波**

周波数範囲	0.1 Hz~
周波数の設定分解能	0.1Hz
周波数精度	130ppm (周波数 $\leq$ 10kHz)、50ppm (周波数 $>$ 10kHz)
振幅レンジ	20mV <sub>pp</sub> ~5V <sub>pp</sub> (オープン回路)、10mV <sub>pp</sub> ~2.5V <sub>pp</sub> (50 $\Omega$ )
シンメトリ	0%~100%
シンメトリの分解能	0.1%

---

レベルの範囲	$\pm$ 2.5V (オープン回路) $\pm$ 1.25V (50 $\Omega$ )
--------	---

---

不規則ノイズの振幅レンジ	20mV <sub>pp</sub> ~5V <sub>pp</sub> (オープン回路) 10mV <sub>pp</sub> ~2.5V <sub>pp</sub> (50 $\Omega$ )
--------------	--

---

**Sin(x)/x**

最高周波数	MHz
-------	-----

---

**ガウシアン・パルス、ハーバーサイン、ローレンツ・パルス**

最高周波数	MHz
-------	-----

---

**ローレンツ・パルス**



周波数範囲	0.1 Hz ~ MHz
振幅レンジ	20mV <sub>pp</sub> ~ 2.4V <sub>pp</sub> (オープン回路) 10mV <sub>pp</sub> ~ 1.2V <sub>pp</sub> (50Ω)

**心電図波形**

周波数レンジ	0.1 Hz ~
振幅レンジ	20mV <sub>pp</sub> ~ 5V <sub>pp</sub> (オープン回路)、 10mV <sub>pp</sub> ~ 2.5V <sub>pp</sub> (50Ω)

**任意波形**

メモリ容量	1 ~ 128k
振幅レンジ	20mV <sub>pp</sub> ~ 5V <sub>pp</sub> (オープン回路)、 10mV <sub>pp</sub> ~ 2.5V <sub>pp</sub> (50Ω)
繰返しレート	0.1 Hz ~ MHz
サンプル・レート	250 MS/s

信号振幅精度	$\pm [(\rho\text{-p 振幅設定の } 1.5\%) + (\text{DC オフセット設定の } 1.5\%) + 1\text{mV}]$ (周波数 = 1kHz)
--------	--

信号振幅分解能	1mV (オープン回路) 500μV (50Ω)
---------	-----------------------------

正弦波およびランプ波の周波数精度	$1.3 \times 10^{-4}$ (周波数 : 10kHz 以下) $5.0 \times 10^{-5}$ (周波数 : > 10kHz)
------------------	---

DC オフセット・レンジ	$\pm 2.5\text{V}$ (オープン回路) $\pm 1.25\text{V}$ (50Ω)
--------------	--

DC オフセット分解能	1mV (オープン回路) 500μV (50Ω)
-------------	-----------------------------

DC オフセット精度	$\pm [(\text{絶対オフセット設定の } 1.5\%) + 1\text{mV}]$ 環境温度 25°C から 10°C ごとに 3mV の不確実性を加算
------------	---

**デジタル・ボルトメータ(DVM)**

測定項目	DC、AC <sub>RMS</sub> + DC、AC <sub>RMS</sub>
------	---

電圧分解能	4 桁
電圧確度	
DC :	$\pm((1.5\% \times  \text{読み値} - \text{オフセット} - \text{ポジション} ) + (0.5\% \times  \text{オフセット} - \text{ポジション} ) + (0.1 \times \text{Volts/div}))$ <p>30°C超過分 1°Cにつき、 読み値 - オフセット - ポジション が 0.100%の割合で低下 ±5div (スクリーン中央から) の信号</p>
AC :	<p>±2% (40Hz~1kHz)、40Hz~1kHz 範囲外に高調波成分が存在しない場合 AC (代表値) : ±2% (20Hz~10kHz)</p> <p>AC 測定においては、V<sub>pp</sub> の入力信号が 4~10div の間に収まり、画面に波形全体が表示されるように、入力チャンネルの垂直軸を設定する必要があります。</p>

## トリガ周波数カウンタ

解像度	8 桁
確度	$\pm (1 \text{ カウント} + \text{時間軸確度} \times \text{入力周波数})$ <p>信号は 8mV<sub>pp</sub> または 2div 以上でなければならない (どちらか大きな方)</p>
最高入力周波数	<p>10Hz~アナログ・チャンネルの最高周波数帯域 信号は 8mV<sub>pp</sub> または 2div 以上でなければならない (どちらか大きな方)</p>

## プロセッサのシステム

ホスト・プロセッサ	Intel i5-4400E (2.7GHz、64 ビット、デュアル・コア・プロセッサ) または Intel i5-8400H (2.5GHz、64 ビット、クアッド・コア・プロセッサ)
-----------	---



注: 新製品には i5-8400H プロセッサが搭載されています。

オペレーティング・システム	<p>基本構成の機器 : 商用組込み Linux</p> <p>Opt. 5-WIN をインストールした機器 : Microsoft Windows 10 Opt. 5-WIN は MSO58LP 型では使用できません。</p>
---------------	--

保存時	<p>i5-4400E プロセッサ搭載製品 : 80GB 以上内部 80 mm M.2 カード</p> <p>i5-8400H プロセッサ搭載製品 : 250GB 以上リムーバブル・ソリッド・ステート・ドライブ</p>
-----	---



注: 新製品には i5-8400H プロセッサが搭載されています。

Microsoft Windows 10 OS がインストールされたソリッド・ステート・ドライブ (SSD) (Opt. 5-WIN) ≥ 512GB SSD. フォーム・ファクタ : 2.5 インチ SSD、SATA-3 インタフェース。このドライブは、お客様によるインストールが可能で、Microsoft Windows 10 Enterprise IoT 2016 LTSC (64 ビット) オペレーティング・システムのライセンスが含まれる

## 入出力ポート

**DisplayPort コネクタ** 20 ピン DisplayPort コネクタ。外部モニターやプロジェクタに接続し、ライブ波形などのオシロスコープ画面を表示

**DVI コネクタ** 29 ピン DVI-D コネクタ。外部モニターやプロジェクタに接続し、ライブ波形などのオシロスコープ画面を表示

**VGA** DB-15 Fe コネクタ。外部モニターやプロジェクタに接続し、ライブ波形などのオシロスコープ画面を表示。

### プローブ補正出力 (代表値)

**接続機能 :** コネクタは機器の右側の下の部分に配置

**振幅 :** 0~2.5V

**周波数 :** 1kHz

**ソース・インピーダンス :** 1k $\Omega$

**外部リファレンス入力** 時間軸システムは外部 10MHz リファレンス信号 ( $\pm 4$ ppm) に位相ロック可能

**USB インタフェース (ホスト、デバイス・ポート)** USB ホスト・ポート (前面パネル) : USB 2.0 ハイスピード・ポート (x2)、USB 3.0 スーパースピード・ポート (x1)  
 USB ホスト・ポート (後部パネル) : USB 2.0 ハイスピード・ポート (x2)、USB 3.0 スーパースピード・ポート (x2)  
 USB デバイス・ポート (後部パネル) : USB 3.0 スーパースピード・デバイス・ポート (x1)。USBTMC 対応)

**Ethernet インタフェース** 10/100/1000Mbps

**補助出力** 後部パネルに BNC コネクタ。オシロスコープのトリガ、オシロスコープの内部リファレンス・クロック出力、または AFG シンク・パルスイベント出力において正または負のパルス出力が可能

特性	リミット
Vout (HI)	開回路 : 2.5V 以上、50 $\Omega$ 負荷で接地 : 1.0V 以上
Vout (LO)	4mA 以下の負荷 : 0.7V 以下、50 $\Omega$ 負荷で接地 : 0.25V 以下

**ケンジントン・ロック** 後部パネルにケンジントン・ロック用のセキュリティ・スロットを装備

LXI	クラス : LXI Core 2011 バージョン : 1.4
-----	------------------------------------

## 電源

### 電源

消費電力	最大 400W
ソース電圧	100~240V ±10% (50Hz~60Hz) 115V ±10% (400Hz) ±10%

## 物理特性

### 寸法

高さ : 309mm (脚をたたみ、ハンドルを後ろに回した状態)
高さ : 371mm (脚をたたみ、ハンドルを上げた状態)
幅 : 454mm (ハンドル・ハブ間)
奥行 : 205mm (脚の後ろからノブ前面まで、ハンドルを上げた状態)
高さ : 297.2mm (脚をたたみ、ハンドルを後ろに回した状態)

### 質量

11.4kg 未満

### 冷却

通気のために、(機器の前面から見て) 右側および後面に 50.8mm 以上の隙間を確保してください。

ラックマウント・タイプ	7U (オプションの RM5 ラックマウント・キット)
-------------	-----------------------------

## 環境仕様

### 温度

動作時	+ 0°C ~ + 50°C
非動作時	-20°C ~ + 60°C

### 湿度

動作時	40°C以下で相対湿度 5%~90% (RH) + 40°C超、+ 50°C以下で相対湿度 5%~55% (RH)、結露なし、最高湿球温度 + 39°C
非動作時	+ 40°C以下で相対湿度 5%~90% (RH) + 40°C超、+ 50°C以下で相対湿度 5%~39% (RH)、結露なし、最高湿球温度 + 39°C

### 高度

動作時	最高 3,000m
非動作時	最高 12,000m (39,370 フィート)

---

<b>温度</b>	
動作時	+ 0°C ~ + 50°C
非動作時	-20°C ~ + 60°C

---

<b>湿度</b>	
動作時	40°C以下で相対湿度 5%~90% (RH) + 40°C超、+ 50°C以下で相対湿度 5%~ 55% (RH)、結露なし、最高湿球温度 + 39°C
非動作時	+ 40°C以下で相対湿度 5%~90% (RH) + 40°C超、+ 50°C以下で相対湿度 5%~ 39% (RH)、結露なし、最高湿球温度 + 39°C

---

<b>高度</b>	
動作時	最高 3,000m
非動作時	最高 12,000m

---

## EMC 適合性および安全性

安全性規格	米国 NRTL 認証取得 - UL61010-1 および UL61010-2-030 カナダ認証 - CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 および CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-030 EU 適合性 - 低電圧指令 2014-35-EU および EN61010-1。 国際規格準拠 - IEC 61010-1 および IEC61010-2-030
規制	CE マーク (EU)、UL 認定 (米国/カナダ) RoHS 準拠

---

## ソフトウェア

IVI ドライバ	LabVIEW、LabWindows/CVI、Microsoft .NET、および MATLAB など、一般的なアプリケーションの標準測定器プログラム・インタフェースを提供 VISA を介して Python、C/C++/C# など数多くの言語に対応が可能。
e*Scope®	標準 Web ブラウザを通じて、ネットワーク接続経由でオシロスコープの制御を可能にします。オシロスコープの IP アドレスまたはネットワーク名を入力するだけで、ブラウザに Web ページが表示されます。この Web ページから、設定、波形、測定値、画面イメージを転送および保存したり、オシロスコープの設定を Web ブラウザから直接変更することもできます。または、e*Scope 認証をパスワード保護アクセスに設定して、オシロスコープを制御し、表示できます。
TekDrive	接続されているデバイスのあらゆる種類のファイルをアップロード、保存、整理、検索、ダウンロード、および共有できます。TekDrive は、シームレスなファイルの共有や呼び出しを実現するために、計測器にネイティブに統合されています。USB メモリは必要ありません。ビューアを使用して、ブラウザで直接、.wfm、.isf、.tss、and .csv などの標準ファイルの分析や確認を行います。詳細については、 <a href="http://www.tek.com/software/tekdrive">www.tek.com/software/tekdrive</a> を参照してください。
SignalVu-PC	5 シリーズ MSO または別の Windows PC 上で直接実行できる、拡張ベクトル信号解析ソフトウェアです。Opt. 5-SV-RFVT が 5 シリーズ MSO にインストールされていなければなりません。

---

Connect (CONxx-SVPC) ライセンスを SignalVu-PC にインストールする必要があります。xx は、ノード・ロック・ライセンスの場合は NL、フローティング・ライセンスの場合は FL です。

- LXI Web インタフェース** ブラウザのアドレス・バーにオシロスコープの IP アドレスまたはネットワーク名を入力するだけで、標準の Web ブラウザ経由でオシロスコープと接続できます。Web インタフェースで、機器のステータスと構成、ネットワーク設定のステータスと変更、e\*Scope Web ベースのリモート・コントロールを通じた機器の制御を行うことができます。すべての Web のやり取りが LXI 仕様、バージョン 1.4 に準拠しています。
- サンプル・プログラム** 4/5/6 シリーズ・プラットフォーム上でのプログラミングは簡単な作業ではありませんでした。プログラマ・マニュアルや GitHub サイトには、遠隔操作による自動化に役立つ数多くのコマンドやサンプル・プログラムが掲載されています。<https://github.com/tektronix/programmatic-control-examples> をご覧ください。

## ご注文の際は以下の型名をご使用ください。

以下のステップに従って、お客様の測定のニーズに合わせて、最適な機器とオプションを選択してください。

### ステップ 1

必要な FlexChannel 入力数に基づいて、5 シリーズ MSO の機種を選択（各 FlexChannel 入力は、1つのアナログ入力または 8つのデジタル入力のいずれにも使用可能）

型名	FlexChannel の数
MSO54	4
MSO56	6
MSO58	8

### 全機種に付属

FlexChannel ごとに 1本の TPP0500B 型 500MHz プローブ（周波数帯域が 350MHz または 500MHz の機種）  
受動プローブ（アナログ）： TPP1000 型 1GHz プローブ（周波数帯域が 1GHz または 2GHz の機種）

インストールおよび安全性に関するマニュアル

内蔵オンライン・ヘルプ

前面カバー（アクセサリ・ポーチの一部）

電源ケーブル

計量標準総合センターへのトレーサビリティと、ISO9001/ISO17025 品質システム登録を文書化した校正証明書

本体は 3 年保証。

付属プローブは 1 年保証

### ステップ 2

内蔵機能の追加（オプション・バンドルの追加）

オプション・バンドルには、3つのクラス（スターター、プロ、アルティメット）があり、予算やアプリケーションのニーズに応じて様々なオプションをご利用になれます。各バンドルの現在の内容の詳細については、当社ウェブ・サイト [www.tek.com/document/brochure/software-bundles-for-the-4-5-and-6-series-mso-oscilloscopes](http://www.tek.com/document/brochure/software-bundles-for-the-4-5-and-6-series-mso-oscilloscopes) にアクセスして、ソフトウェア・バンドルのカタログをご覧ください。

1. スターター・バンドルは、最も一般的なシリアル・バスのデコード、プロトコル解析、ハードウェア拡張オプションで構成されています。
2. プロ・バンドルは、特定のアプリケーション（シリアル・トリガ／デコード、パワー・インテグリティ、シグナル・インテグリティ、車載、自動コンプライアンス・テスト、防衛／航空宇宙）に加えて、スターター・バンドルのすべてのオプションが含まれます。
3. アルティメット・バンドルには、すべてのプロ・バンドルのすべてのオプションに加えて、スターター・バンドルのすべてのオプションが含まれます。

1 年間ライセンス	永続的ライセンス	バンドルの概要
5-STARTER-1Y	5-STARTER-PER	内容：I2C、SPI、RS-232/422/UART シリアル・トリガ／解析、AFG（任意波形／ファンクション・ジェネレータ）
5-PRO-SERIAL-1Y	5-PRO-SERIAL-PER	内容：5-STARTER に加えて、125MS/Ch のレコード長、選択したシリアル解析オプションを含む

表（続く）

1 年間ライセンス	永続的ライセンス	バンドルの概要
5-PRO-POWER-1Y	5-PRO-POWER-PER	内容：5-STARTER に加えて、125MS/Ch のレコード長、選択したパワー解析オプションを含む
5-PRO-SIGNAL-1Y	5-PRO-SIGNAL-PER	内容：5-STARTER に加えて、125MS/Ch のレコード長、拡張ジッタ解析、および選択した解析オプションを含む
5-PRO-COMPL-1Y	5-PRO-COMPL-PER	内容：5-STARTER に加えて、125MS/Ch のレコード長、および選択した拡張自動コンプライアンス・テスト・オプションを含む
5-PRO-AUTO-1Y	5-PRO-AUTO-PER	内容：5-STARTER に加えて、125MS/Ch のレコード長、拡張ジッタ解析、および選択した車載用解析オプションを含む
5-PRO-MILGOV-1Y	5-PRO-MILGOV-PER	内容：5-STARTER に加えて、125MS/Ch のレコード長、拡張ジッタ解析、マスク・テスト、および選択したシリアル解析オプションを含む
5-ULTIMATE-1Y	5-ULTIMATE-PER	内容：5-STARTER、すべての 5-PRO バンドル・オプションに加え、500 MS/Ch のレコード長、RF 対時間の波形、トリガ、スペクトログラム、IQ キャプチャ、Spectrum View の取込帯域の拡張、ビデオ・トリガ・オプションを含む

購入したバンドルにはそれぞれ、以下の 2 種類のライセンス期間のオプションがあります。

- 1 年間ライセンス：購入したバンドルのすべての機能と無償のアップグレードを 1 年間ご利用いただけます。1 年を過ぎると、機能は無効になります。選択したバンドルには、1 年間ライセンスを追加購入できます。
- 永続的ライセンス：購入したバンドルのすべての機能を永続的に有効にします。永続的ライセンスには、バンドルされた機能セットの 1 年間の無料アップグレードが含まれます。1 年を過ぎると、前回のアップデートで有効になった機能セットの状態で凍結されます。

永続バンドルは、メンテナンス・ライセンスを購入することで、1 年間のアクティベーション期間後も継続してアップグレードを受けられます。メンテナンス・ライセンスの情報は、以下のメンテナンス・ライセンスの表に記載されています。メンテナンス・ライセンスは、既存の Starter、Pro、または Ultimate のバンドル用に購入する必要があります。

メンテナンス・ライセンス	説明
5-STARTER-MNT-1Y	5 シリーズ MSO での 1 年間の Perpetual Starter Bundle (永続スターター・バンドル) のアップデートが含まれています
5-PRO-MNT-1Y	5 シリーズ MSO での 1 年間の Perpetual Pro Bundle (永続プロ・バンドル) のアップデートが含まれています

表 (続く)



メンテナンス・ライセンス	説明
5-ULTIMATE-MNT-1Y	5 シリーズ MSO での 1 年間の Perpetual Ultimate Bundle (永続アルティメット・バンドル) のアップデートが含まれています

### ステップ 3

#### 必要な周波数帯域 (アナログ・チャンネル) の選択

現時点で必要な周波数帯域を、以下の周波数帯域オプションから選択してください。アップグレード・オプションを購入することで、いつでもアップグレードできます。

Opt.	周波数帯域
5-BW-350	350MHz
5-BW-500	500MHz
5-BW-1000	1GHz
5-BW-2000	2GHz

### ステップ 4

#### 内蔵機能の追加

これらは機器本体と同時に注文できますが、後でアップグレード・キットとして購入することもできます。

機器オプション	内蔵機能
5-RL-125M	レコード長を 62.5M ポイント/チャンネルから 125M ポイント/チャンネルに拡張
5-RL-250M	レコード長を 62.5 M ポイント/チャンネルから 250M ポイント/チャンネルに拡張
5-RL-500M	レコード長を 62.5 M ポイント/チャンネルから 500M ポイント/チャンネルに拡張
5-WIN <sup>5</sup>	Microsoft Windows 10 オペレーティング・システムがインストールされたリムーバブル SSD の追加
5-AFG	任意波形/ファンクション・ジェネレータの追加

### ステップ 5

#### オプション機能 (プロトコルのトリガ、デコード、サーチ) の追加

現段階で必要なプロトコル・サポートを、以下の解析オプションから選択してください。アップグレード・キットを購入することで、いつでもアップグレードできます。

計測器オプション	サポートされるプロトコル
5-RFNFC	ISO/IEC 15693、14443A、14443B および FeliCa (デコード/サーチのみ)
5-SRAERO	航空宇宙 (MIL-STD-1553、ARINC 429)

表 (続く)

<sup>5</sup> このオプションは Opt. 5-SEC とは同時発注できません。

計測器オプション	サポートされるプロトコル
5-SRAUDIO	オーディオ (I <sup>2</sup> S、LJ、RJ、TDM)
5-SRAUTO	車載用 (CAN, CAN FD、CAN XL、LIN、FlexRay、CAN シンボル・デコード)
5-SRAUTOEN1	100BASE-T1 車載用 Ethernet シリアル解析
5-SRAUTOSEN	車載用センサー (SENT)
5-SRCOMP	コンピュータ (RS-232/422/485/UART)
5-SRCPHY	MIPI C-PHY Vx.x (DSI-2、CSI-2 のデコード/サーチのみ)
5-SRCXPI	CXPI (デコード/サーチのみ)
5-SRDPHY	MIPI D-PHY (DSI-1、CSI-2 のデコード/サーチのみ)
5-SREMBD	エンベデッド (I <sup>2</sup> C、SPI)
5-SRENET	Ethernet (10BASE-T、100BASE-TX)
5-SRESPI	eSPI (デコード/サーチのみ)
5-SRETHERCAT	EtherCAT (デコード/サーチのみ)
5-SR8B10B	8B/10B (デコード/サーチのみ)
5-SRI3C	MIPI I3C
5-SRMANCH	マンチェスター (デコード/サーチのみ)
5-SRMDIO	MDIO (デコード/サーチのみ)
5-SRNRZ	NRZ (デコード/サーチのみ)
5-SRONEWIRE	1-Wire (1-Wire デコード/サーチのみ)
5-SRPM	パワー・マネジメント (SPMI)
5-SRPSI5	PSI5 (デコード/サーチのみ)
5-SRSDLC	同期データ・リンク制御 (デコード・サーチ)
5-SRSMBUS	SMBus (デコード・サーチのみ)
5-SRSPACEWIRE	Spacewire (デコード/サーチのみ)
5-SRSVID	SVID
5-SRUSB2	USB (USB2.0 LS、FS、HS) <sup>6</sup>
5-SREUSB2	eUSB2.0 (デコード/サーチのみ)

差動シリアル・バスの場合は、「アナログ・プローブ/アダプタの追加」をチェックしてください。

#### サードパーティのシリアル・バス・デコード/解析機能を追加

サードパーティ製アプリケーションを利用することで、5 シリーズ MSO で使用するためのシリアル・バス・デコード/解析機能を導入できます。サードパーティ製ソフトウェア・アプリケーションを使用するには、Windows 10 SSD (Opt. 5-WIN) が必要です。

詳細については以下を参照してください。 [prodigytechno.com/oscilloscope-based-protocol-decode-software/](http://prodigytechno.com/oscilloscope-based-protocol-decode-software/)

<sup>6</sup> USB ハイスピードは 1 GHz 以上の周波数帯域の型でのみサポート

## ステップ 6

**シリアル・バスのコンプライアンス・テストの追加** 現段階で必要なコンプライアンス・テスト・パッケージを、以下のオプションから選択してください。アップグレード・キットを購入することで、いつでもアップグレードできます。以下の表のすべてのオプションには、Opt. 5-WIN (Microsoft Windows 10 オペレーティング・システムがインストールされた SSD) が必要です。

Opt.	対応シリアル・バス
5-CMAUTOEN	車載用 Ethernet (100BASE-T1 および 1000BASE-T1) 自動コンプライアンス・テスト・ソリューション。 1000BASE-T1 には 2GHz 以上の帯域が必要
5-CMAUTOEN10	車載用 Ethernet (10BASE-T1S Short Reach) 自動コンプライアンス・テスト・ソリューション。
5-AUTOEN-BND	車載用 Ethernet コンプライアンス、信号分離、PAM3 解析、100Base-T1 デコード・ソフトウェア (Opt. 5-DJA が必要)
5-AUTOEN-SS	車載用 Ethernet 信号分離
5-CMINDUEN10	工業用 Ethernet (10Base-T1L Long Reach) 自動コンプライアンス・テスト・ソリューション
5-CMENET	Ethernet 自動コンプライアンス・テスト・ソリューション (10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T)。 1000BASE-T には 1GHz 以上の帯域が必要
5-CMENETML	マルチレーン Ethernet (10BASE-T/100Base-T/1000BASE-T) 自動コンプライアンス・テスト・ソリューション
5-CMUSB2	USB 2.0 自動コンプライアンス・テスト・ソリューション TDSUSBF 型 USB テスト・フィクスチャが必要 ハイスピード USB には 2GHz 以上の帯域が必要

## ステップ 7

**データ解析機能の追加**

機器オプション	拡張解析機能
5-DBLVDS	TekExpress LVDS 自動テスト・ソリューション (Opt. 5-DJA および 5-WIN が必要)
5-DJA	拡張ジッタ/アイ・ダイアグラム解析
5-DPM	デジタル電源管理
5-DPMBAS	基本的なデジタル電源管理
5-IMDA <sup>7</sup>	インバータ/モータ・ドライブ解析
5-IMDA-DQ0 <sup>7</sup>	DQ0 機能によるインバータ/モータ・ドライブ解析 (Opt. 5-IMDA が必要)

表 (続く)

<sup>7</sup> このオプションは MS054 型とは同時発注できません。

機器オプション	拡張解析機能
5-IMDA-MECH <sup>7</sup>	機械測定によるインバータ／モータ・ドライブ解析 (Opt. 5-IMDA が必要)
5-MTM	マスク／リミット・テスト
5-PAM3	PAM3 解析 (Opt. 5-DJA および 5-WIN が必要)
5-PS2 <sup>8 9</sup>	パワー・ソリューション・バンドル (Opt. 5-PWR、THDP0200 型、TCP0030A 型、067-1686-xx (デスクュー・フィクスチャ))
5-PS2FRA <sup>8 9</sup>	パワー・ソリューション・バンドル (Opt. 5-PWR、THDP0200 型、TCP0030A 型、TPP0502 型×2、067-1686-xx (デスクュー・フィクスチャ))
5-PWR <sup>10</sup>	パワー測定／解析
5-SV-BW-1	Spectrum View の取込み帯域を 500MHz に拡張
5-SV-RFVT	Spectrum View での RF 対時間波形、トリガ、スペクトログラム、および IQ キャプチャ
5-TDR	時間領域反射測定
5-UDFLT	ユーザ定義フィルタ作成ツール
5-VID	NTSC、PAL、SECAM ビデオ・トリガ
5-WBG-DPT	ワイド・バンドギャップ SiC/GaN ダブル・パルス・テストの測定および分析

## ベクトル信号解析の追加

SignalVu-PC は、5 シリーズ MSO または別の Windows PC で動作するスタンドアロン・アプリケーションであり、高度なベクトル信号解析を行います。SignalVu-PC を 5 シリーズ MSO または別の Windows PC で動作させるには、3 つのオプションが必要です。

1. 機器でアプリケーションを実行する場合、Windows SSD (5-WIN) をオシロスコープにインストールする必要があります。
2. I/Q データを転送するには、Spectrum View RF 対時間トレース (Opt. 5-SV-RFVT) をオシロスコープにインストールする必要があります。
3. アプリケーションの基本機能 (16 種類以上の RF 測定／表示機能を含む) を有効にするには、Connect (CONxx-SVPC) ライセンスを SignalVu-PC にインストールする必要があります。

## ステップ 8

### デジタル・プローブの追加

FlexChannel 入力に TLP058 型ロジック・プローブを接続するだけで、各 FlexChannel 入力で 8 つのデジタル・チャンネルを使用できます。TLP058 型プローブは、本体と同時に注文するか、または別途に注文することもできます。

<sup>8</sup> このオプションは Opt. 5-PWR とは同時発注できません。

<sup>9</sup> これらのバンドル・オプションは、機器の購入と同時にご購入ください。アップグレードはご利用になれません。

<sup>10</sup> このオプションは Opt. 5-PS2 または 5-PS2FRA とは同時発注できません。

この計測器には、		
MSO54 を	1~4 個の TLP058 プローブ、	8~32 個のデジタル・チャンネルに、
MSO56 を	1~6 個の TLP058 プローブ、	8~48 個のデジタル・チャンネルに、
MSO58 を	1~8 個の TLP058 プローブ、	8~64 個のデジタル・チャンネルに追加できます。

## ステップ 9

アナログ・プローブ/アダプ その他の推奨プローブ/アダプタの追加  
 タの追加

推奨プローブ/ アダプタ	概要
TAP1500	1.5GHz TekVPI®アクティブ・シングルエンド電圧プローブ、入力電圧±8V
TAP2500	2.5GHz TekVPI®アクティブ・シングルエンド電圧プローブ、入力電圧±4V
TAP3500	3.5GHz TekVPI®アクティブ・シングルエンド電圧プローブ、入力電圧±4V
TAP4000	4GHz TekVPI®アクティブ・シングルエンド電圧プローブ、入力電圧±4V
TCP0030A	30A AC/DC TekVPI®電流プローブ、周波数帯域 120MHz
TCP0020	20A AC/DC TekVPI®電流プローブ、周波数帯域 50MHz
TCP0030A	30A AC/DC TekVPI 電流プローブ、周波数帯域 120MHz
TCP0150	150A AC/DC TekVPI®電流プローブ、周波数帯域 20MHz
TRCP0300	30MHz AC 電流プローブ、250mA~300A
TRCP0600	30 MHz AC 電流プローブ、500mA~600A
TRCP3000	16MHz AC 電流プローブ、500mA~3000A
TDP0500	500MHz TekVPI®差動電圧プローブ、差動入力電圧±42V
TDP1000	1 GHz TekVPI®差動電圧プローブ、差動入力電圧±42V
TDP1500	1.5GHz TekVPI®差動電圧プローブ、差動入力電圧±8.5V
TDP3500	3.5GHz TekVPI®差動電圧プローブ、差動入力電圧±2V
TDP4000	4GHz TekVPI®差動電圧プローブ、差動入力電圧±2V
THDP0100	±6kV, 100MHz TekVPI®高電圧差動プローブ
THDP0200	±1.5kV, 200MHz TekVPI®高電圧差動プローブ
TMDP0200	±750V, 200MHz TekVPI®高電圧差動プローブ
TPR1000	1GHz、シングルエンド TekVPI®パワーレール・プローブ (TPR4KIT アクセサリ・キットを含む)
TPR4000	4GHz、シングルエンド TekVPI®パワーレール・プローブ (TPR4KIT アクセサリ・キット x1 を含む)
TIVP02	絶縁プローブ、200MHz、±5V~±2500V (チップにより異なる)、2m ケーブル

表 (続く)

推奨プローブ/ アダプタ	概要
TIVP02L	絶縁プローブ、200MHz、±5V～±2500V（チップにより異なる）、10m ケーブル 光アイソレーション型差動プローブ、200MHz、±5V～±2500V（チップにより異なる）、10m ケーブル
TIVP05	絶縁プローブ、500MHz、±5V～±2500V（チップにより異なる）、2m ケーブル
TIVP05L	絶縁プローブ、500MHz、±5V～±2500V（チップにより異なる）、10m ケーブル
TIVP1	絶縁プローブ、1GHz、±5V～±2500V（チップにより異なる）、2m ケーブル
TIVP1L	絶縁プローブ、1GHz、±5V～±2500V（チップにより異なる）、10m ケーブル
TPP0502	500MHz、2X TekVPI®受動電圧プローブ、入力容量 12.7pF
TPP0850	2.5kV、800MHz、50X TekVPI®高電圧受動プローブ
P6015A	20kV、75MHz 高電圧受動プローブ
TPA-BNC	TekVPI®-TekProbe™ BNC アダプタ（既存の TekProbe プローブを本機に接続する場合に推奨）
TEK-DPG	TekVPI デスキュー・パルス・ジェネレーター信号源
067-1686-xx	パワー測定デスキュー／校正フィクスチャ

他のプローブについては、プローブ選択ツール ([www.tek.com/probes](http://www.tek.com/probes)) をチェックしてください。

## ステップ 10

### アクセサリの追加

### 運搬／取り付け用アクセサリの追加

オプション・アクセサリ	概要
HC5	ハード・キャリング・ケース
RM5	ラックマウント・キット
GPIB-Ethernet アダプタ	4865B（GPIB-Ethernet インタフェース）を直接 ICS Electronics 社から購入可能 <a href="http://www.icselect.com/gpib_instrument_intf.html">www.icselect.com/gpib_instrument_intf.html</a>

## ステップ 11

### 電源ケーブル・オプションの選択

電源ケーブルのオプション	概要
A0	北米仕様電源プラグ（115V、60Hz）
A1	ユニバーサル欧州仕様電源プラグ（220V、50Hz）

表（続く）

電源ケーブルのオプション	概要
A2	イギリス仕様電源プラグ (240V、50Hz)
A3	オーストラリア仕様電源プラグ (240V、50Hz)
A5	スイス仕様電源プラグ (220V、50Hz)
A6	日本仕様電源プラグ (100V、50/60Hz)
A10	中国仕様電源プラグ (50Hz)
A11	インド仕様電源プラグ (50Hz)
A12	ブラジル仕様電源プラグ (60Hz)
A99	電源コードなし

## ステップ 12

### 延長修理/校正オプションの追加

サービス・オプション	概要
T3	3年間のトータル保証サービス・プランでは、通常使用による損傷、事故による破損 (ESD または EOS を含む) の修理または交換を含む、さらに予防的な保守も行われます。機器の返却によって発生するサービス中断期間は5日間で、カスタマ・サポートを優先的にご利用になれます。
R3	標準保証期間を3年に延長。部品、作業、国内2日の発送を保証。保証がない場合よりも迅速な修理対応。すべての修理で校正とアップデートを実施。手続きは不要。電話一本で修理プロセスが開始。
C3	3年間の校正サービス。必要に応じて、推奨される校正間隔でトレーサブル校正または機能検証が実施されます。保証期間には初回の校正に加えて、2年間の校正サービスが含まれます。
T5	5年間のトータル保証サービス・プランでは、通常使用による損傷、事故による破損 (ESD または EOS を含む) の修理または交換を含む、さらに予防的な保守も行われます。機器の返却によって発生するサービス中断期間は5日間で、カスタマ・サポートを優先的にご利用になれます。
R5	標準保証期間を5年に延長。部品、作業、国内2日の発送を保証。保証がない場合よりも迅速な修理対応。すべての修理で校正とアップデートを実施。手続きは不要。電話一本で修理プロセスが開始。
C5	5年間の校正サービス。必要に応じて、推奨される校正間隔でトレーサブル校正または機能検証が実施されます。保証期間には初回の校正に加えて、4年間の校正サービスが含まれます。

## 購入後の機能アップグレード

**機能アップグレードの追加** 購入後も簡単に機能を追加できます。ノード・ロック・ライセンスの場合は、単一の製品のオプション機能が永続的に有効になります。フローティング・ライセンスの場合は、ライセンスが有効なオプションを対応機器間で簡単に移動できます。

アップグレード機能	ノード・ロック・ライセンス・アップグレード	フローティング・ライセンス・アップグレード	説明
内蔵機能の追加	SUP5-AFG	SUP5-AFG-FL	任意波形／ファンクション・ジェネレータの追加
	SUP5-RL-125MT250M	SUP5-RL-125MT250M-FL	レコード長を 125 M ポイントから 250 M ポイントに拡張
	SUP5-RL-125MT500M	SUP5-RL-125MT500M-FL	レコード長を 125 M ポイントから 500 M ポイントに拡張
	SUP5-RL-250MT500M	SUP5-RL-250MT500M-FL	レコード長を 250 M ポイントから 500 M ポイントに拡張

表（続く）



アップグレード機能	ノード・ロック・ライセンス・アップグレード	フローティング・ライセンス・アップグレード	説明
プロトコル解析の追加	SUP5-RFNFC	SUP5-RFNFC-FL	ISO/IEC 15693、14443A、14443B および FeliCa (デコード/サーチのみ)
	SUP5-SRAERO	SUP5-SRAERO-FL	航空・宇宙通信用シリアル・トリガ/解析 (MIL-STD-1553、ARINC 429)
	SUP5-SRAUDIO	SUP5-SRAUDIO-FL	オーディオ・シリアル・トリガ/解析 (I <sup>2</sup> S、LJ、RJ、TDM)
	SUP5-SRAUTO	SUP5-SRAUTO-FL	車載用シリアル・トリガ/解析 (CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、CAN のシンボル・デコード)
	SUP5-SRAUTOSEN	SUP5-SRAUTOSEN-FL	車載用センサ・シリアル・トリガ/解析モジュール (SENT)
	SUP5-SRCOMP	SUP5-SRCOMP-FL	コンピュータ・シリアル・トリガ/解析 (RS-232/422/485/UART)
	SUP5-SRCXPI	SUP5-SRCXPI-FL	CXPI シリアル・デコード/解析
	SUP5-SRDPHY	SUP5-SRDPHY-FL	MIPI D-PHY (DSI-1、CSI-2 のデコード/サーチのみ)
	SUP5-SREMBD	SUP5-SREMBD-FL	組込みシリアル・トリガ/解析 (I <sup>2</sup> C、SPI)
	SUP5-SRENET	SUP5-SRENET-FL	Ethernet シリアル・トリガ/解析 (10BASE-T および 100BASE-TX)
	SUP5-SRESPI	SUP5-SRESPI-FL	eSPI シリアル・デコード/解析
	SUP5-SRETHERCAT	SUP5-SRETHERCAT-FL	EtherCAT シリアル・デコード/解析
	SUP5-SRI3C	SUP5-SRI3C-FL	MIPI I3C シリアル・トリガ/解析
	SUP5-SRMDIO	SUP5-SRMDIO-FL	管理用データ入出力シリアル・デコード/解析
	SUP5-SRPM	SUP5-SRPM-FL	電源管理シリアル・トリガ/解析 (SPMI)
	SUP5-SRPSI5	SUP5-SRPSI5-FL	PSI5 シリアル・デコード/解析
	SUP5-SRSDLC	SUP5-SRSDLC-FL	同期データ・リンク・コントロール・プロトコル (デコード/サーチのみ)
	SUP5-SRSMBUS	SUP5-SRSMBUS-FL	SMBus シリアル・デコード/解析
	SUP5-SRSPACEWIRE	SUP5-SRSPACEWIRE-FL	SpaceWire シリアル解析
	SUP5-SRSVID	SUP5-SRSVID-FL	シリアル VID (SVID) シリアル・トリガ/解析
	SUP5-SRUSB2	SUP5-SRUSB2-FL	USB 2.0 シリアル・バス・トリガ/解析 (LS、FS、および HS)
SUP5-SREUSB2	SUP5-SREUSB2-FL	組込み USB2 (eUSB2) シリアル・デコード/解析	

表 (続く)

アップグレード機能	ノード・ロック・ライセンス・アップグレード	フローティング・ライセンス・アップグレード	説明
拡張解析の追加	SUP5-DJA	SUP5-DJA-FL	拡張ジッタ／アイ・ダイアグラム解析
	SUP5-DPM	SUP5-DPM-FL	デジタル電源管理
	SUP5-MTM	SUP5-MTM-FL	マスク/リミット・テスト
	SUP5-DPMBAS	SUP5-DPMBAS-FL	基本的なデジタル電源管理
	SUP5-PWR	SUP5-PWR-FL	拡張パワー測定／解析
	SUP5-SV-BW-1	SUP5-SV-BW-1-FL	Spectrum View の取込み帯域を 500 MHz に拡張
	SUP5-SV-RFVT	SUP5-SV-RFVT-FL	Spectrum View での RF 対時間波形、トリガ、スペクトログラム、および IQ キャプチャ
	SUP5-TDR	SUP5-TDR-FL	時間領域反射測定
	SUP5-UDFLT	SUP5-UDFLT-FL	ユーザ定義フィルタ作成ツール
	SUP5-VID	SUP5-VID-FL	NTSC、PAL、SECAM ビデオ・トリガ
デジタル・ボルトメータの追加	N/A	—	デジタル・ボルトメータ／周波数カウンタ ( <a href="http://www.tek.com/register4mso">www.tek.com/register4mso</a> で製品登録により無料で提供)

アップグレード機能	ノード・ロック・ライセンス・アップグレード	フローティング・ライセンス・アップグレード	説明
内蔵機能の追加	SUP5-AFG	SUP5-AFG-FL	任意波形／ファンクション・ジェネレータの追加
	SUP5-RL-125M	SUP5-RL-125M-FL	レコード長を 62.5M ポイント／チャンネルから 125M ポイント／チャンネルに拡張
	SUP5-RL-250M	SUP5-RL-250M-FL	レコード長を 62.5M ポイント／チャンネルから 250M ポイント／チャンネルに拡張
	SUP5-RL-500M	SUP5-RL-500M-FL	レコード長を 62.5M ポイント／チャンネルから 500M ポイント／チャンネルに拡張
	SUP5-RL-125MT250M	SUP5-RL-125MT250M-FL	レコード長を 125M ポイント／チャンネルから 250M ポイント／チャンネルに拡張
	SUP5-RL-250MT500M	SUP5-RL-250MT500M-FL	レコード長を 250M ポイント／チャンネルから 500M ポイント／チャンネルに拡張
	SUP5-RL-125MT500M	SUP5-RL-125MT500M-FL	レコード長を 125M ポイント／チャンネルから 500M ポイント／チャンネルに拡張

表（続く）

アップグレード機能	ノード・ロック・ライセンス・アップグレード	フローティング・ライセンス・アップグレード	説明
プロトコル解析の追加	SUP5-RFNFC	SUP5-RFNFC-FL	ISO/IEC15693 および ISO/IEC14443A (デコード/サーチのみ)
	SUP5-SR8B10B	SUP5-SR8B10B-FL	8B/10B シリアル・デコード/解析
	SUP5-SRAERO	SUP5-SRAERO-FL	航空・宇宙通信用シリアル・トリガ/解析 (MIL-STD-1553、ARINC 429)
	SUP5-SRAUDIO	SUP5-SRAUDIO-FL	オーディオ・シリアル・トリガ/解析 (I <sup>2</sup> S、LJ、RJ、TDM)
	SUP5-SRAUTO	SUP5-SRAUTO-FL	車載用シリアル・トリガ/解析 (CAN、CAN FD、CAN XL、LIN、FlexRay、CAN のシンボル・デコード)
	SUP5-SRAUTOEN1	SUP5-SRAUTOEN1-FL	100BASE-T1 車載用 Ethernet シリアル解析
	SUP5-SRAUTOSEN	SUP5-SRAUTOSEN-FL	車載用センサ・シリアル・トリガ/解析モジュール (SENT)
	SUP5-SRCOMP	SUP5-SRCOMP-FL	コンピュータ・シリアル・トリガ/解析 (RS-232/422/485/UART)
	SUP5-SRCPHY	SUP5-SRCPHY-FL	MIPI C-PHY シリアル解析 (DSI-2、CSI-2)
	SUP5-SRCXPI	SUP5-SRCXPI-FL	CXPI シリアル・デコード/解析
	SUP5-SRDPHY	SUP5-SRDPHY-FL	MIPI D-PHY (DSI-1、CSI-2 のデコード/サーチのみ)
	SUP5-SREMBD	SUP5-SREMBD-FL	組込みシリアル・トリガ/解析 (I <sup>2</sup> C、SPI)
	SUP5-SRENET	SUP5-SRENET-FL	Ethernet シリアル・トリガ/解析 (10BASE-T および 100BASE-TX)
	SUP5-SRESPI	SUP5-SRESPI-FL	eSPI シリアル・デコード/解析
	SUP5-SRETHERCAT	SUP5-SRETHERCAT-FL	EtherCAT シリアル・デコード/解析
	SUP5-SRI3C	SUP5-SRI3C-FL	MIPI I3C シリアル・トリガ/解析
	SUP5-SRMANCH	SUP5-SRMANCH-FL	マンチェスター (デコード/サーチのみ)
	SUP5-SRMDIO	SUP5-SRMDIO-FL	管理用データ入出力シリアル・デコード/解析
	SUP5-SRNRZ	SUP5-SRNRZ-FL	NRZ シリアル・デコード/解析
	SUP5-SRONEWIRE	SUP5-SRONEWIRE-FL	1-Wire シリアル・デコード/解析
	SUP5-SRPM	SUP5-SRPM-FL	電源管理シリアル・トリガ/解析 (SPMI)
	SUP5-SRPSI5	SUP5-SRPSI5-FL	PSI5 シリアル・デコード/解析
	SUP5-SRSDLC	SUP5-SRSDLC-FL	同期データ・リンク・コントロール・プロトコル・デコード/サーチ
	SUP5-SRSMBUS	SUP5-SRSMBUS-FL	SMBus シリアル・デコード/解析
	SUP5-SRSPACEWIRE	SUP5-SRSPACEWIRE-FL	Spacewire シリアル・デコード/解析
	SUP5-SRSVID	SUP5-SRSVID-FL	シリアル VID (SVID) シリアル・トリガ/解析
	SUP5-SRUSB2	SUP5-SRUSB2-FL	USB 2.0 シリアル・バス・トリガ/解析 (LS、FS、および HS)
SUP5-SREUSB2	SUP5-SREUSB2-FL	組込み USB2 (eUSB2) シリアル・デコード/解析	

表 (続く)

アップグレード機能	ノード・ロック・ライセンス・アップグレード	フローティング・ライセンス・アップグレード	説明
シリアル・コンプライアンス・テストが追加されました。  すべてのシリアル・コンプライアンス製品には、Opt. 5-WIN (Microsoft Windows 10 オペレーティング・システムがインストールされた SSD) が必要	SUP5-AUTOEN-BND	N/A	車載用 Ethernet 準拠、信号分離、PAM3 解析 (Opt. 5-DJA が必要)、100BASE-T1 シリアル・デコード
	SUP5-AUTOEN-SS	SUP5-AUTOEN-SS-FL	車載用 Ethernet 信号分離
	SUP5-CMAUTOEN	SUP5-CMAUTOEN-FL	車載用 Ethernet 自動コンプライアンス・テスト・ソリューション (100BASE-T1 および 1000BASE-T1) には、  1000BASE-T1 テストに 2 GHz 以上の周波数帯域が必要
	SUP5-CMAUTOEN10	SUP5-CMAUTOEN10-FL	車載用 Ethernet (10BASE-T1S Short Reach) 自動コンプライアンス・テスト・ソリューション
	SUP5-CMENET	SUP5-CMENET-FL	Ethernet 自動コンプライアンス・テスト・ソリューション (10BASE-T/100BASE-T/ 1000BASE-T)。  1000BASE-T1 テストには、1 GHz 以上の周波数帯域が必要
	SUP5-CMENETML	SUP5-CMENETML-FL	マルチレーン Ethernet 自動コンプライアンス・テスト・ソリューション  (10BASE-T/100Base-T/1000BASE-T) (Opt. 5-CMENET が必要)
	SUP5-CMINDUEN10	SUP5-CMINDUEN10-FL	工業用 Ethernet (10Base-T1L Long Reach) 自動コンプライアンス・テスト・ソリューション
	SUP5-CMUSB2	SUP5-CMUSB2-FL	USB 2.0 自動コンプライアンス・テスト・ソリューション  TDSUSBF USB テスト・フィクスチャが必要  ハイスピード USB テストには、2 GHz 以上の周波数帯域が必要

表 (続く)

アップグレード機能	ノード・ロック・ライセンス・アップグレード	フローティング・ライセンス・アップグレード	説明
拡張解析の追加	SUP5-DBLVDS	SUP5-DBLVDS-FL	LVDS デバッグ／解析 (Opt. 5-DJA および 5-WIN が必要)
	SUP5-DJA	SUP5-DJA-FL	拡張ジッタ／アイ・ダイアグラム解析
	SUP5-DPM	SUP5-DPM-FL	デジタル電源管理
	SUP5-IMDA <sup>11</sup>	SUP5-IMDA-FL <sup>11</sup>	インバータ／モータ・ドライブ解析
	SUP5-IMDA-DQ0 <sup>11</sup>	SUP5-IMDA-DQ0-FL <sup>11</sup>	DQ0 機能によるインバータ/モータ・ドライブ解析 (Opt. 5-IMDA が必要)
	SUP5-IMDA-MECH <sup>11</sup>	SUP5-IMDA-MECH-FL <sup>11</sup>	機械測定によるインバータ/モータ・ドライブ解析 (Opt. 5-IMDA が必要)
	SUP5-MTM	SUP5-MTM-FL	マスク/リミット・テスト
	SUP5-PAM3	SUP5-PAM3-FL	PAM3 解析 (Opt. 5-DJA が必要)
	SUP5-PWR	SUP5-PWR-FL	拡張パワー測定／解析
	SUP5-PS2	N/A	パワー・ソリューション・バンドル (Opt. 5-PWR、THDP0200 型、TCP0030A 型、067-1686-XX (デスクュー・フィクスチャ))
	SUP5-DPMBAS	SUP5-DPMBAS-FL	基本的なデジタル電源管理
	SUP5-SV-BW-1	SUP5-SV-BW-1-FL	Spectrum View の取込み帯域を 500 MHz に拡張
	SUP5-SV-RFVT	SUP5-SV-RFVT-FL	Spectrum View での RF 対時間波形、トリガ、スペクトログラム、および IQ キャプチャ
	SUP5-UDFLT	SUP5-UDFLT-FL	ユーザ定義フィルタ作成ツール
	SUP5-VID	SUP5-VID-FL	NTSC、PAL、SECAM ビデオ・トリガ
SUP5-WBG-DPT	SUP5-WBG-DPT-FL	ワイド・バンドギャップ SiC/GaN ダブル・パルス・テストの測定および分析	
デジタル・ボルトメータの追加	N/A	N/A	デジタル・ボルトメータ／周波数カウンタ (製品登録により無料で提供： <a href="http://www.tek.com/register5mso">www.tek.com/register5mso</a> )

アップグレード機能	アップグレード	必須オプション	説明
Windows 10 オペレーティング・システムの追加	SUP5-WIN	I4400E	Windows 10 オペレーティング・システムがインストールされたりムーバブル SSD。Intel i5-i4400E と互換性あり。
		I8400H	Windows 10 オペレーティング・システムがインストールされたりムーバブル SSD。Intel i5-i8400H と互換性あり。

<sup>11</sup> このオプションは MS054 型とは同時発注できません。

## 購入後の周波数帯域のアップグレード

### 購入後に周波数帯域のアップグレードを購入する

購入後も製品のアナログ周波数帯域を簡単にアップグレードできます。周波数帯域のアップグレードは、FlexChannel の入力数、現在の帯域、必要な帯域の組み合わせに基づいて購入してください。1GHz までのアップグレードは、ソフトウェア・ライセンスと新しい前面パネル・ラベルをインストールするだけです。お客様自身で実施していただけます。2 GHz へのアップグレードの場合は、当社認定サービス受付センターにてインストールおよび校正を実施させていただきます。

また、350MHz または 500MHz から 1GHz または 2GHz に周波数帯域をアップグレードされる場合には、TPP1000 型 1GHz 受動プローブがチャンネルあたり 1 つ付属します。

所有するオシロスコープの機種	帯域アップグレード製品	アップグレード・オプション	アップグレード・オプションの概要
MSO54	SUP5-BW4	5-BW3T5-4	ライセンス。5 シリーズ MSO の帯域アップグレード。FlexChannel (x 4) 機種の周波数帯域を 350 MHz から 500 MHz にアップグレード。ノード・ロック・ライセンス
	SUP5-BW4	5-BW3T10-4	ライセンス。5 シリーズ MSO の帯域アップグレード。FlexChannel (x 4) 機種の周波数帯域を 350 MHz から 1 GHz にアップグレード。ノード・ロック・ライセンス
	SUP5-BW4	5-BW5T10-4	ライセンス。5 シリーズ MSO の帯域アップグレード。FlexChannel (x 4) 機種の周波数帯域を 500 MHz から 1 GHz にアップグレード。ノード・ロック・ライセンス
	SUP5-BW10T204		帯域幅のアップグレード: 5 シリーズのオシロスコープの FlexChannel (x 4) 機種において 1 GHz~2 GHz
	SUP5-BW3T204		帯域幅のアップグレード: 5 シリーズのオシロスコープの FlexChannel (x 4) 機種において 350 MHz ~2 GHz
	SUP5-BW5T204		帯域幅のアップグレード: 5 シリーズのオシロスコープの FlexChannel (x 4) 機種において 500 MHz ~2 GHz

表 (続く)

所有するオシロスコープの機種	帯域アップグレード製品	アップグレード・オプション	アップグレード・オプションの概要
MSO56	SUP5-BW6	5-BW3T5-6	ライセンス。5 シリーズ MSO の帯域アップグレード。FlexChannel (x 6) 機種の周波数帯域を 350 MHz から 500 MHz にアップグレード。ノード・ロック・ライセンス
	SUP5-BW6	5-BW3T10-6	ライセンス。5 シリーズ MSO の帯域アップグレード。FlexChannel (x 6) 機種の周波数帯域を 350 MHz から 1 GHz にアップグレード。ノード・ロック・ライセンス
	SUP5-BW6	5-BW5T10-6	ライセンス。5 シリーズ MSO の帯域アップグレード。FlexChannel (x 6) 機種の周波数帯域を 500 MHz から 1 GHz にアップグレード。ノード・ロック・ライセンス
	SUP5-BW10T206		帯域幅のアップグレード: 5 シリーズのオシロスコープの FlexChannel (x 6) 機種において 1 GHz~2 GHz
	SUP5 BW3T206		帯域幅のアップグレード: 5 シリーズのオシロスコープの FlexChannel (x 6) 機種において 350 MHz ~2 GHz
	SUP5-BW5T206		帯域幅のアップグレード: 5 シリーズのオシロスコープの FlexChannel (x 6) 機種において 500 MHz ~2 GHz
MSO58	SUP5-BW8	5-BW3T5-8	ライセンス。5 シリーズ MSO の帯域アップグレード。FlexChannel (x 8) 機種の周波数帯域を 350 MHz から 500 MHz にアップグレード。ノード・ロック・ライセンス
	SUP5-BW8	5-BW3T10-8	ライセンス。5 シリーズ MSO の帯域アップグレード。FlexChannel (x 8) 機種の周波数帯域を 350 MHz から 1 GHz にアップグレード。ノード・ロック・ライセンス
	SUP5-BW8	5-BW5T10-8	ライセンス。5 シリーズ MSO の帯域アップグレード。FlexChannel (x 8) 機種の周波数帯域を 500 MHz から 1 GHz にアップグレード。ノード・ロック・ライセンス
	SUP5-BW10T208		帯域幅のアップグレード: 5 シリーズのオシロスコープの FlexChannel (x 8) 機種において 1 GHz~2 GHz
	SUP5-BW3T208		帯域幅のアップグレード: 5 シリーズのオシロスコープの FlexChannel (x 8) 機種において 350 MHz ~2 GHz
	SUP5-BW5T208		帯域幅のアップグレード: 5 シリーズのオシロスコープの FlexChannel (x 8) 機種において 500 MHz ~2 GHz



テクトロニクスは ISO 14001 : 2015 および ISO 9001 : 2015 (DEKRA 認証) を取得しています。

ASEAN/オーストラレーシア (65) 6356 3900

ベルギー 00800 2255 4835\*

中東欧諸国およびバルト諸国 +41 52 675 3777

フィンランド +41 52 675 3777

香港 400 820 5835

日本 81 (120) 441 046

中東、アジア、および北アフリカ +41 52 675 3777

中華人民共和国 400 820 5835

韓国 +82 2 565 1455

スペイン 00800 2255 4835\*

台湾 : 886 (2) 2656 6688

オーストリア 00800 2255 4835\*

ブラジル +55 (11) 3759 7627

中央ヨーロッパおよびギリシャ +41 52 675 3777

フランス 00800 2255 4835\*

インド 000 800 650 1835

ルクセンブルク +41 52 675 3777

オランダ 00800 2255 4835\*

ポーランド +41 52 675 3777

ロシアおよび CIS 諸国 +7 (495) 6647564

スウェーデン 00800 2255 4835\*

イギリスおよびアイルランド 00800 2255 4835\*

バルカン半島諸国、イスラエル、南アフリカ、および他の ISE 諸国 +41 52 675 3777

カナダ 1 800 833 9200

デンマーク +45 80 88 1401

ドイツ 00800 2255 4835\*

イタリア 00800 2255 4835\*

メキシコ、中南米およびカリブ海地域 52 (55) 56 04 50 90

ノルウェー 800 16098

ポルトガル 80 08 12370

南アフリカ +41 52 675 3777

スイス 00800 2255 4835\*

米国 1 800 833 9200

\* 欧州のフリーダイヤル番号つながらない場合は次の番号におかけください : +41 52 675 3777

**詳細情報** Tektronix は、総合的に継続してアプリケーション・ノート、テクニカル・ブリーフおよびその他のリソースのコレクションを発展させ、技術者が最先端で仕事ができるように手助けをします。Web サイト ([jp.tek.com](http://jp.tek.com)) をご参照ください。

Copyright © Tektronix, Inc. All rights reserved. テクトロニクス製品は、登録済および出願中の米国その他の国の特許等により保護されています。本書の内容は、既に発行されている他の資料の内容に代わるものではありません。また、本製品の仕様および価格は、予告なく変更させていただく場合がございますので、予めご了承ください。TEKTRONIX および TEK は Tektronix, Inc. の登録商標です。他の商品名全ては、各企業の商標および商標、登録商標です。

9 Sep 2024 48Z-60850-27

[tek.com](http://tek.com)

**Tektronix**<sup>®</sup>